


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2006年製	管理番号	P007968
型式	TC-S2C	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(250ピッチ)

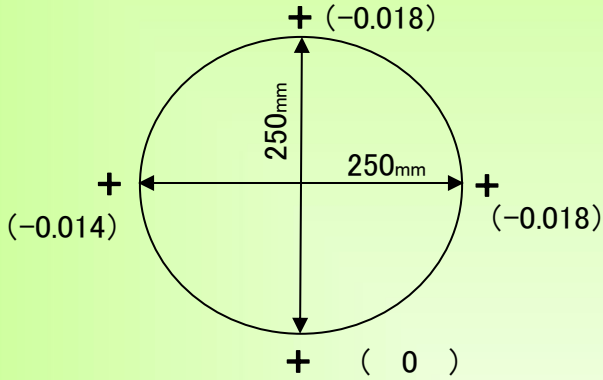

主軸振れ



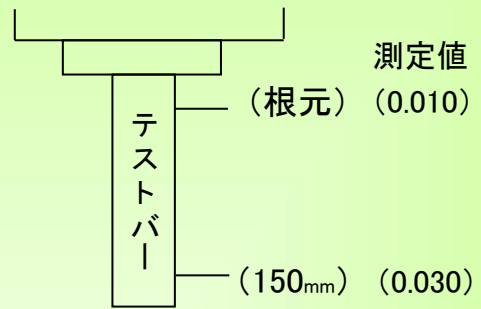


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.010)

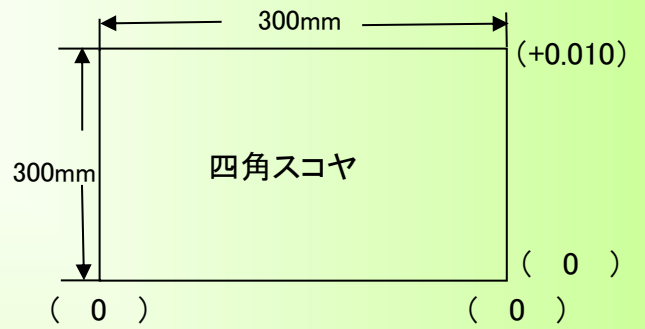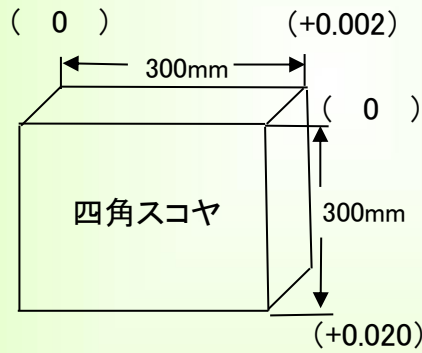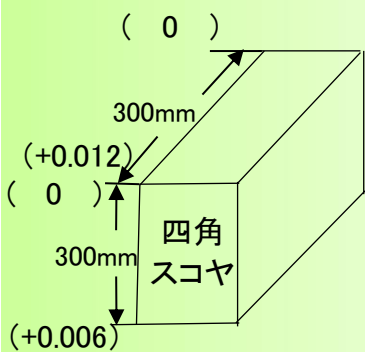

上面精度

※テーブルサイズ 600×320

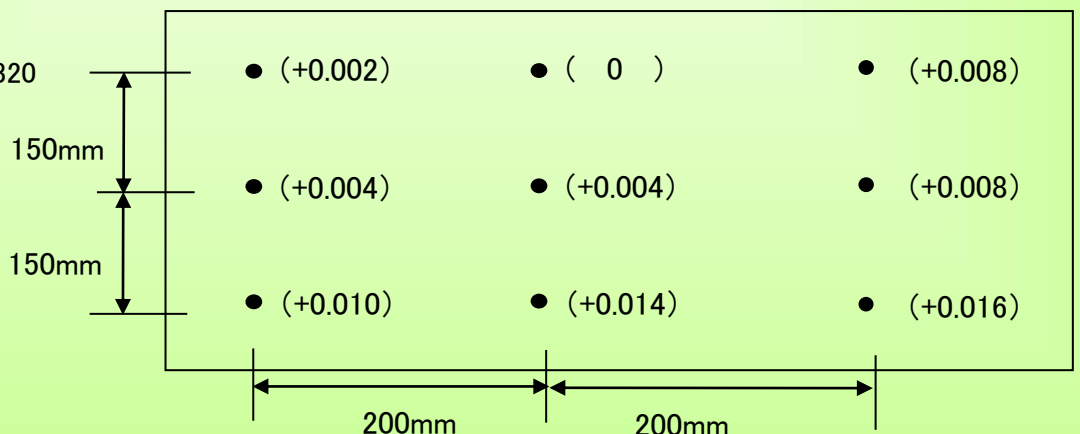

2022/9/10