


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	1998年製	管理番号	P007417
型式	$\alpha$ -T14iAL	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

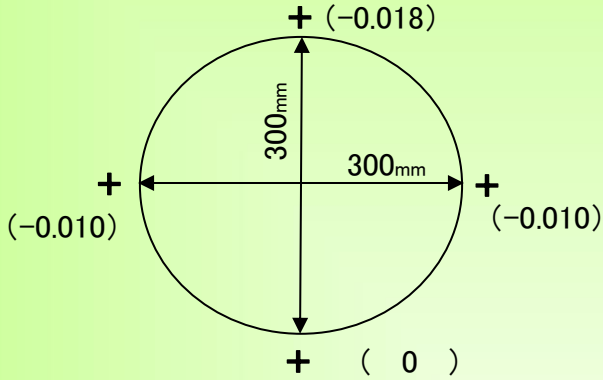

## 主軸振れ



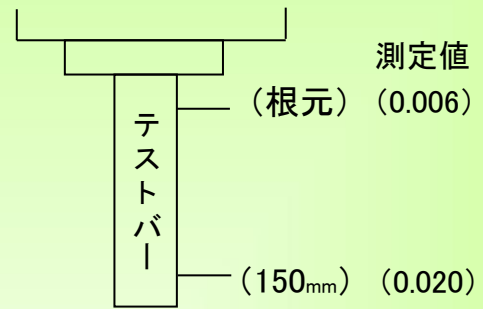


## 直角度

【YZ】測定値 (0.018)


【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.004)

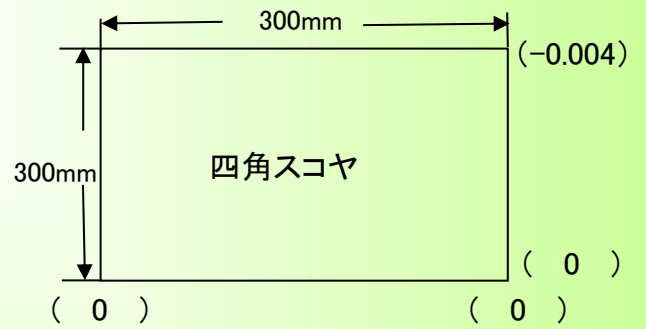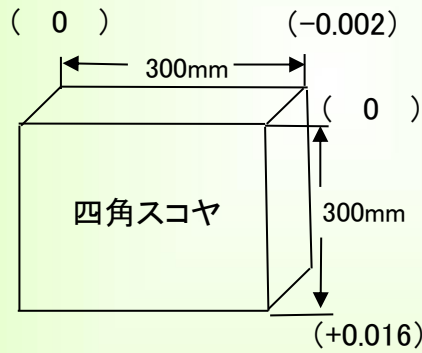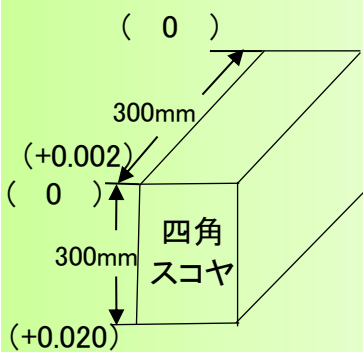

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×390

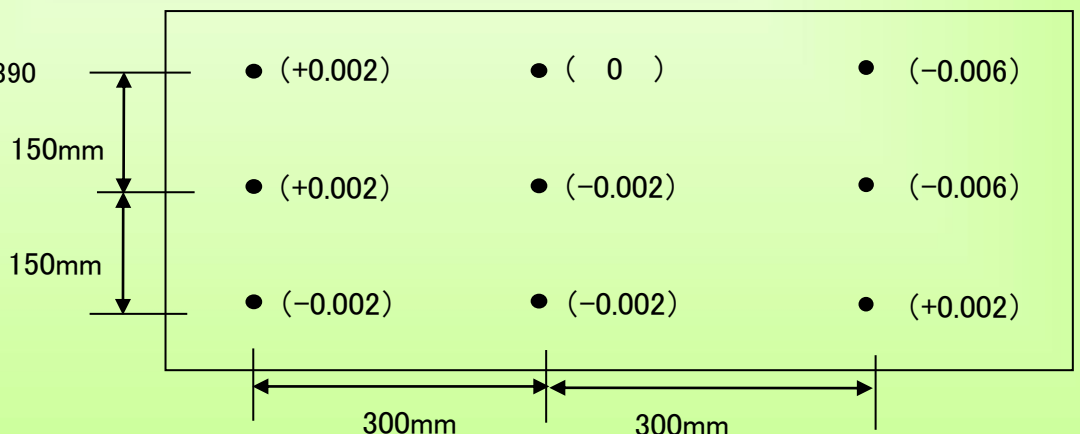

2022/9/12