


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2015年製	管理番号	P007991
型式	MILLAC852V II	測定者	金子・野辺沼		

## 振り回し(300ピッチ)

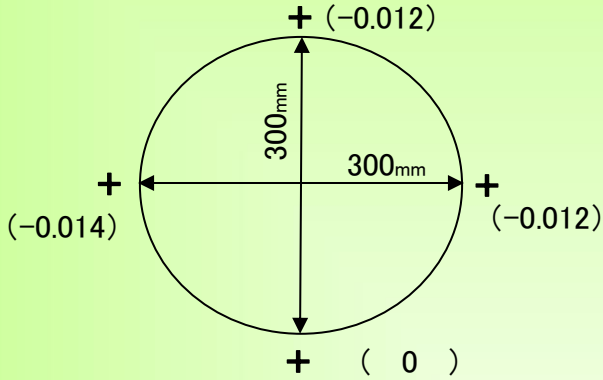

## 主軸振れ



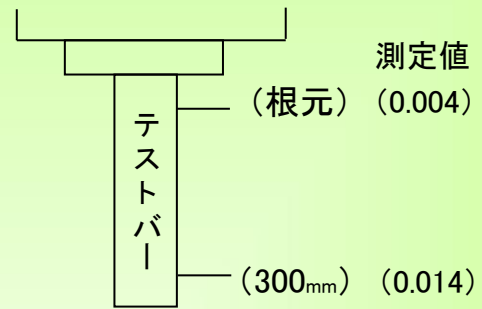


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.014)

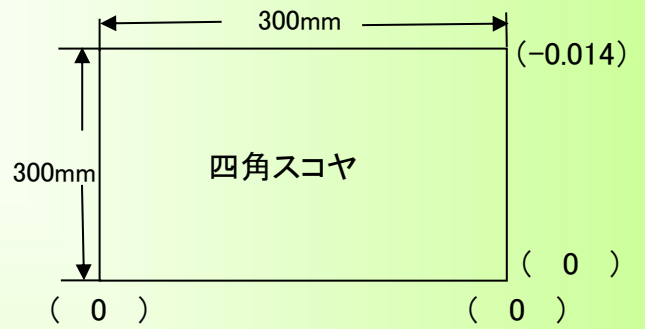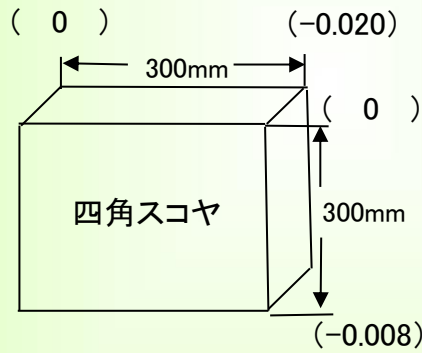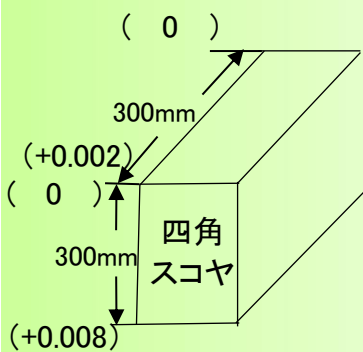

## 上面精度

※テーブルサイズ 2200×850

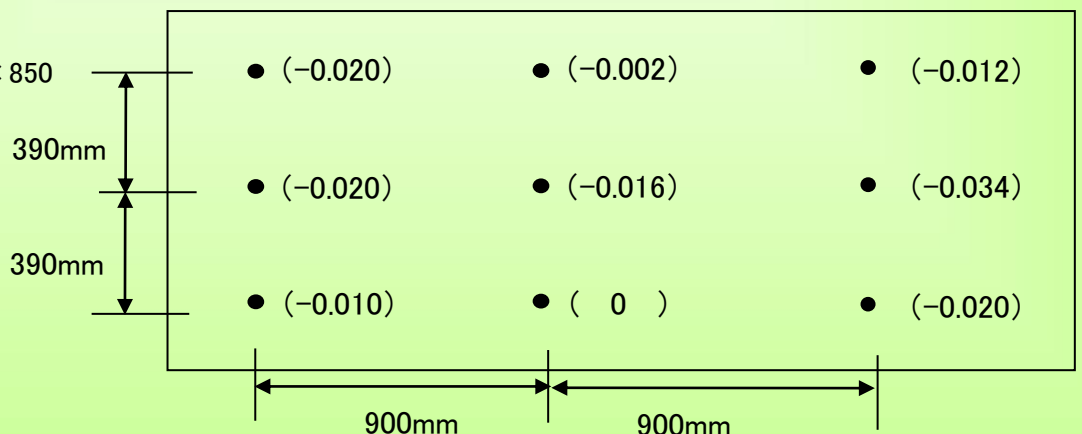

2022/9/15