精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2003年製	管理番号	P007725
型式	TC-S2B-O	測定者	奥澤		

振り回し(200ピッチ)

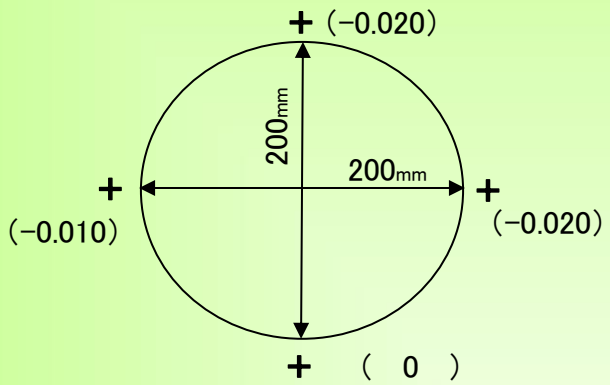

主軸振れ

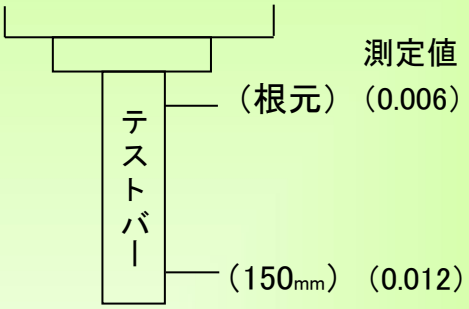

直角度

【YZ】測定値 (0.012)　【XZ】測定値 (0.020)　【X Y】測定値 (0.020)

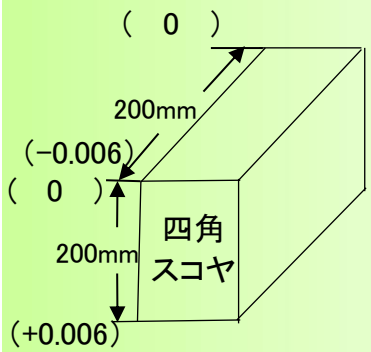

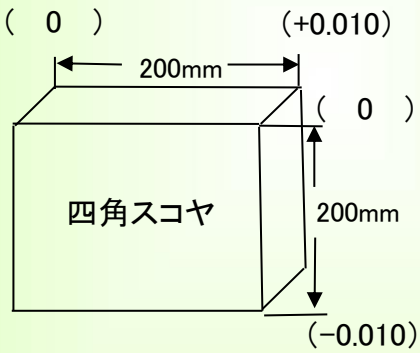

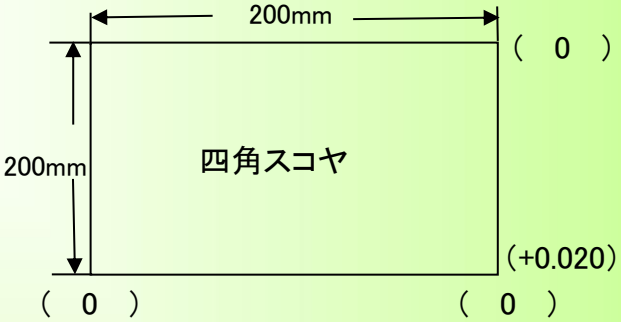

上面精度

※テーブルサイズ 800×320

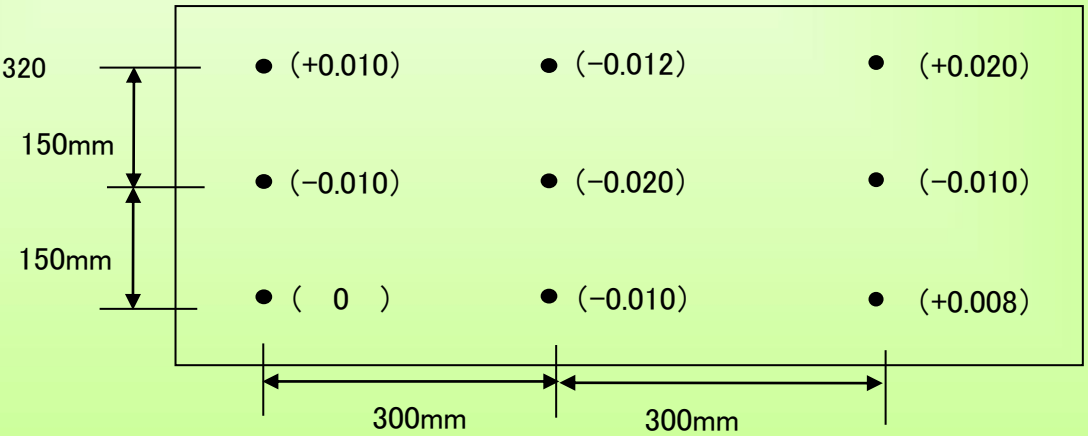

2022/9/28