


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	1991年製	管理番号	H017067
型式	KVJP-55	測定者	山口		

振り回し(150ピッチ)

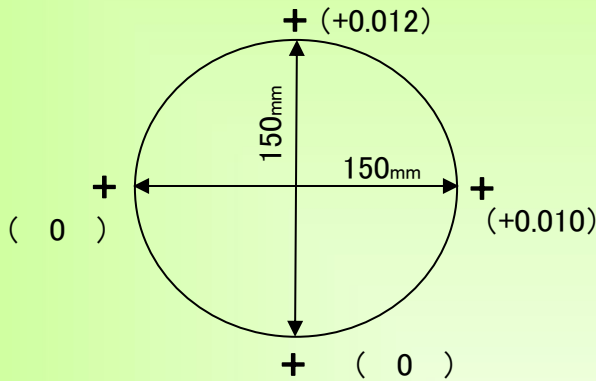

主軸振れ



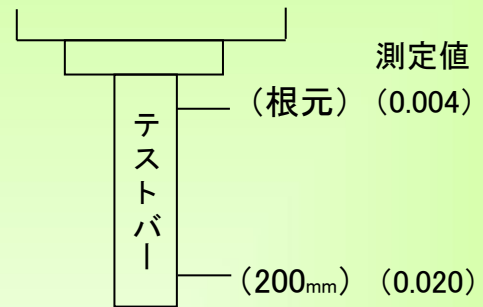


直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.010)

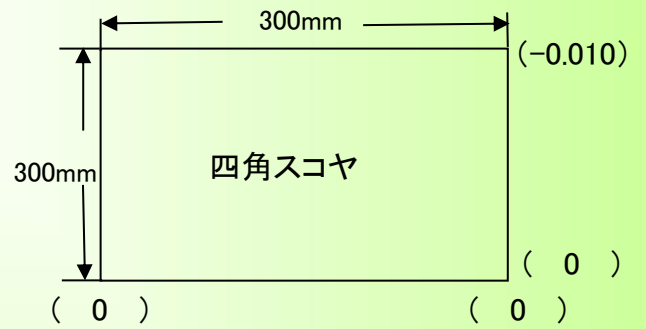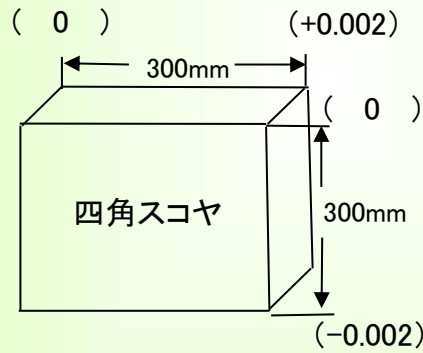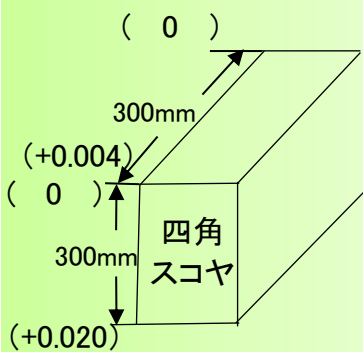

上面精度

※テーブルサイズ 1100×250

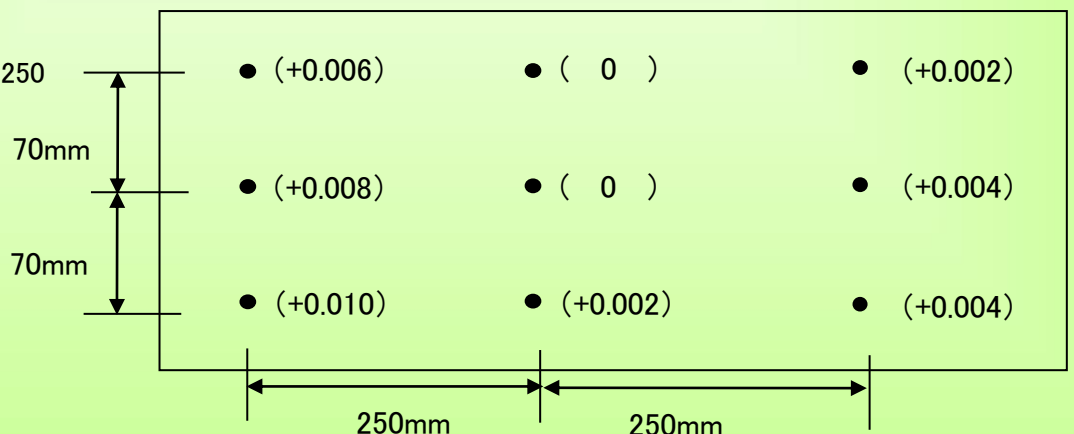

2022/9/28