


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	1986年製	管理番号	H017126
型式	MH-3V II	測定者	山口	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

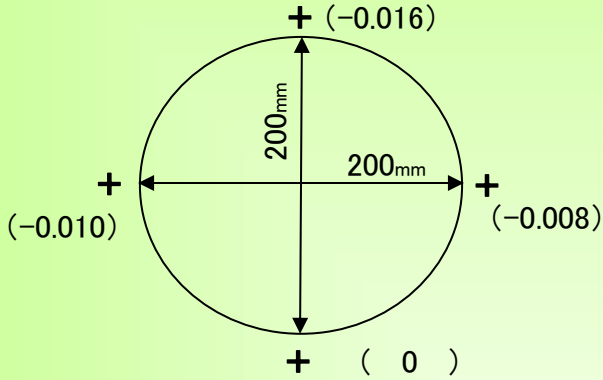

## 主軸振れ



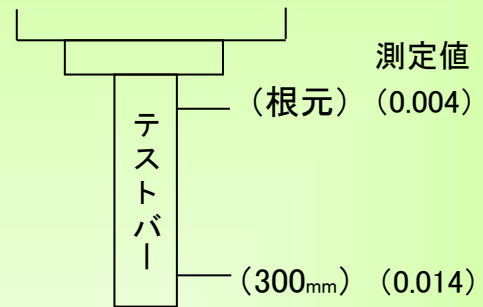


## 直角度

【YZ】測定値 (0.022)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.014)

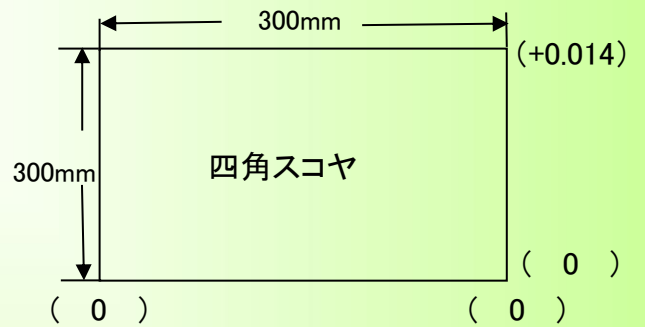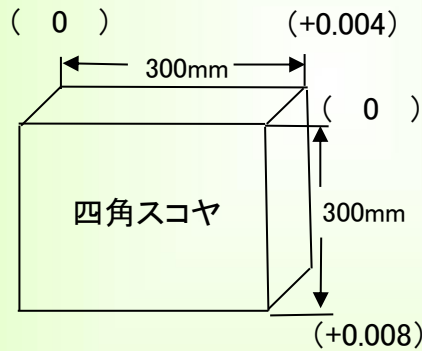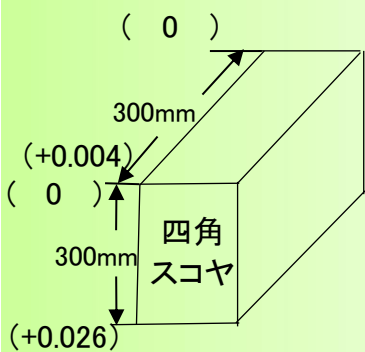

## 上面精度

※テーブルサイズ 1650×380

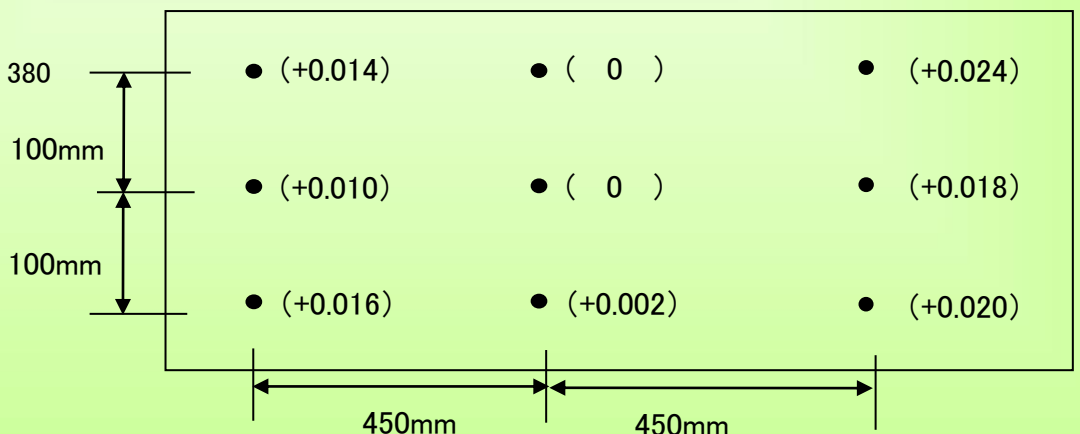

2022/10/19