

精度測定検査表


Examination for precision list

測定日 2012.09.20


メーカー	大隈豊和	バーコード	P10063
型式	M-65V		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	全ての項目で 精度良好です
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

振り回し(300ピッチ)

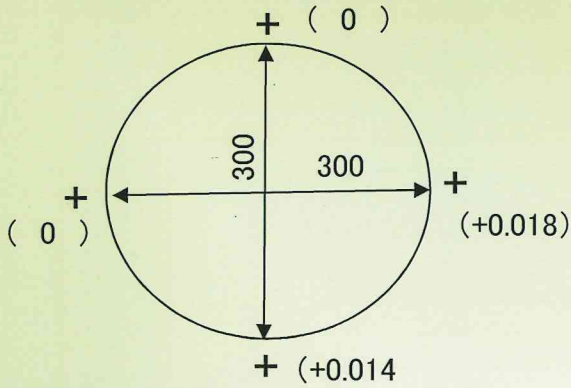


主軸振れ

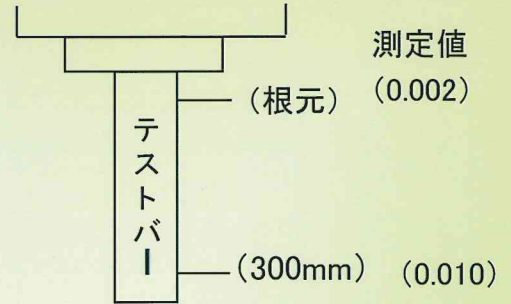


直角度


【Y Z】

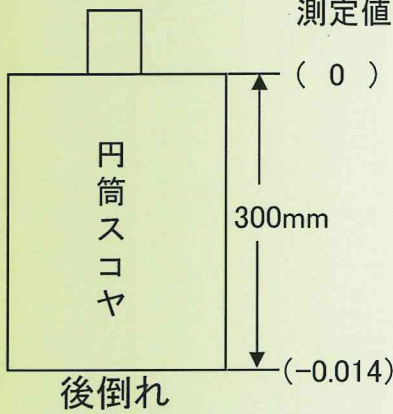

【X Z】

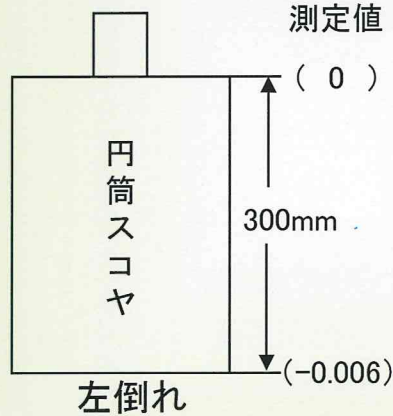

【X Y】

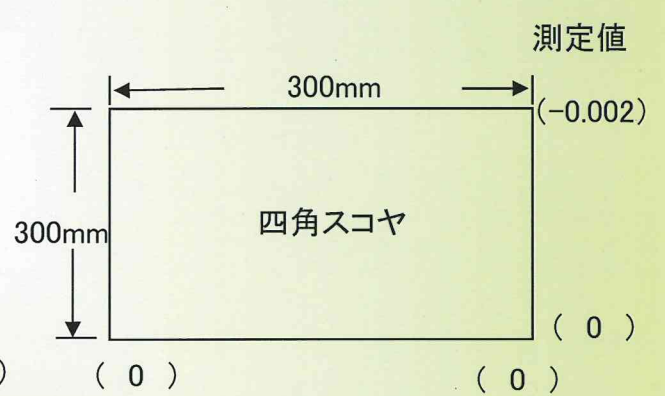

上面精度

