


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|------------------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | ファナック | 年式 | 2002年製 | 管理番号 | P007935 |
| 型式 | α -T14iCL | 測定者 | 武藤 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

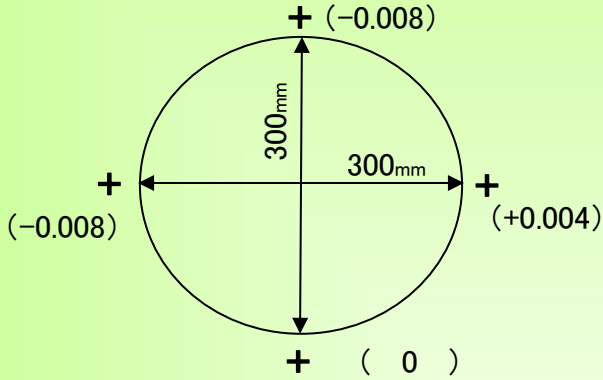

主軸振れ



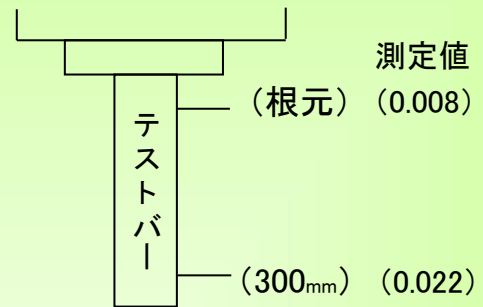


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.008)

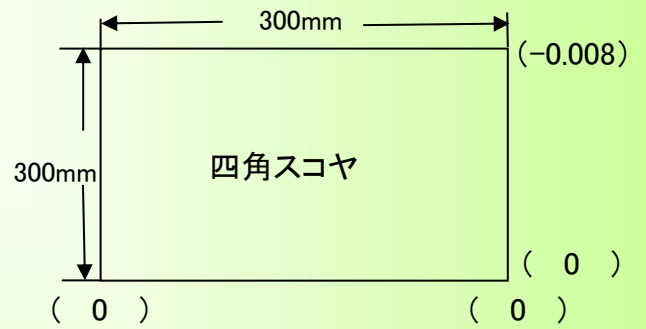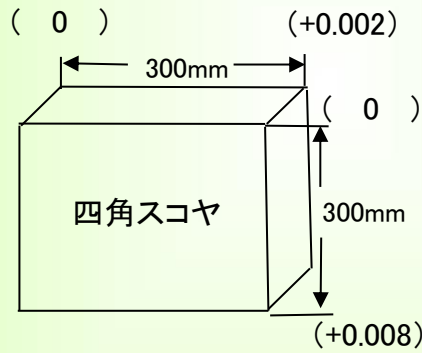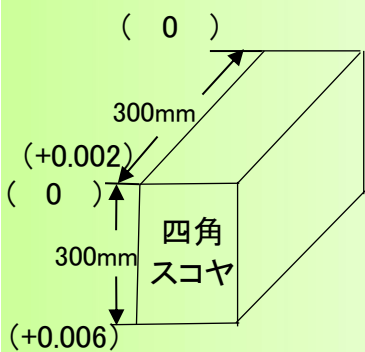

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

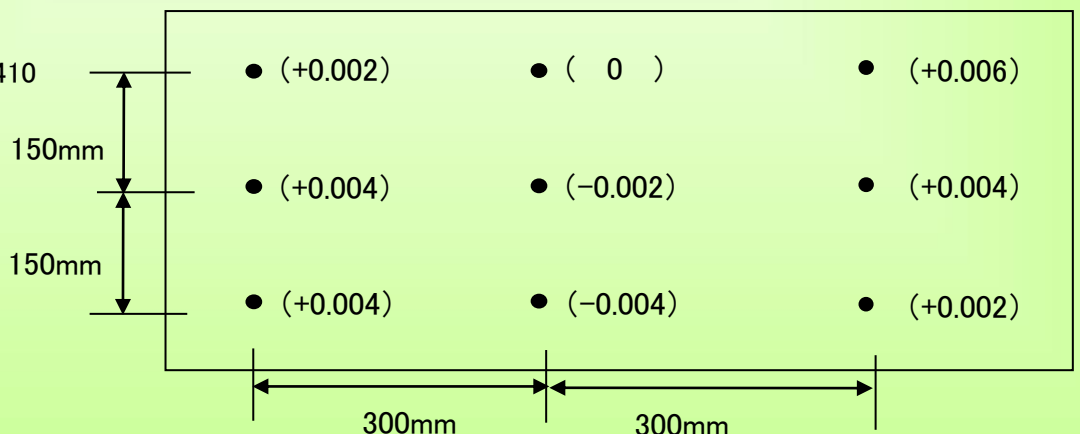

2022/11/09