


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1991年製	管理番号	H017075
型式	STM-2R	測定者	山口	アシスタント	

振り回し(150ピッチ)

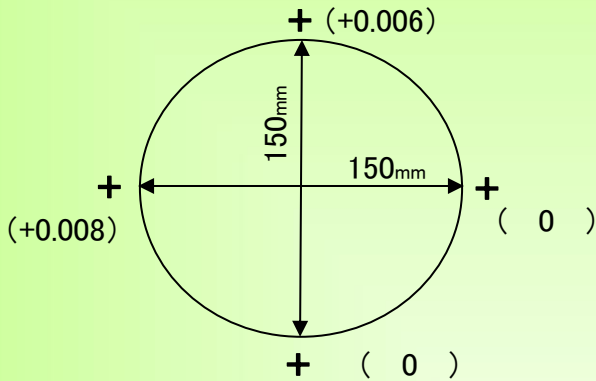

主軸振れ



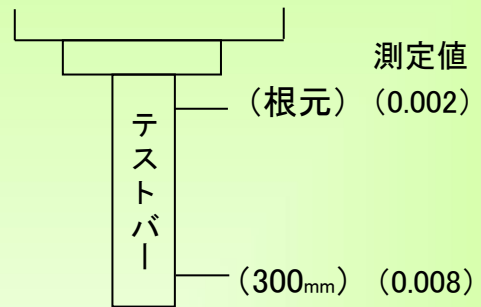


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.016)

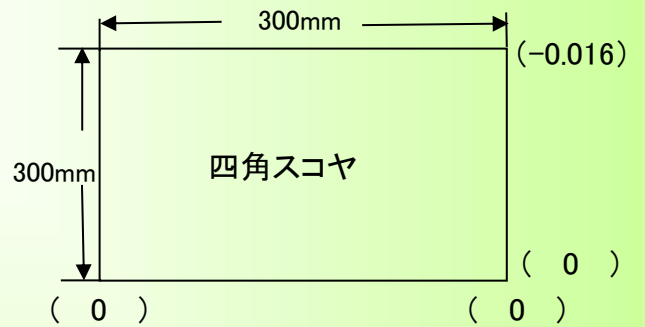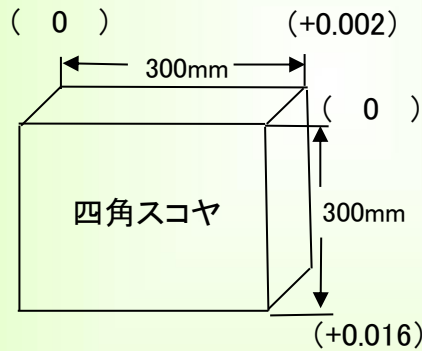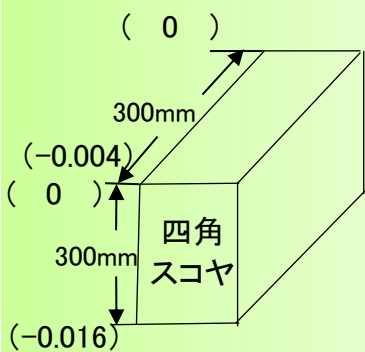

上面精度

※テーブルサイズ 1350×310

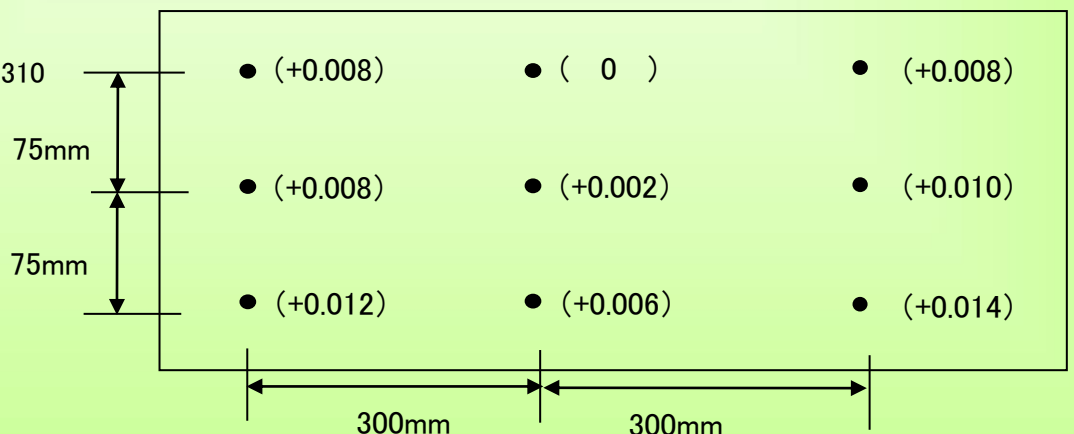

2022/11/14