


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2002年製	管理番号	P008042
型式	NV5000B/40	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

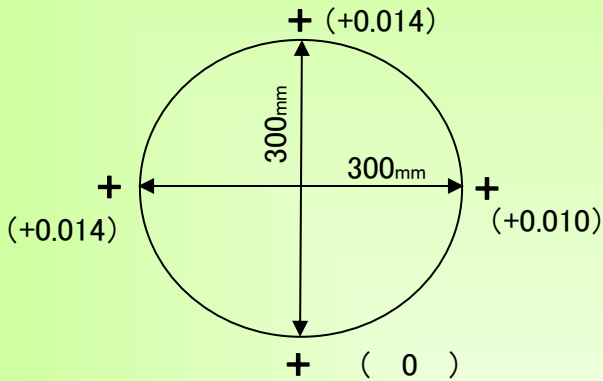

## 主軸振れ



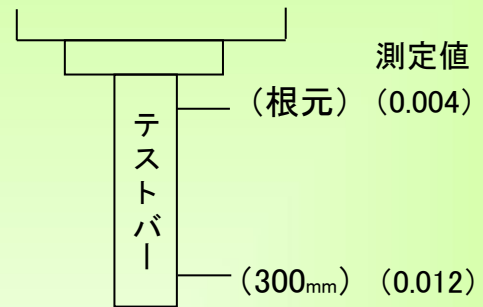


## 直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.008)

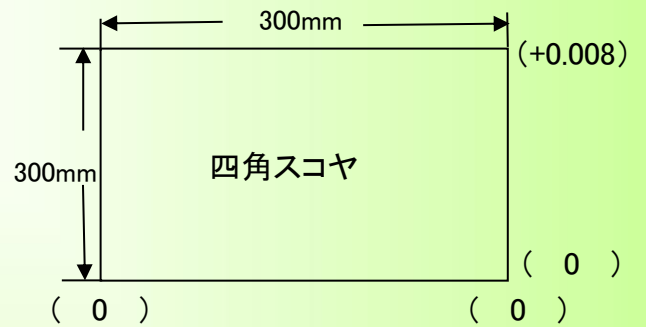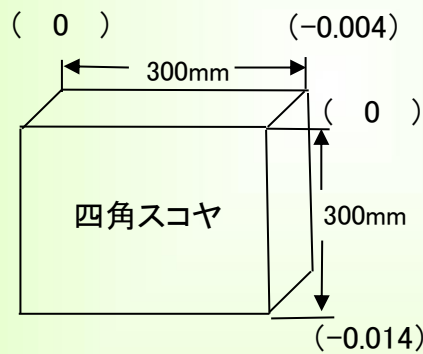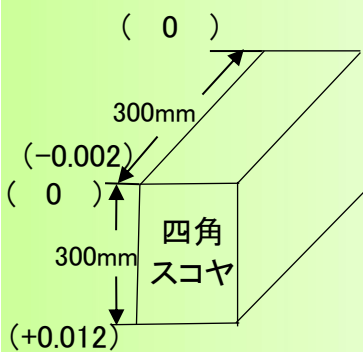

## 上面精度

※テーブルサイズ 1320×600

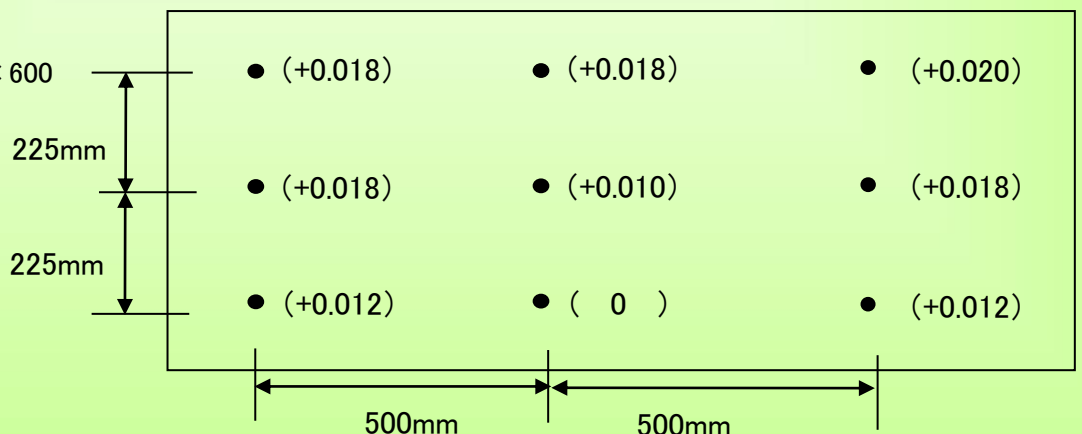

2022/11/30