


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ジェイテクト	年式	2015年製	管理番号	P008025
型式	FH400J	測定者	野辺沼	アシスタント	

Z軸方向の平行度

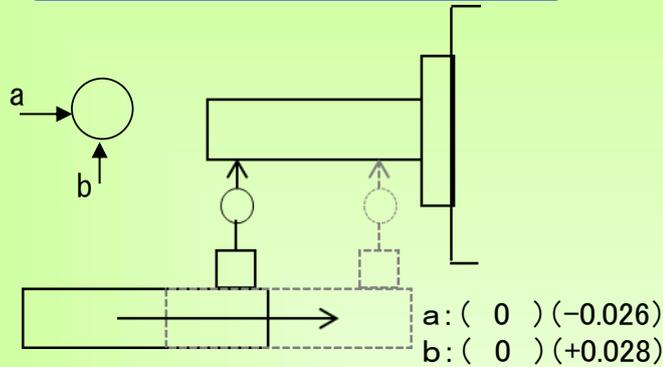

主軸振れ


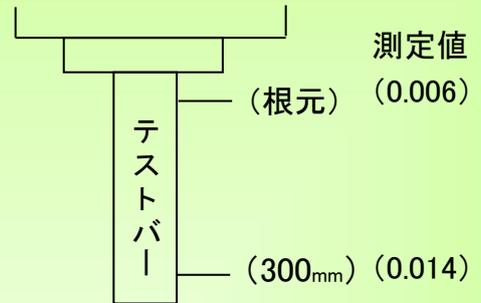


直角度

【XY】測定値 (0.020)

【ZY】測定値 (0.024)


【ZX】測定値 (0.010)

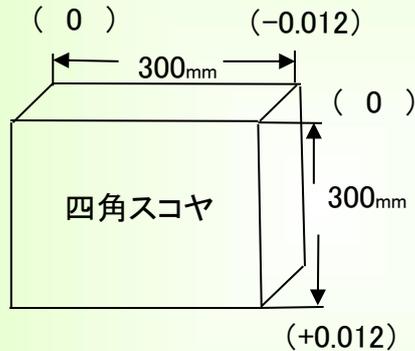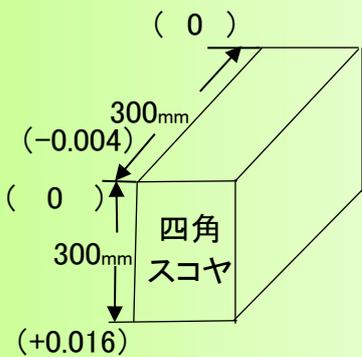

上面精度

テーブルサイズ: 400角

()パレット1
[]パレット2

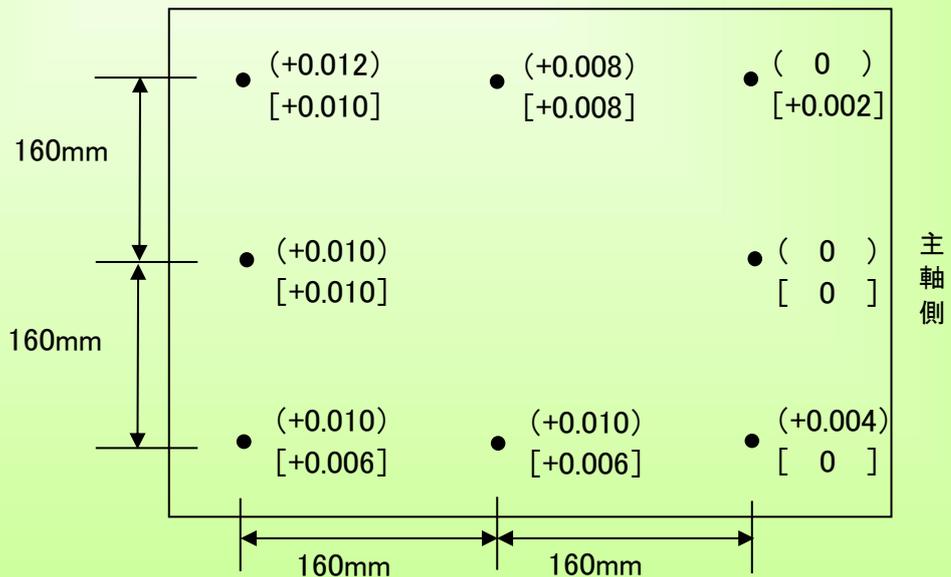

2022/12/19