


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2005年製	管理番号	P008019
型式	VM5III	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

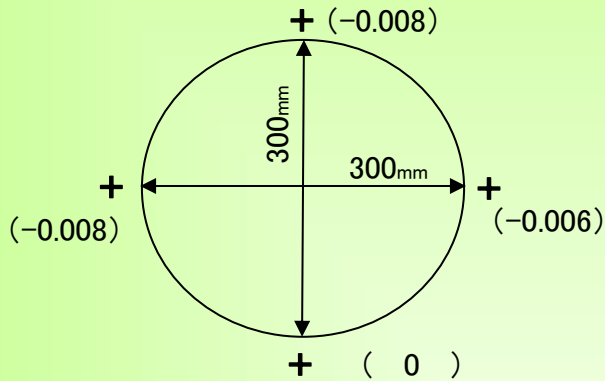

主軸振れ



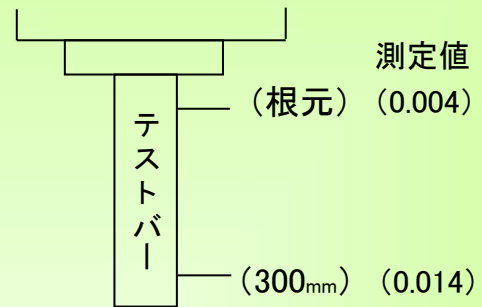


直角度


【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

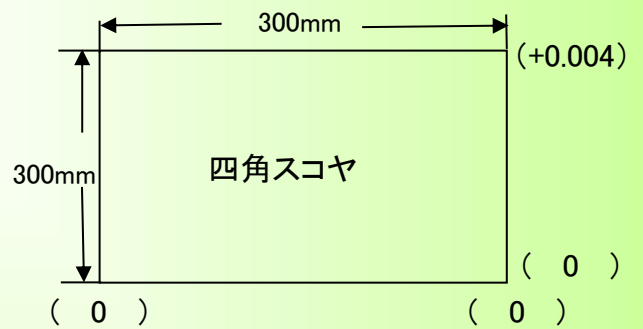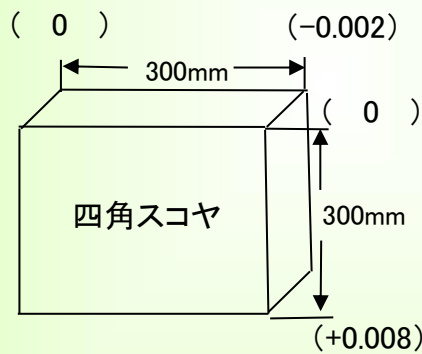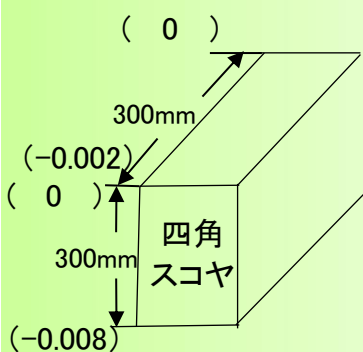

上面精度

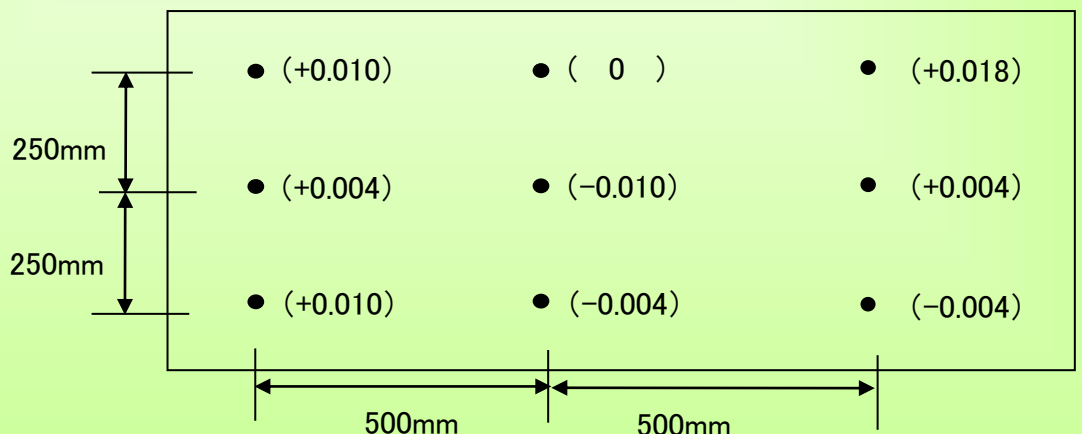

2023/1/17