


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2004年	管理番号	P007845
型式	VM4III	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

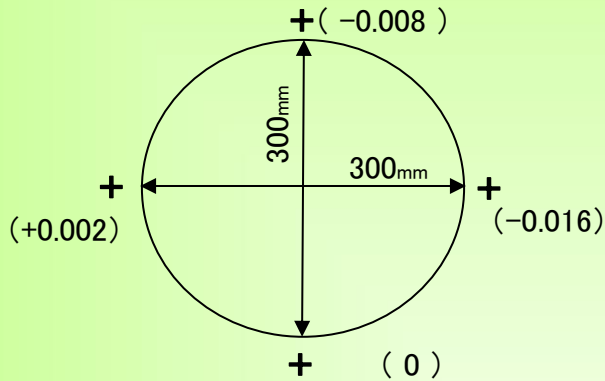

## 主軸振れ



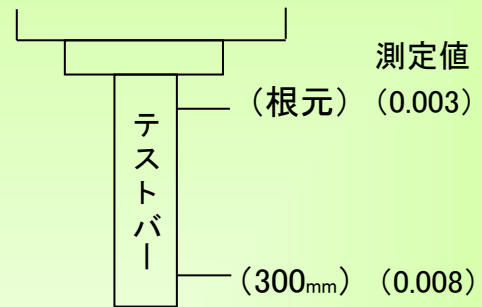


## 直角度

【YZ】測定値 (0.024)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.004)

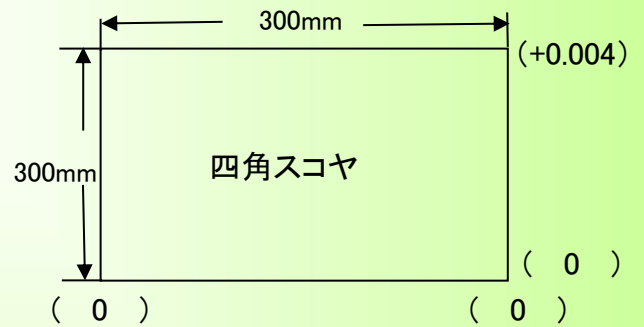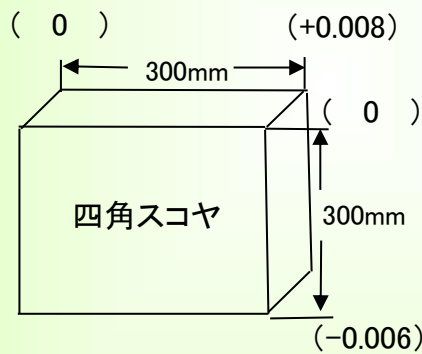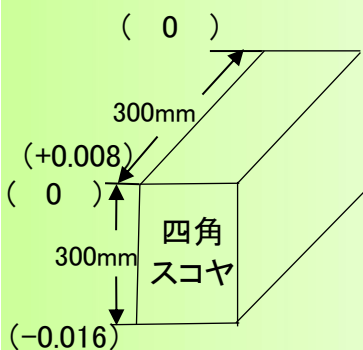

## 上面精度

※テーブルサイズ 800×410

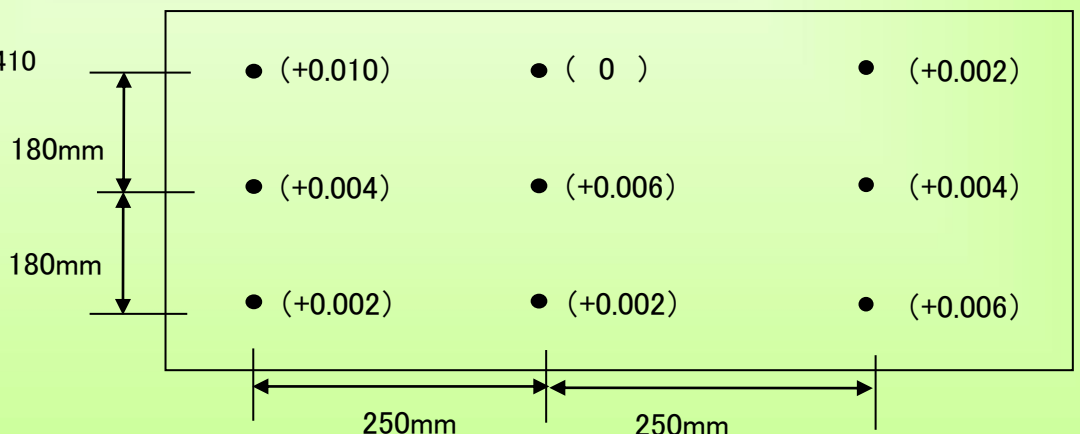

2023/5/17