


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2008年	管理番号	P008218
型式	MB-56VB	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

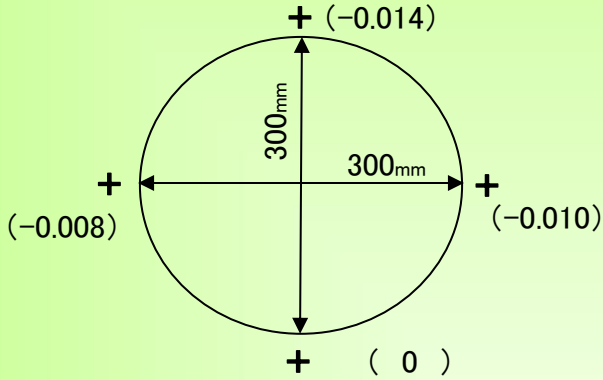

主軸振れ



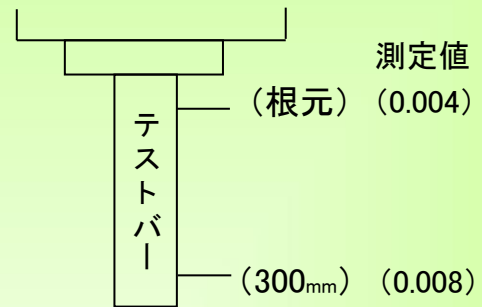


直角度

【YZ】測定値 (0.018)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.002)

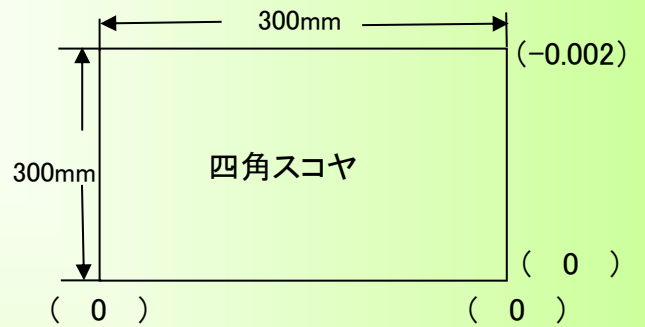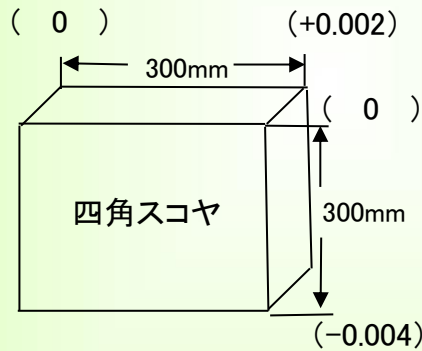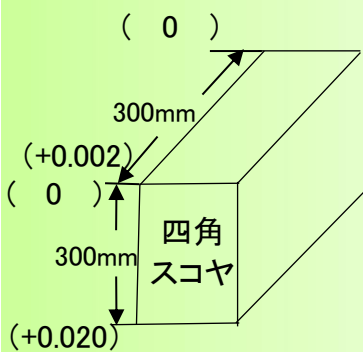

上面精度

※テーブルサイズ 1300×560

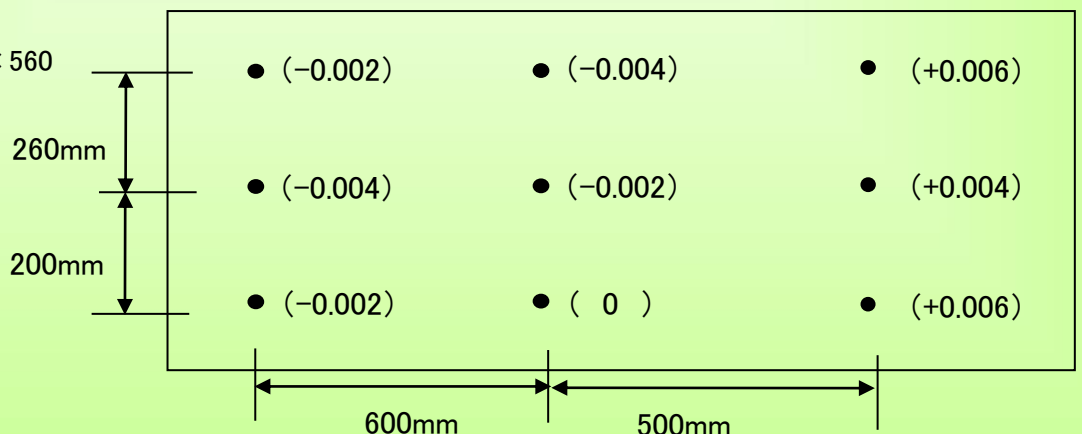

2023/6/1