


# 精度測定検査表


Examination for precision list

|      |        |     |       |        |         |
|------|--------|-----|-------|--------|---------|
| メーカー | ブラザー   | 年式  | 2020年 | 管理番号   | P008131 |
| 型式   | S300X2 | 測定者 | 金子    | アシスタント |         |

## 振り回し(200ピッチ)

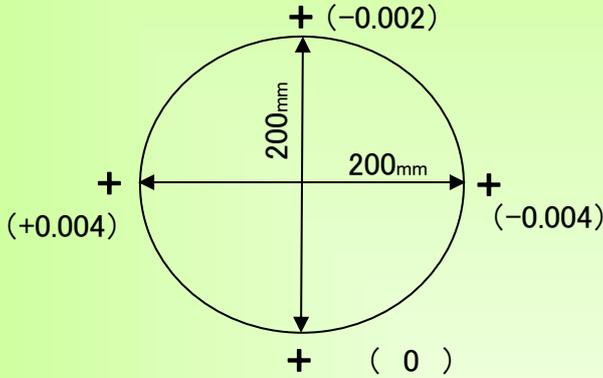

## 主軸振れ



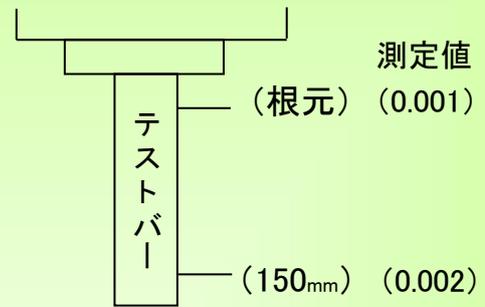


## 直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.002)

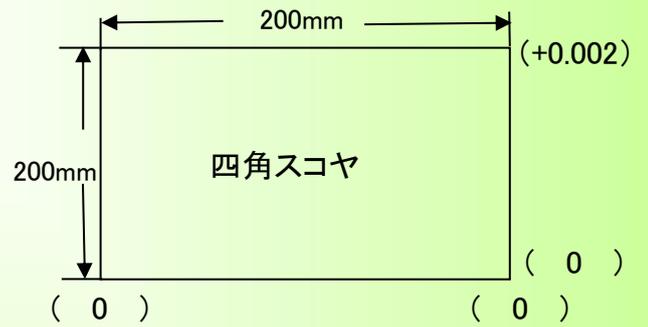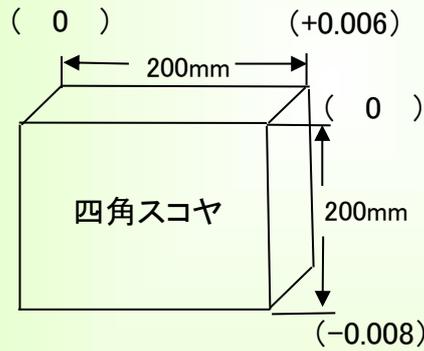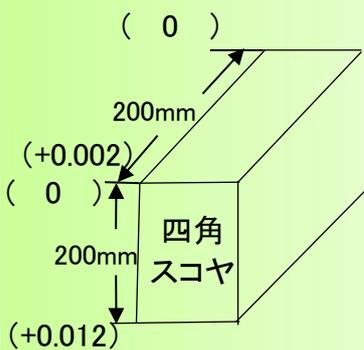

## 上面精度

※テーブルサイズ 600×400

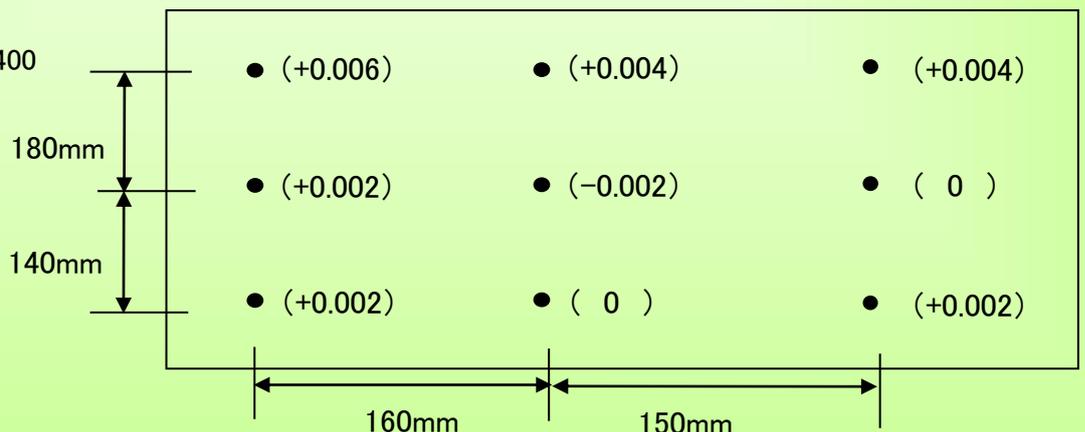

2023/6/19