


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|----------|-----|-------|--------|---------|
| メーカー | 安田工業 | 年式 | 1998年 | 管理番号 | P008187 |
| 型式 | YBM-640V | 測定者 | 金子 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

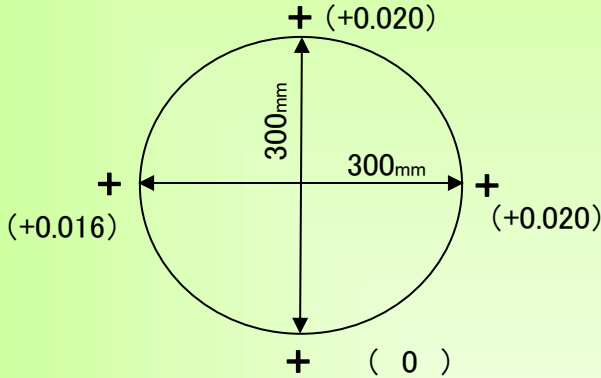

主軸振れ



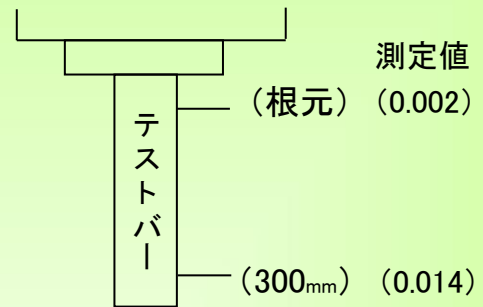


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.004)

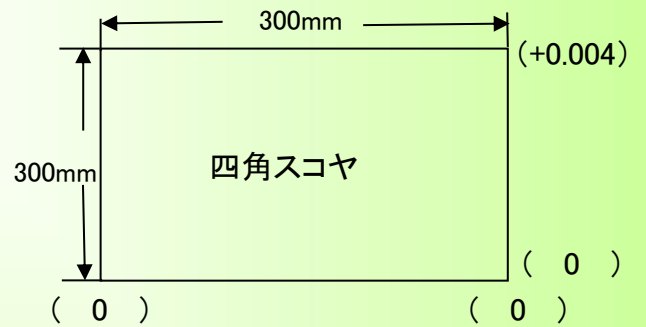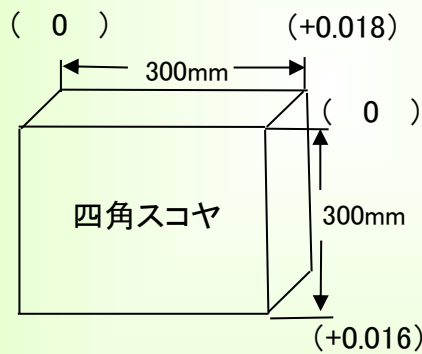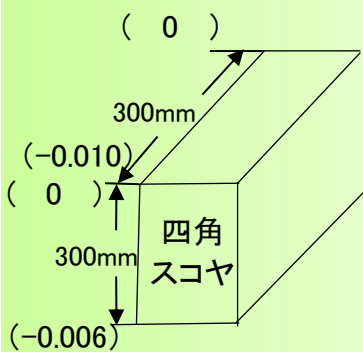

上面精度

※テーブルサイズ 700×450

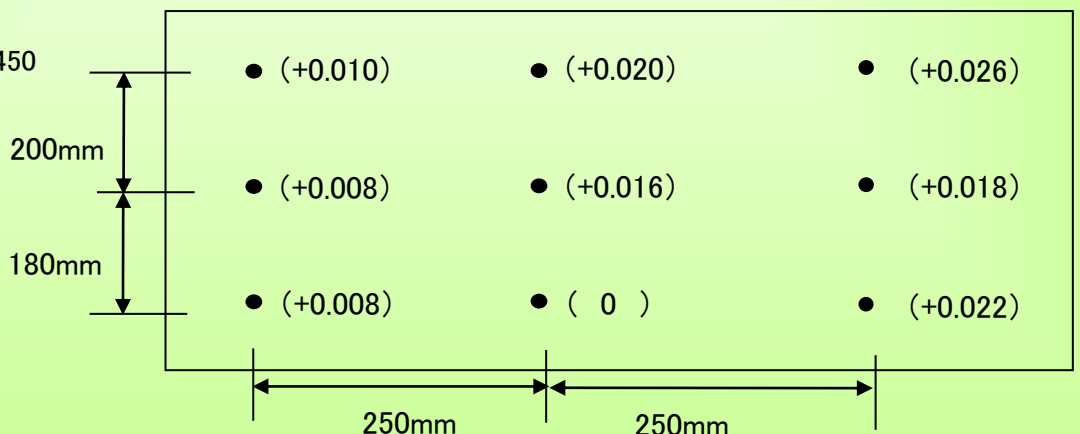

2023/7/3