


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2005年	管理番号	P008244
型式	MB-56VA	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

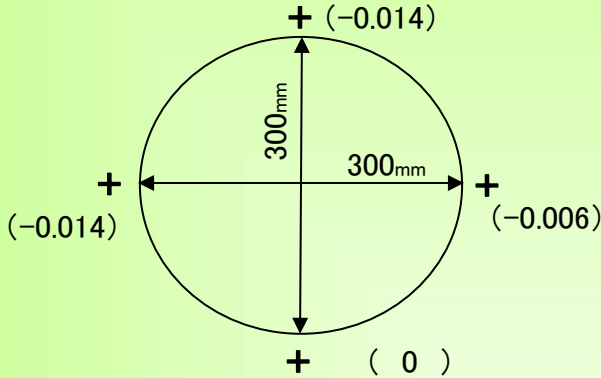

主軸振れ



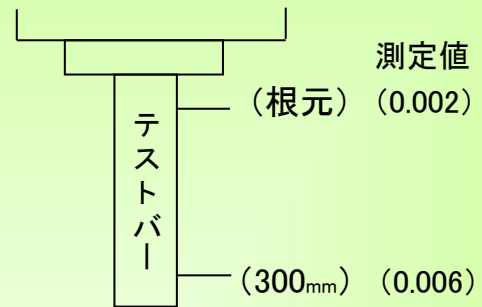


直角度

【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.010)

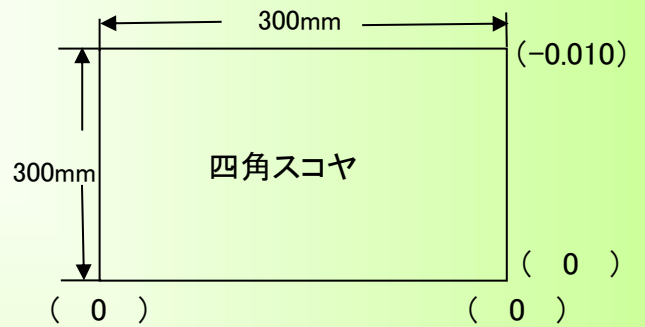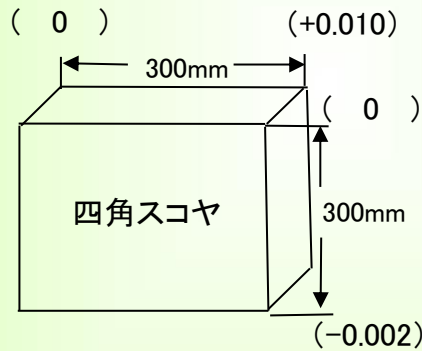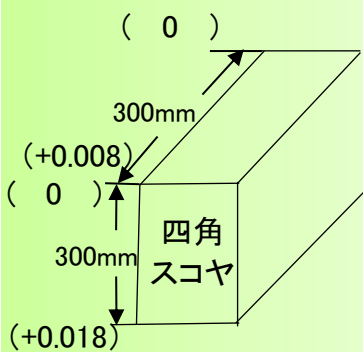


上面精度

※テーブルサイズ 1300×530

● No.1

◆ No.2

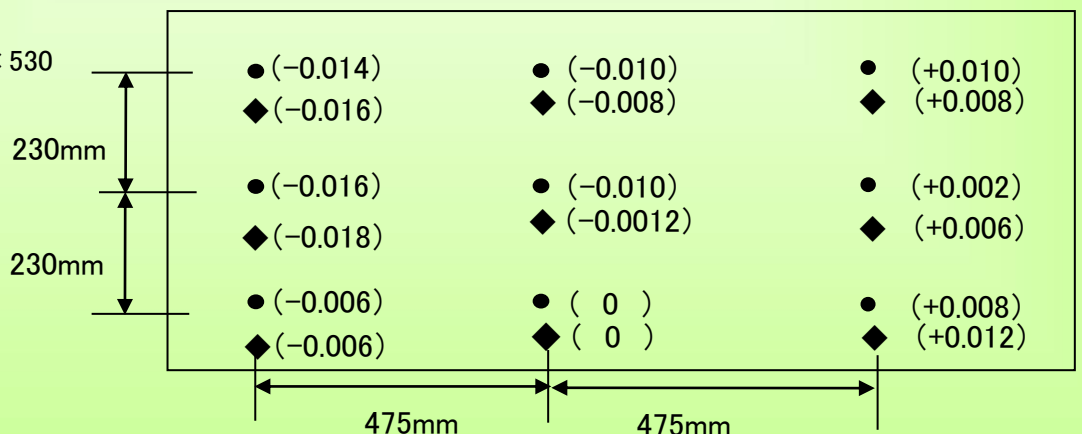

2023/7/6