


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2001	管理番号	P008278
型式	SNC64-A15	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

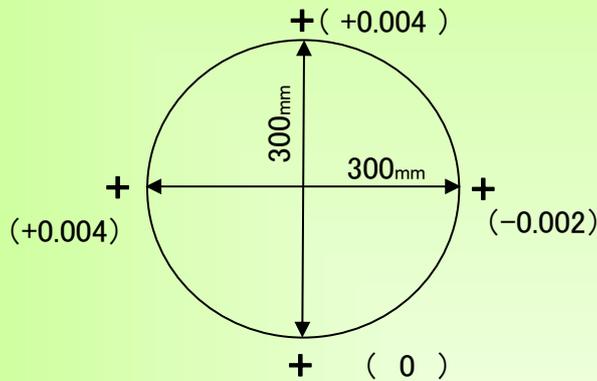

主軸振れ



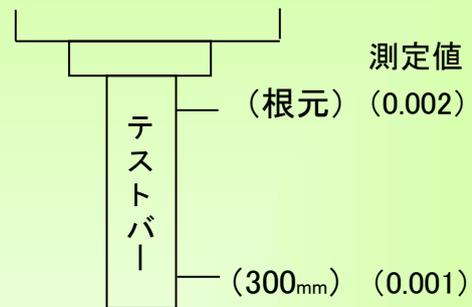


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.002)

【X Y】測定値 (0.024)

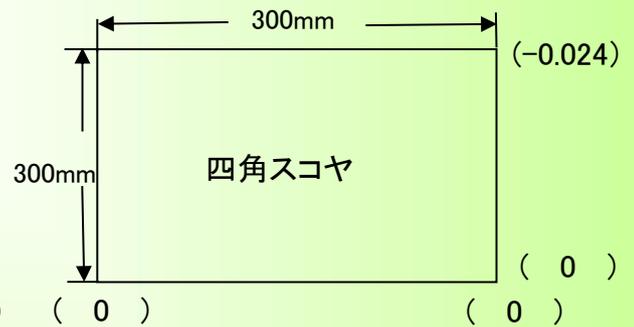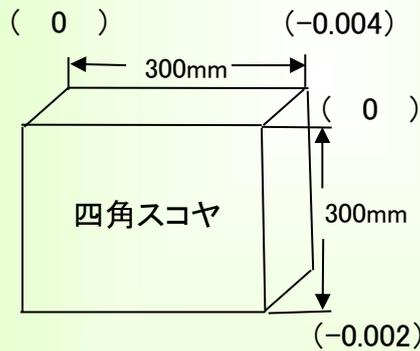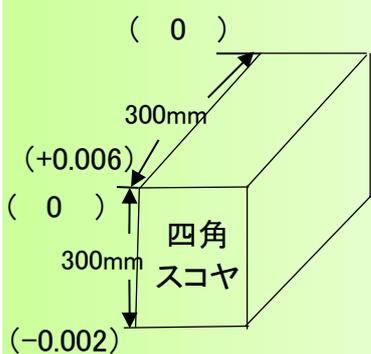

上面精度

※テーブルサイズ 750×400

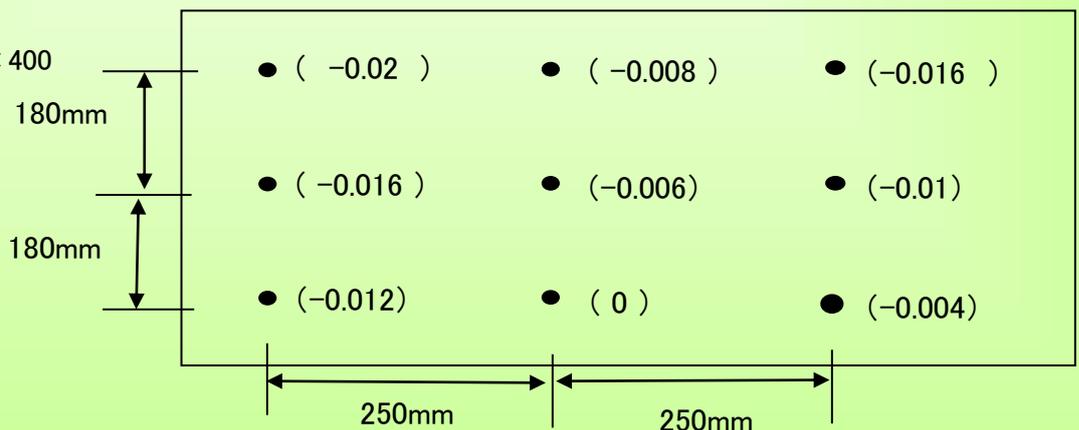

2023/7/25