


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2005	管理番号	P008284
型式	MILLAC-468V	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

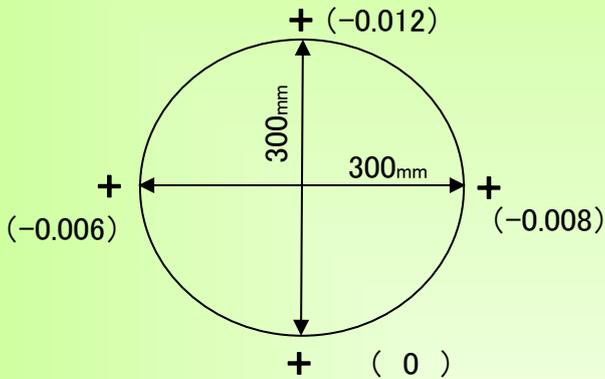

主軸振れ


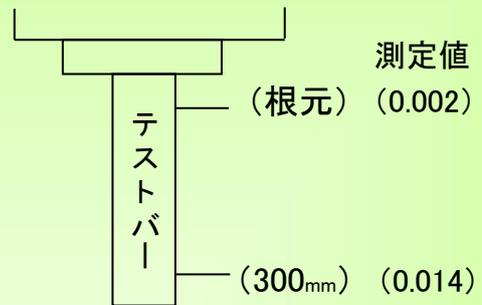


直角度

【YZ】 測定値 (0.012)


【XZ】 測定値 (0.004)

【XY】 測定値 (0.006)

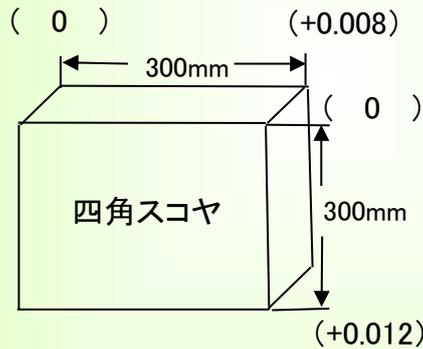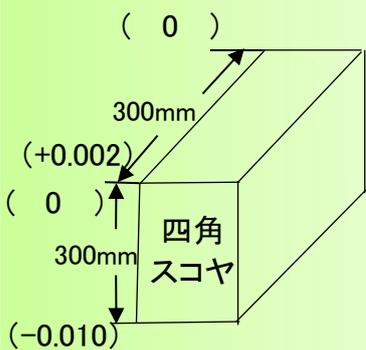

上面精度

※テーブルサイズ 1050 × 460

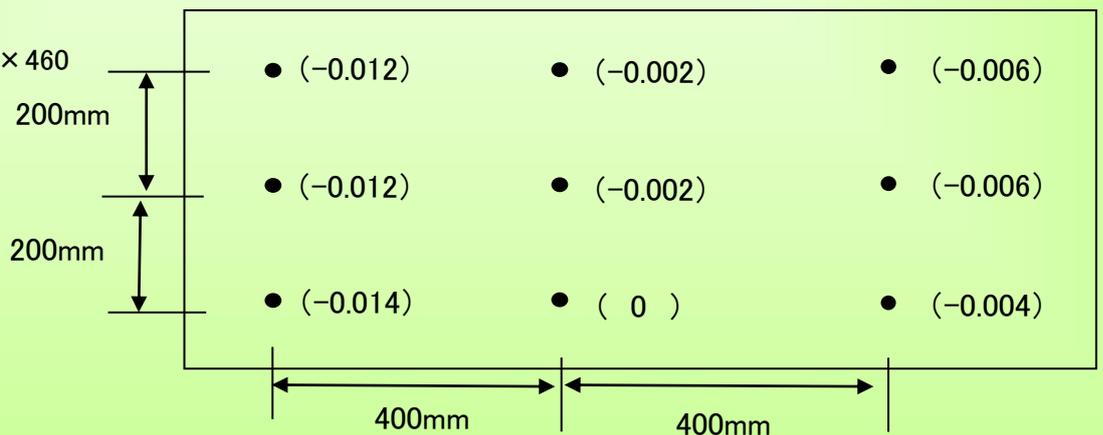

2023/8/17