


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ニイガタ・マシンリー・サービス	年式	2006	管理番号	P008149
型式	JK1500	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

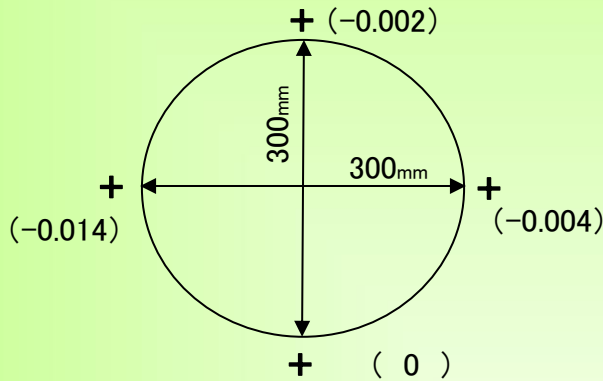

主軸振れ



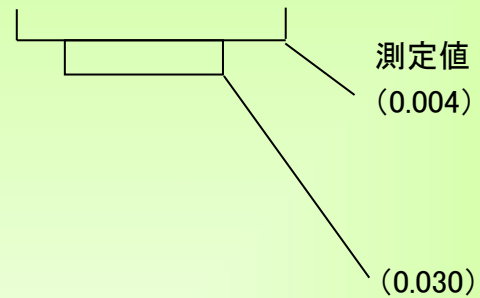


直角度

【YZ】 測定値 (+0.096)


【XZ】 測定値 (+0.020)

【XY】 測定値 (0.008)

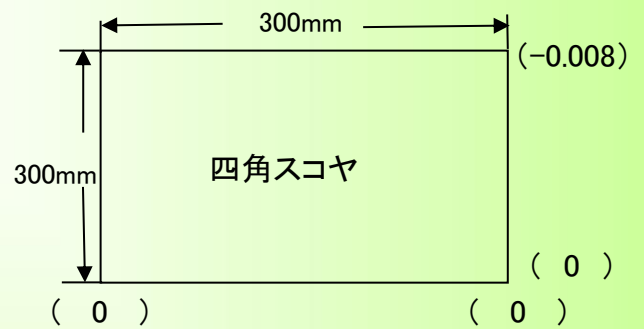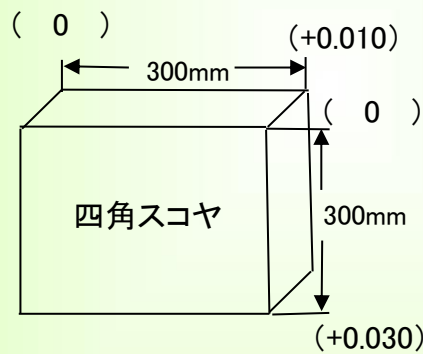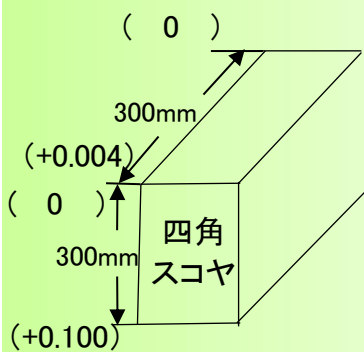

上面精度

※テーブルサイズ 1490×2670

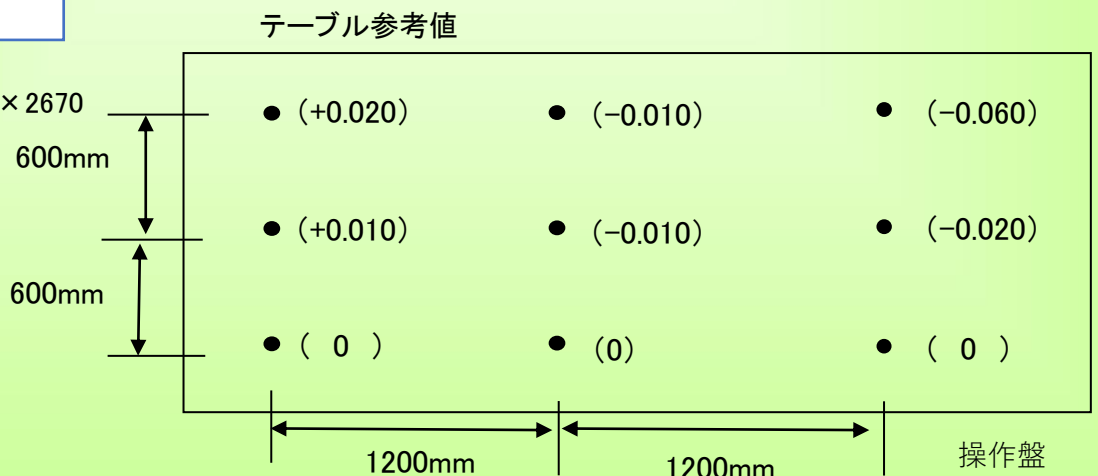

2023/8/17