


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2011	管理番号	G004872
型式	NMH10000DCG	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

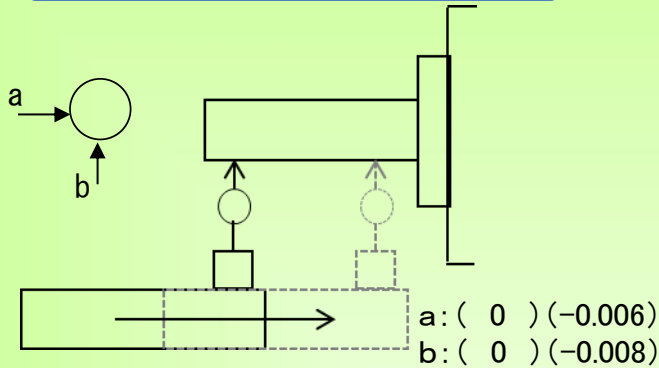

主軸振れ



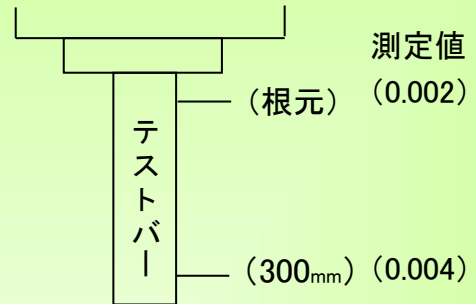


直角度

【XY】測定値 (0.004)

【ZY】測定値 (0.004)

【ZX】測定値 (0.008)

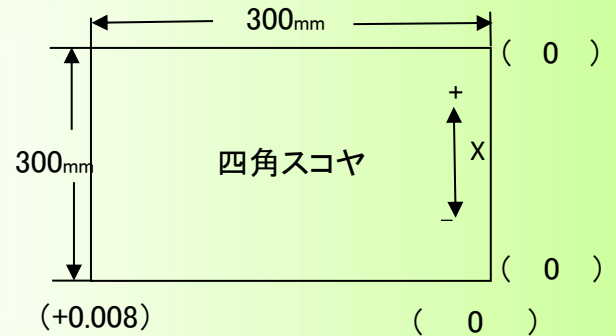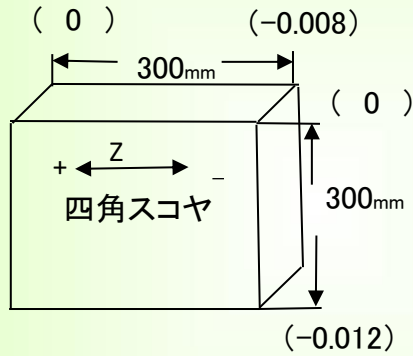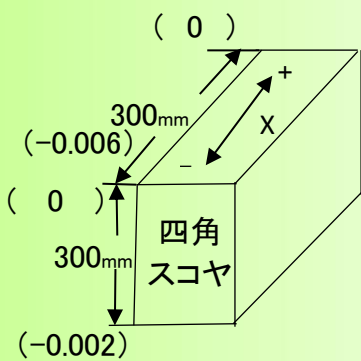


上面精度

テーブルサイズ: 1000角

()パレット1 (4)

[]パレット2 (2)

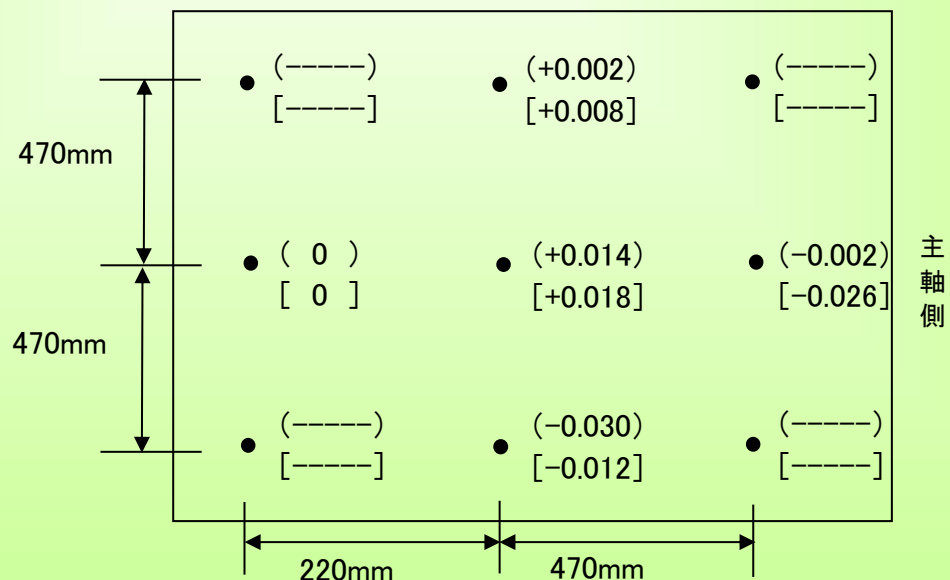

2023/8/26