


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	倉敷機械	年式	2003	管理番号	H017475
型式	KBM-11X	測定者	仙田	アシスタント	

Z軸方向の平行度

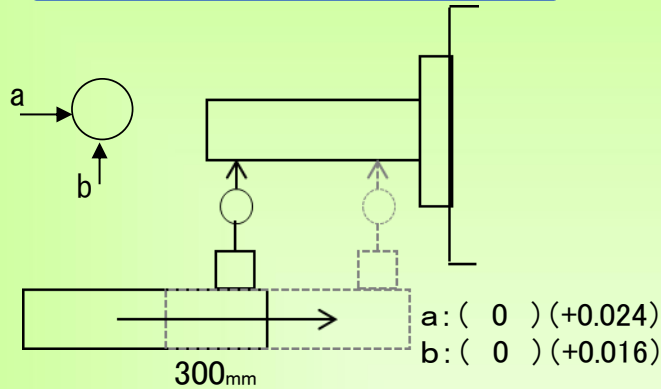

主軸振れ

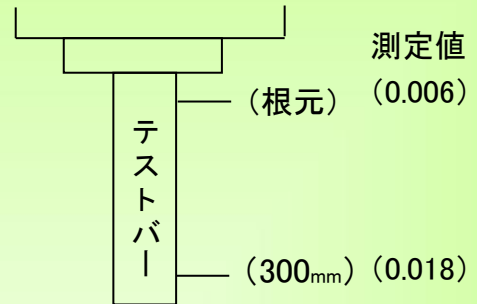




直角度

【XY】 測定値 (0.024)

【ZY】 測定値 (0.024)

【ZX】 測定値 (0.024)


W軸(0) → (-0.008)
Z軸(0) (-0.010)

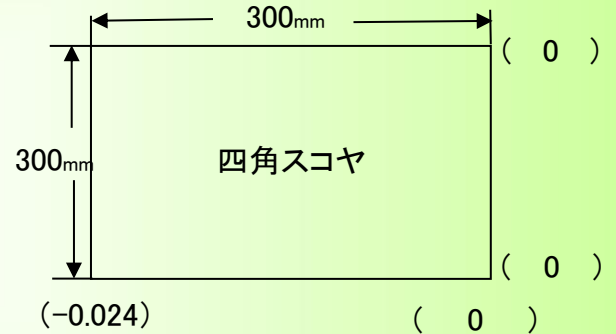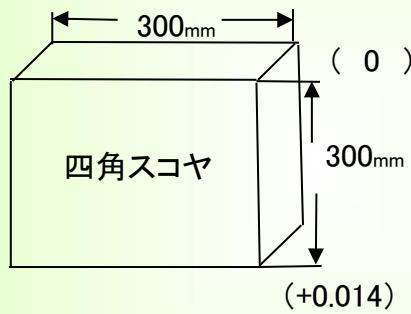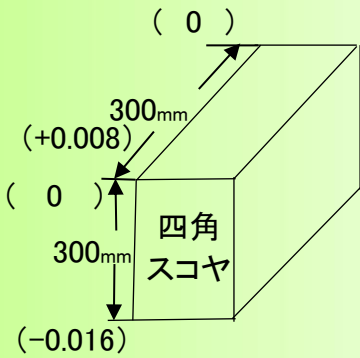

上面精度

テーブルサイズ: 950 × 1050

() → パレット1

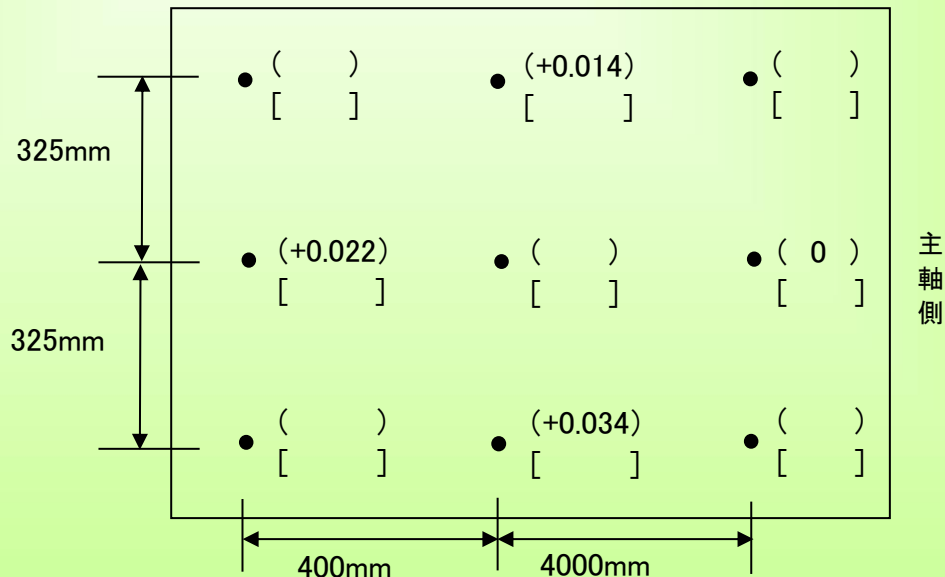

2023/9/4