


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2008	管理番号	P008225
型式	V56	測定者	金子 晶生	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

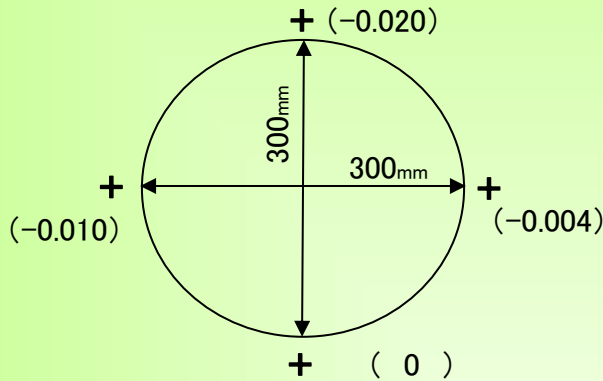

主軸振れ



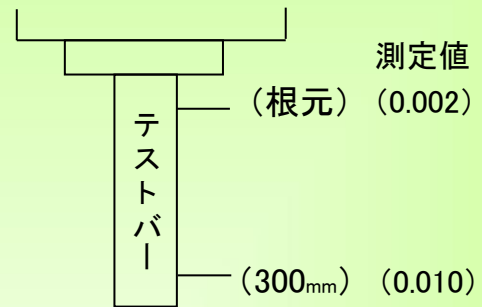


直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.010)

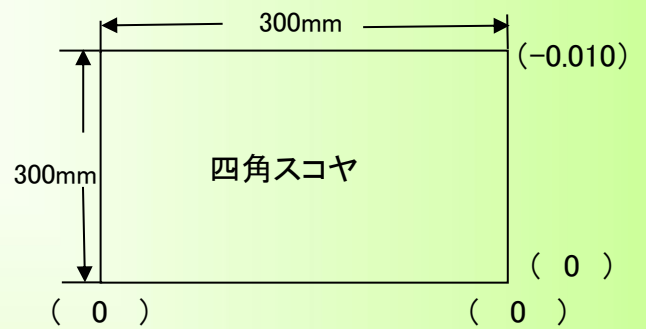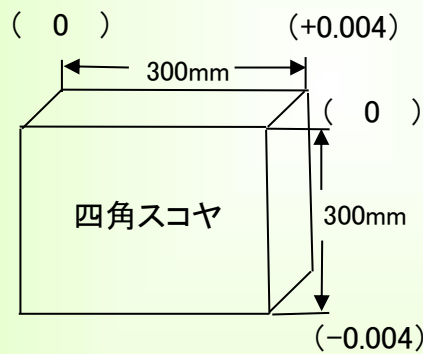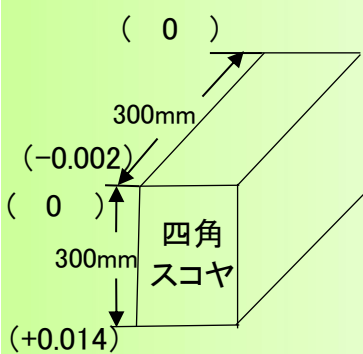

上面精度

※テーブルサイズ 1050 × 550

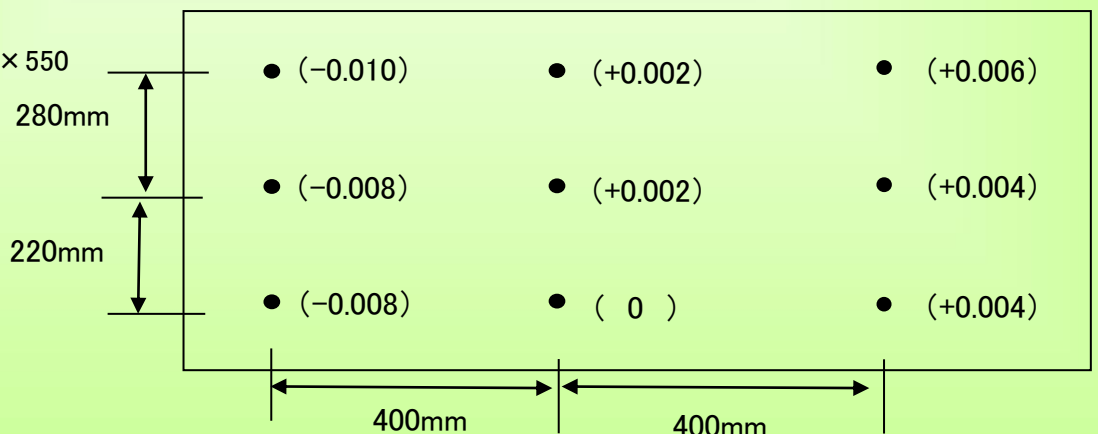

2023/9/20