


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2012.12	管理番号	P008332
型式	α -D21LiA5	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

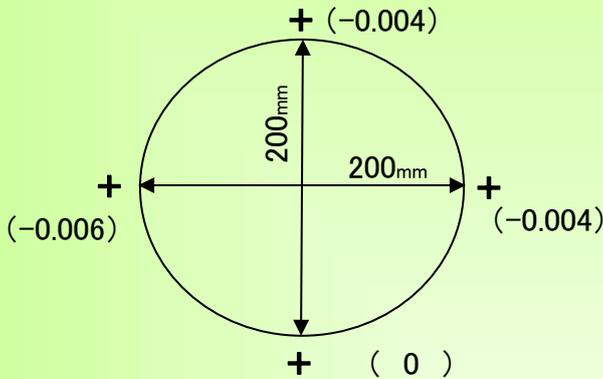

主軸振れ



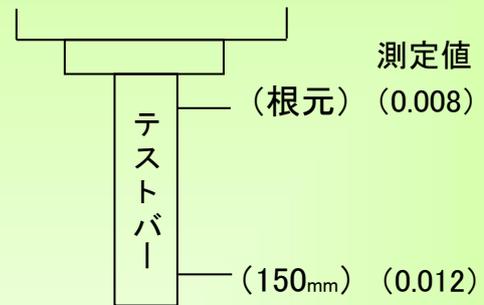


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.004)

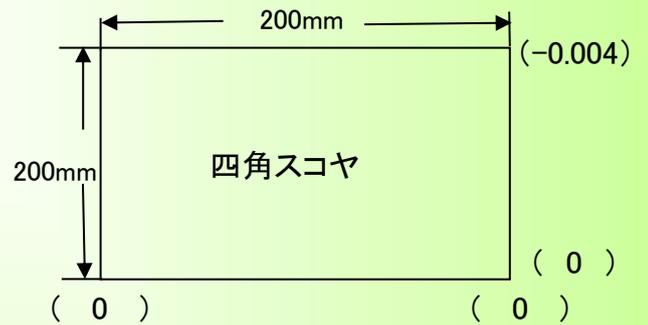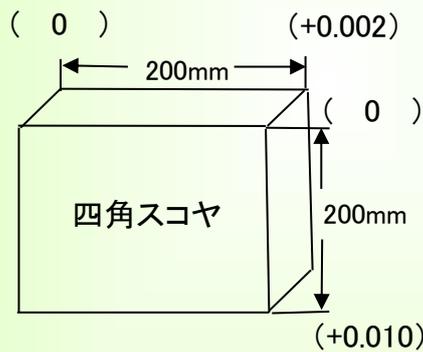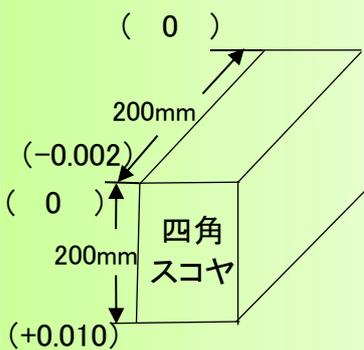

上面精度

※テーブルサイズ 410×850

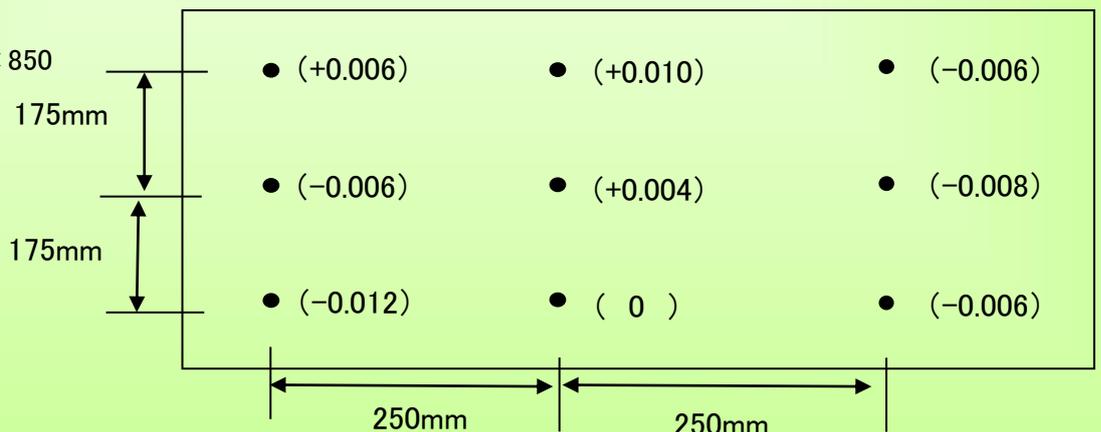

2023/10/23