


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2006	管理番号	P008359
型式	NH4000DCG	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

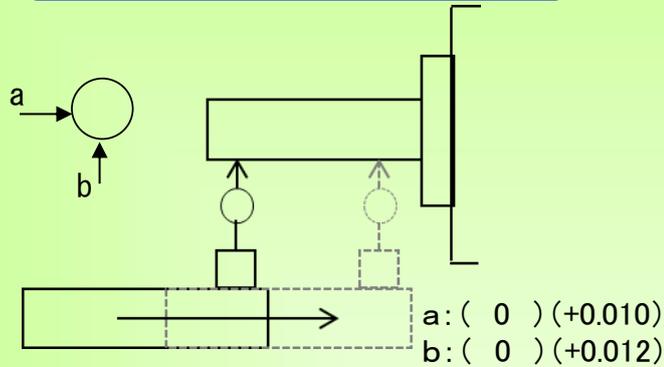

主軸振れ


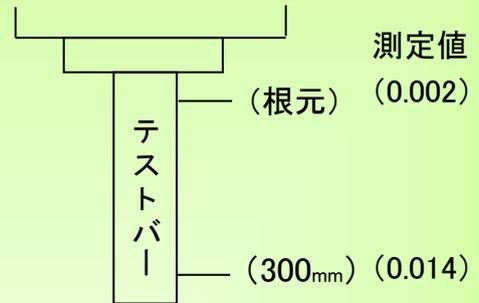


直角度

【XY】測定値 (0.006)

【ZY】測定値 (0.004)

【ZX】測定値 (0.002)

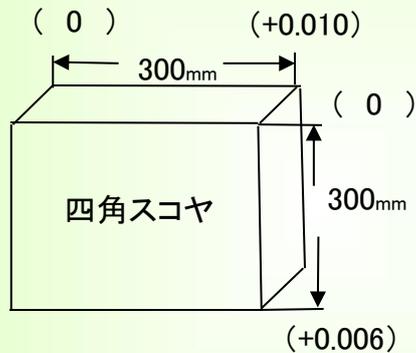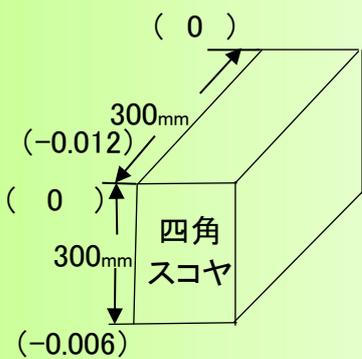


上面精度

テーブルサイズ: 400角

()パレット1

[]パレット2

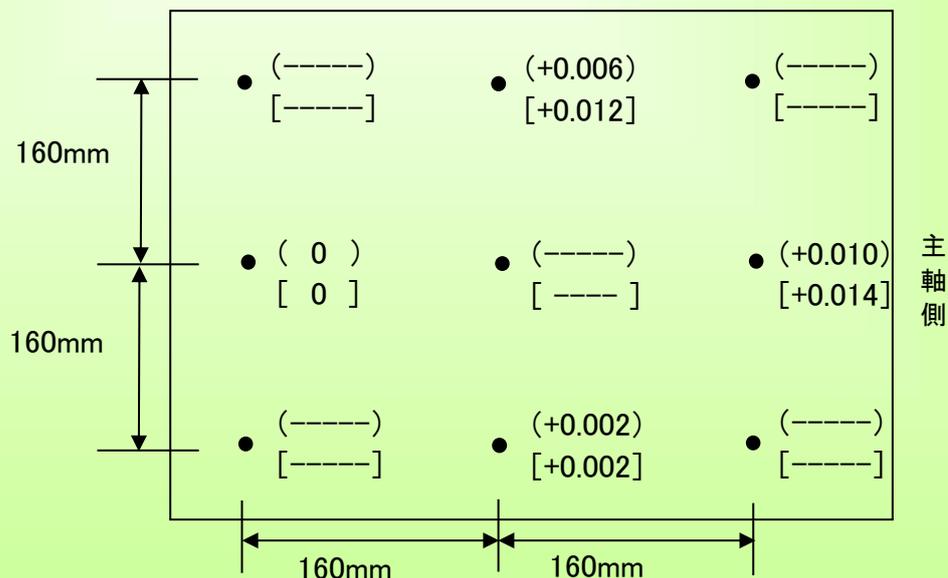

2023/10/23