


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	池貝	年式	2000年製		バーコード	P006532	
型式	TVU4R	当社評価	A	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

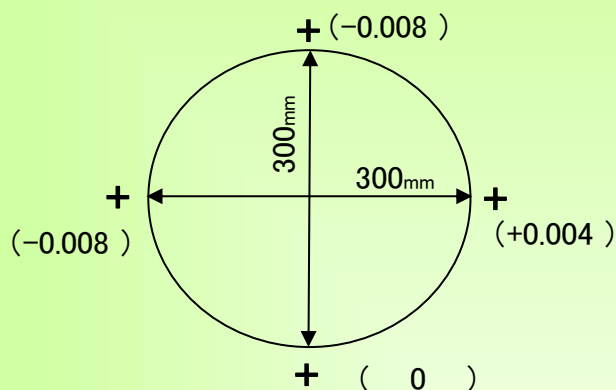




主軸振れ

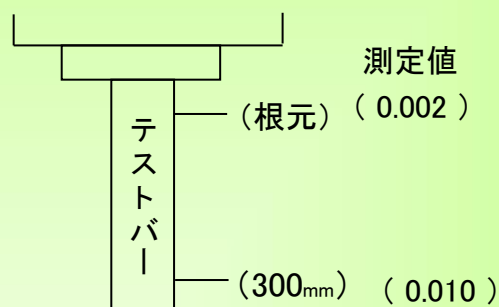

直角度

【Y Z】測定値 (0.014) 【X Z】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.006)

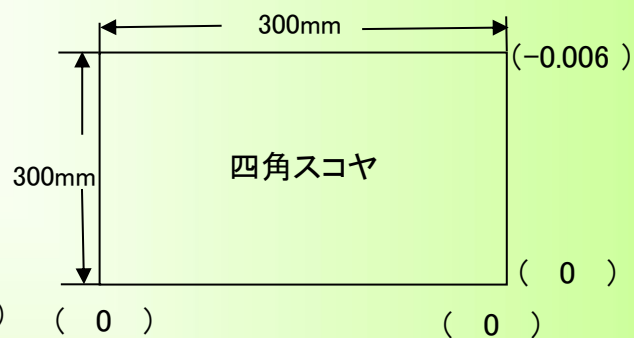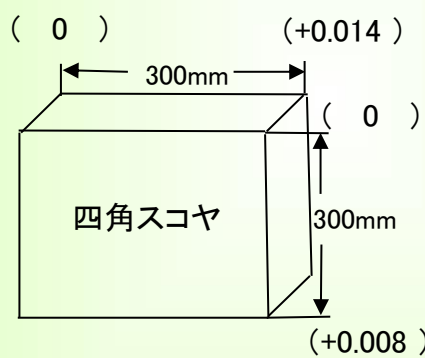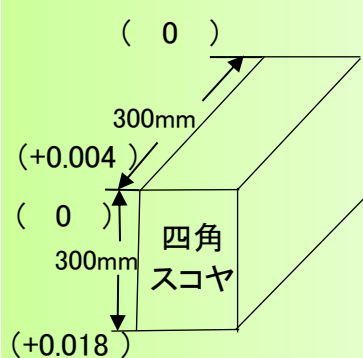

上面精度

※テーブルサイズ 700×420

