


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2000	管理番号	H018077
型式	KEVA-55	測定者	仙田	アシスタント	蔵内

振り回し(300ピッチ)

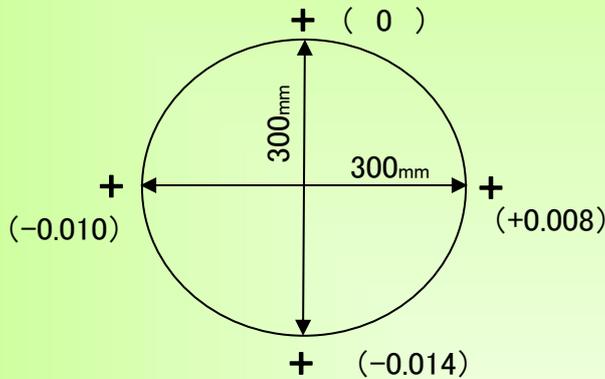

主軸振れ



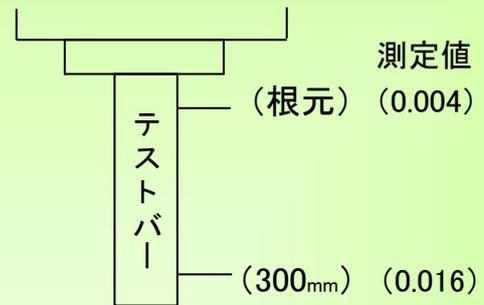


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.012)

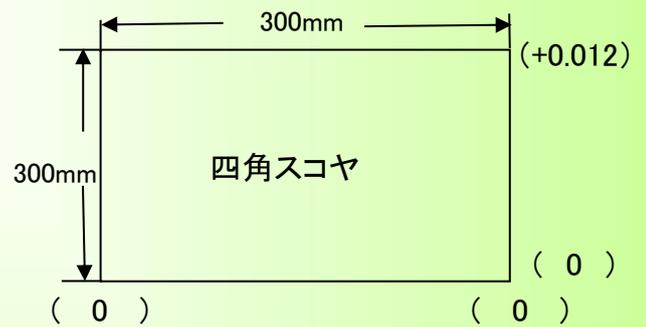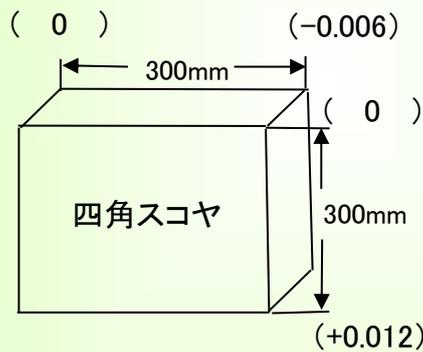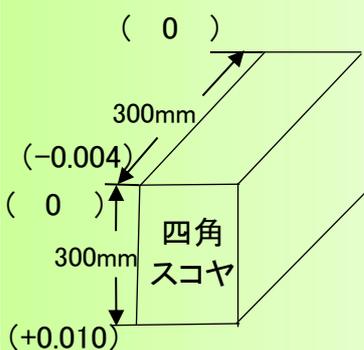

上面精度

※テーブルサイズ 375 × 800

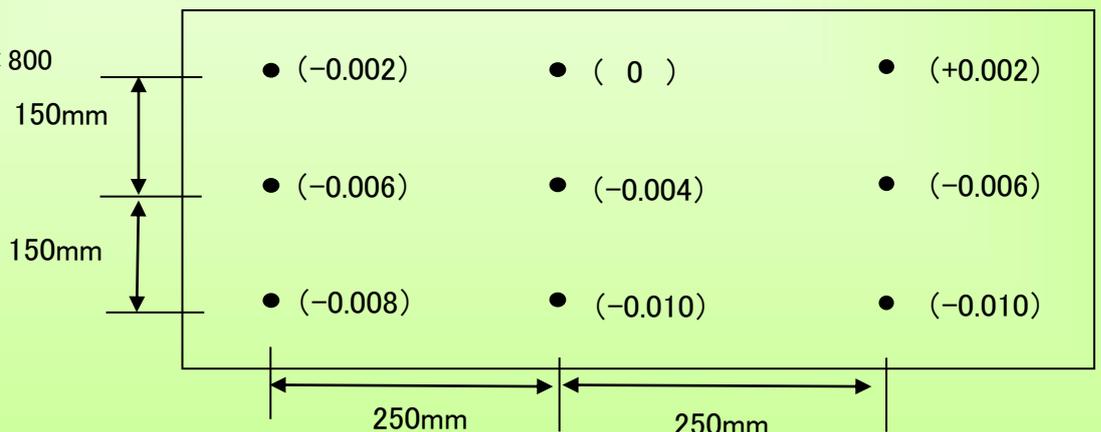

2023/10/26