


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	OKK	年式	2007	管理番号	P008296
型式	VM7III	測定者	金子晶生・近藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

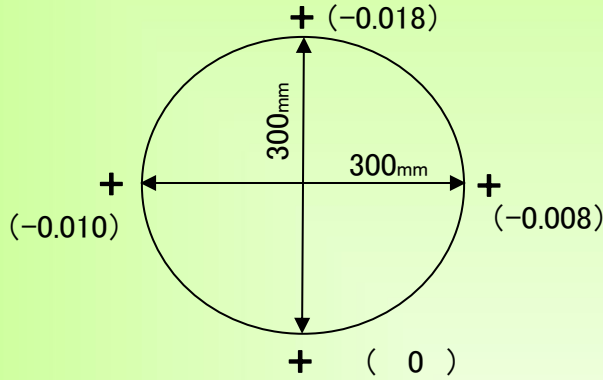

## 主軸振れ



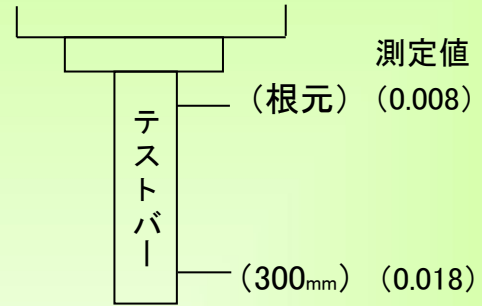


## 直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.010)

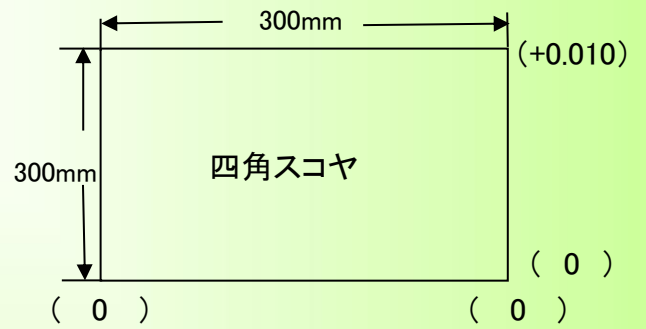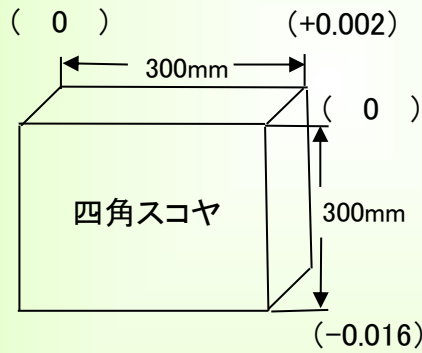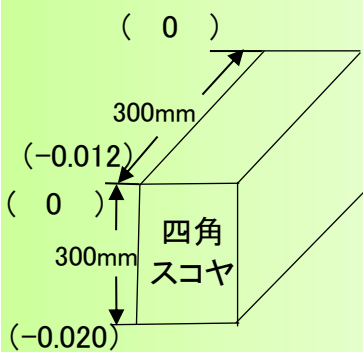

## 上面精度

※テーブルサイズ 1550 × 740

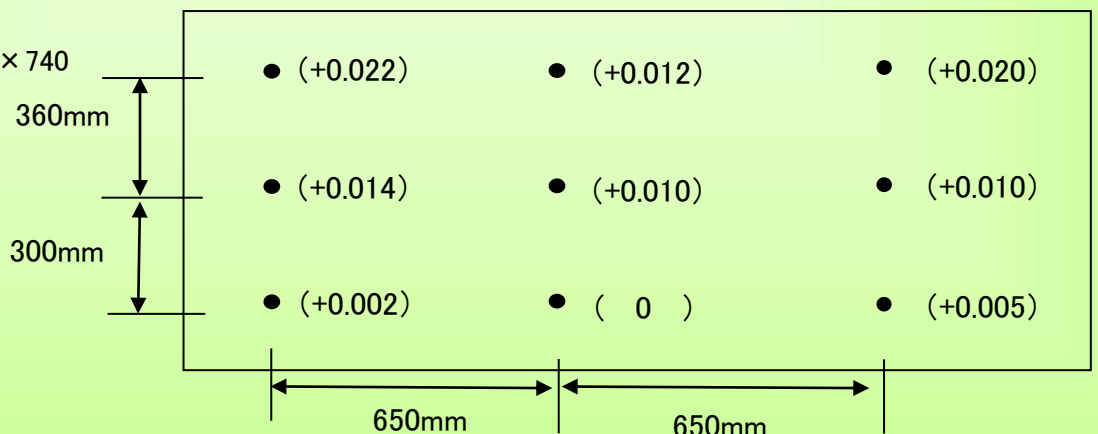

2023/10/30