


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2006	管理番号	P008408
型式	VM5III	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

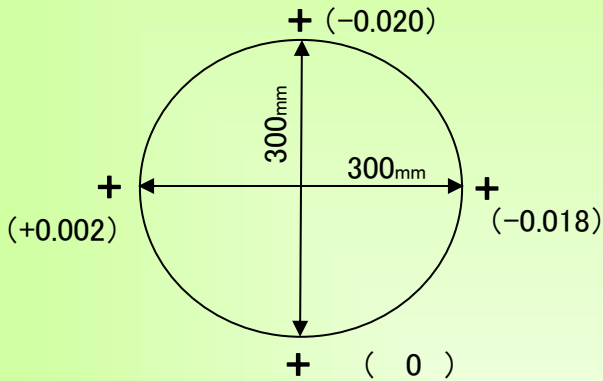

## 主軸振れ



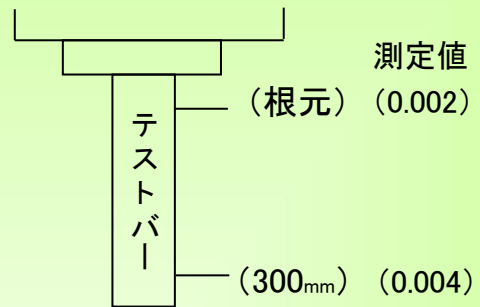


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.020)

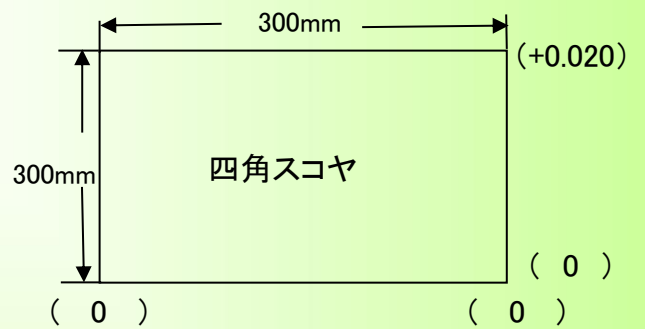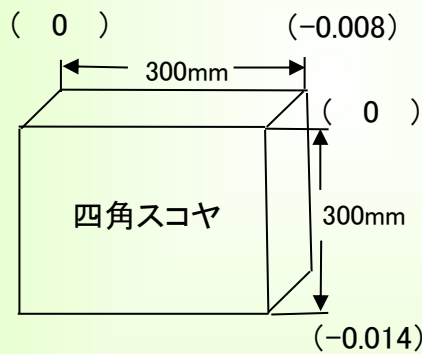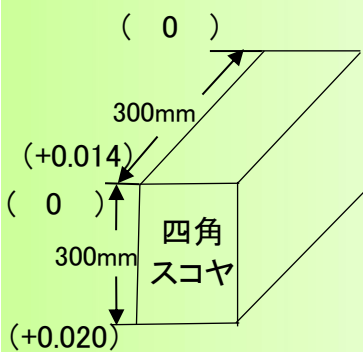

## 上面精度

※テーブルサイズ 1250×560

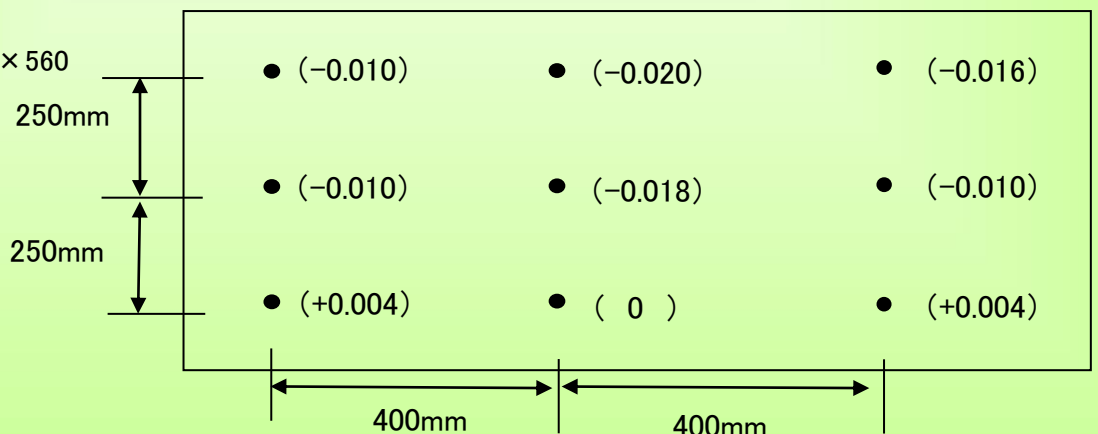

2023/11/21