


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|---------------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | 北村 | 年式 | 2017 | 管理番号 | P008214 |
| 型式 | Mycenter-4XiD | 測定者 | 武藤 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

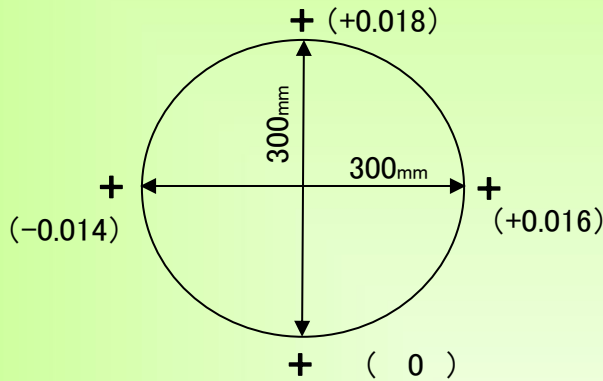

主軸振れ



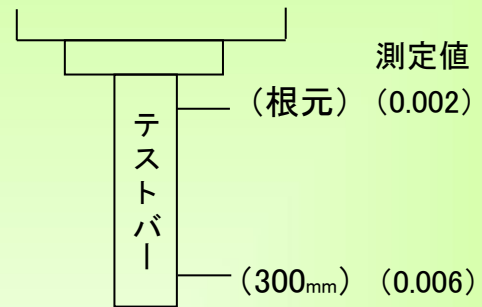


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.022)

【XY】測定値 (0.018)

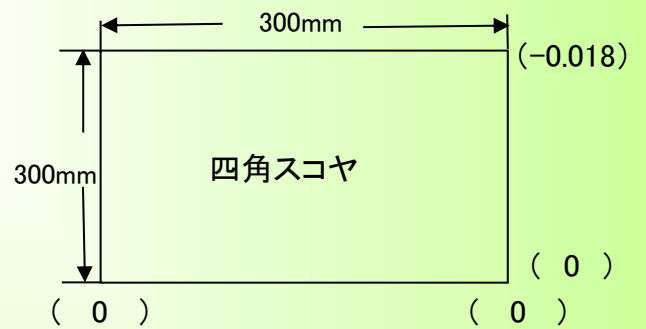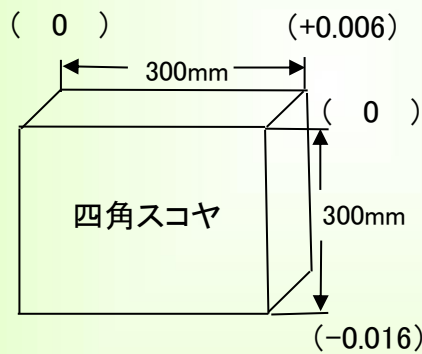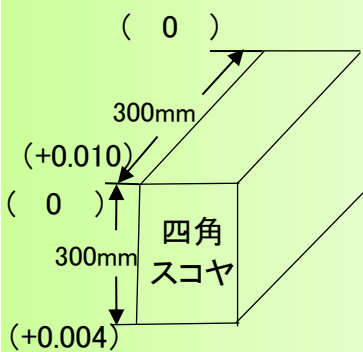

上面精度

※テーブルサイズ 1120×500

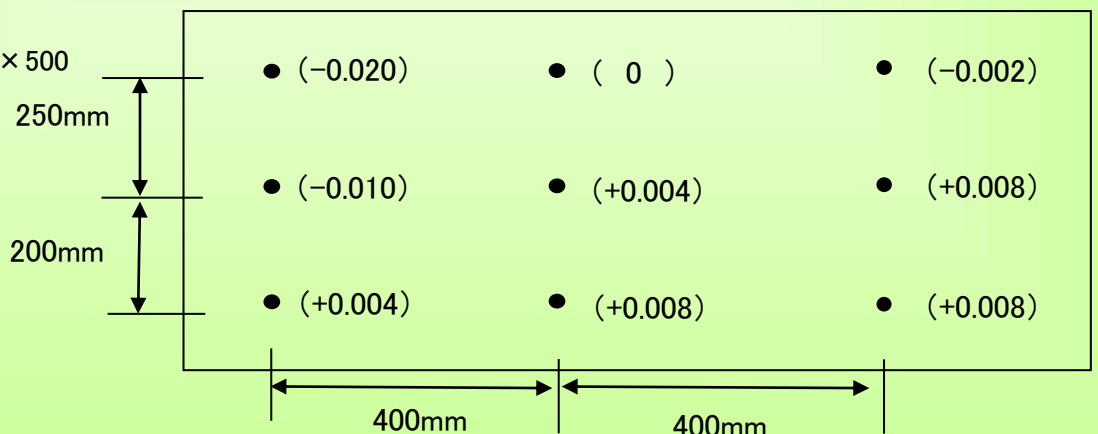

2023/12/23