


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	1995	管理番号	H017275
型式	YZ-8CR	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

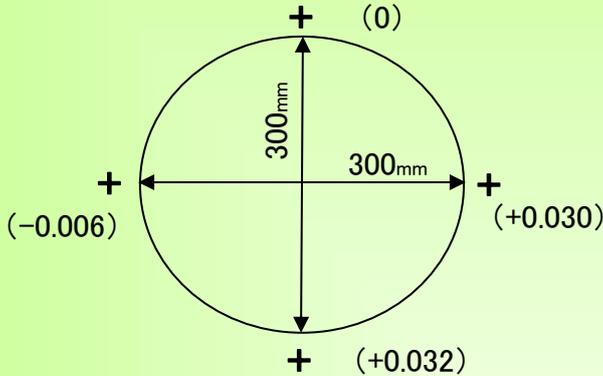

主軸振れ



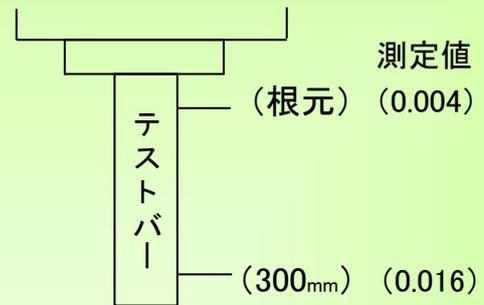


直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.012)

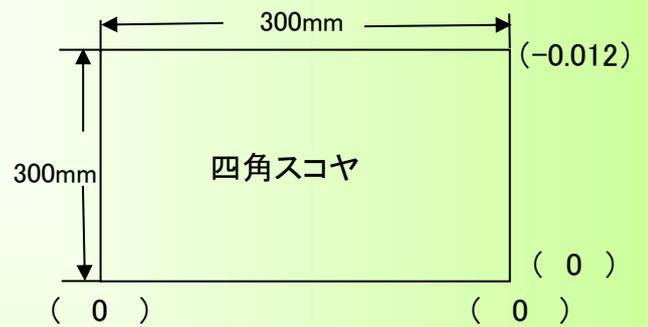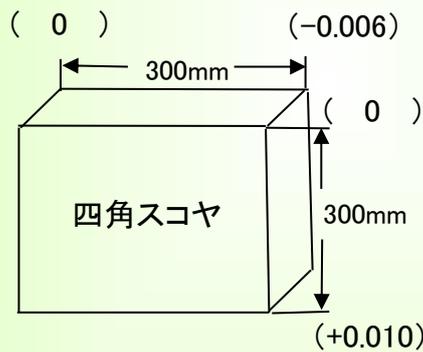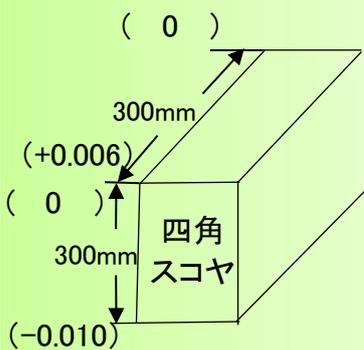

上面精度

※テーブルサイズ 1400×380

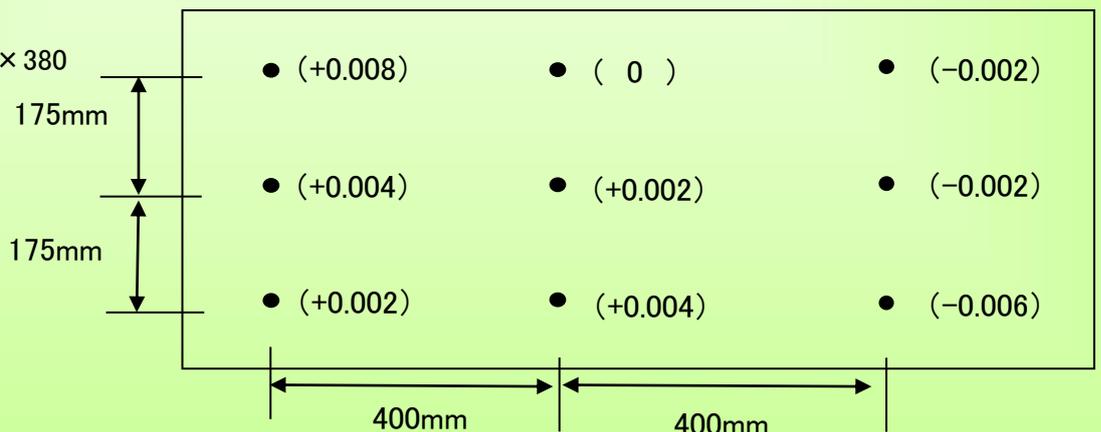

2023/12/27