


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	1998年	管理番号	P008091
型式	MILLAC-852V	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

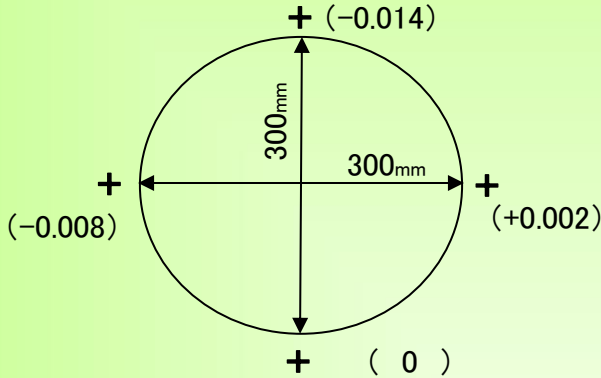

## 主軸振れ



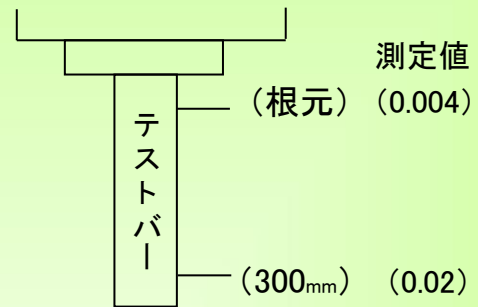


## 直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (-0.004)

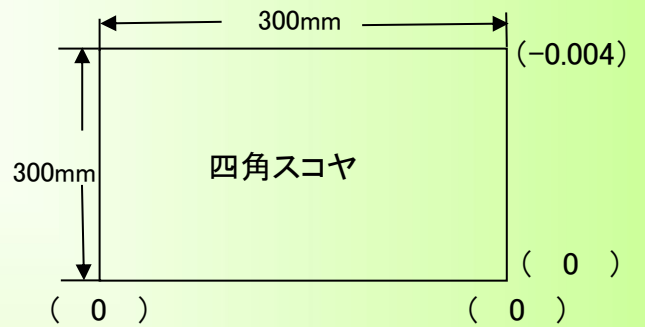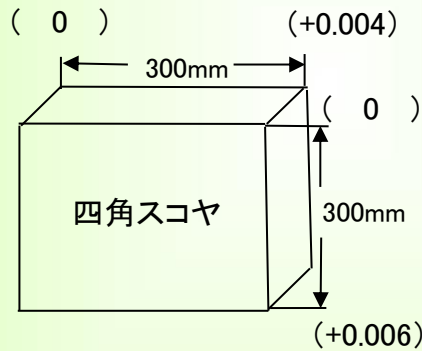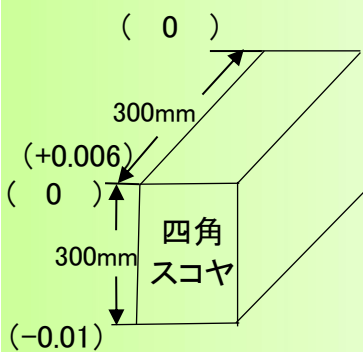

## 上面精度

※テーブルサイズ 2200×850

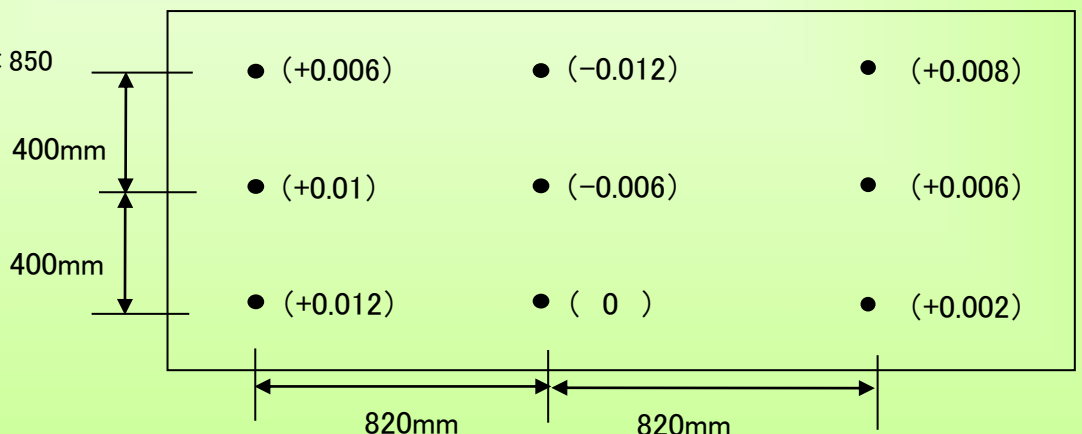

2023/12/28