


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2006	管理番号	P008466
型式	MB-46VAE	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

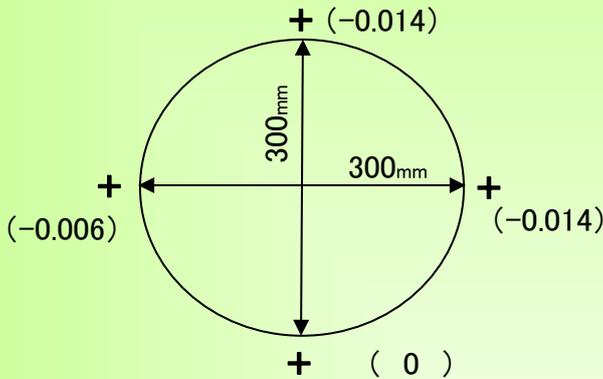

主軸振れ



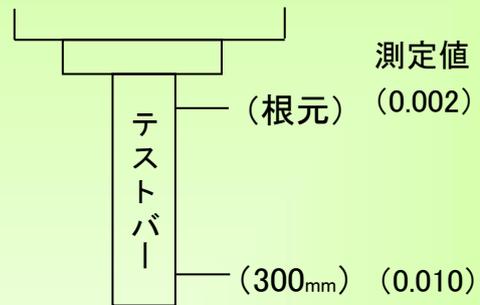


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.006)

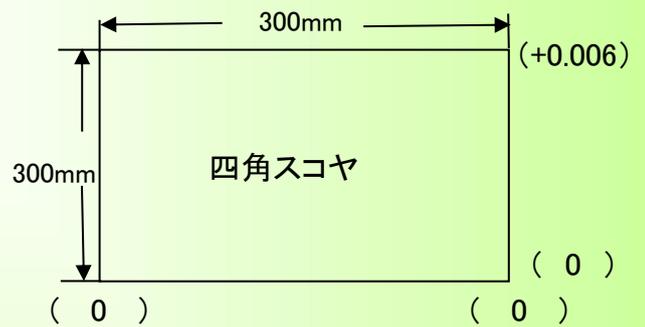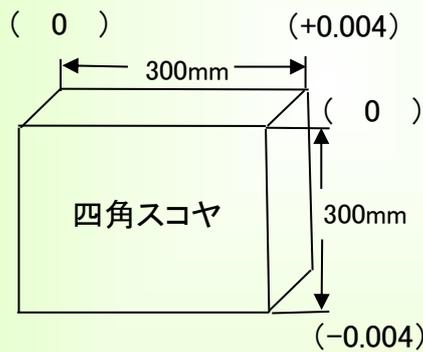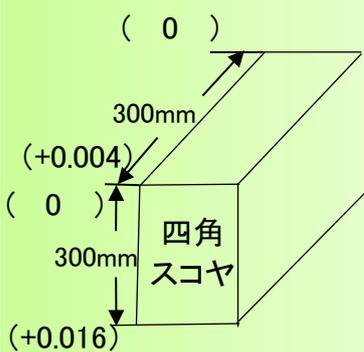

上面精度

※テーブルサイズ 1000×460

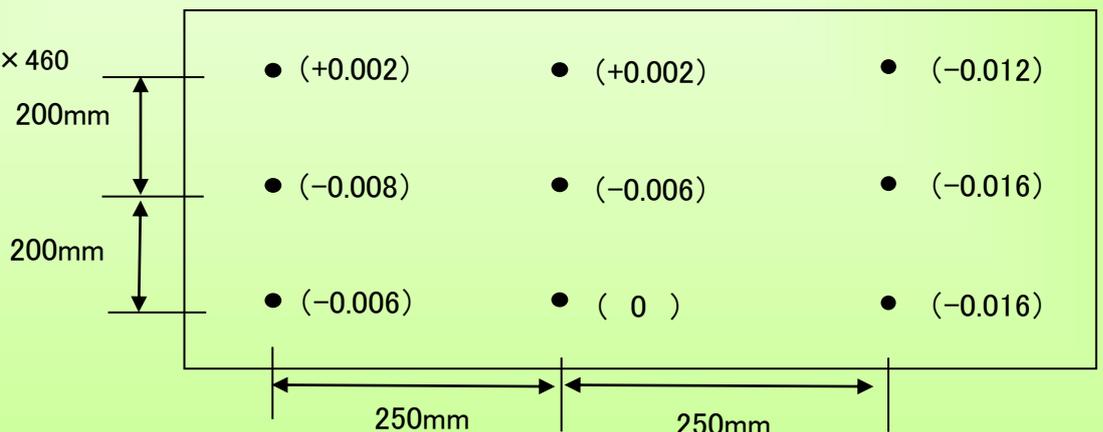

2024/2/2