精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2003年製	バーコード	P006592
型式	V56	当社評価		測定者	金子	アシスタント	阿部

振り回し(300ピッチ)

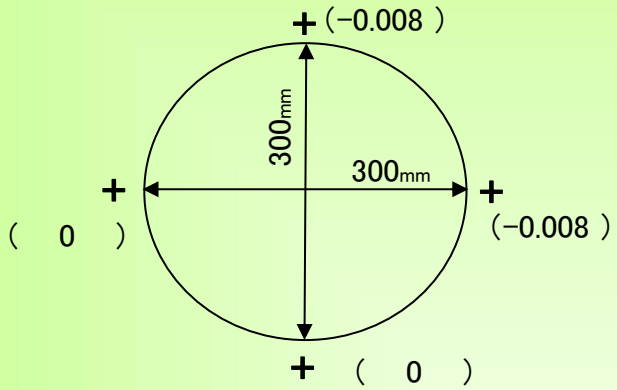

主軸振れ

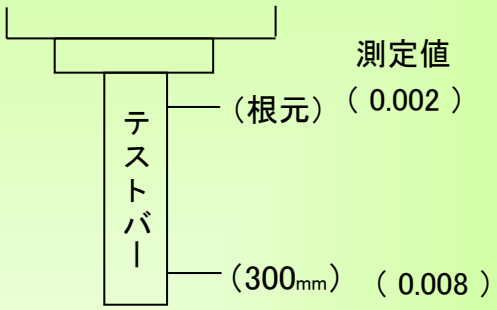

直角度

【Y Z】測定値 (0.016)　【X Z】測定値 (0.004)　【X Y】測定値 (0.012)

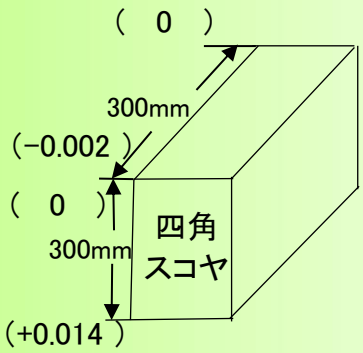

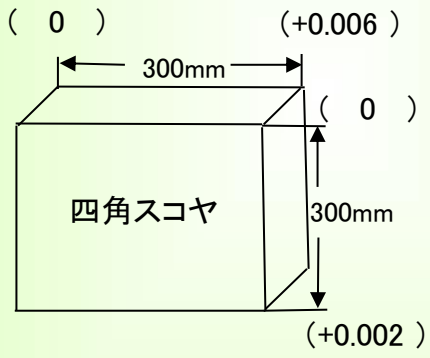

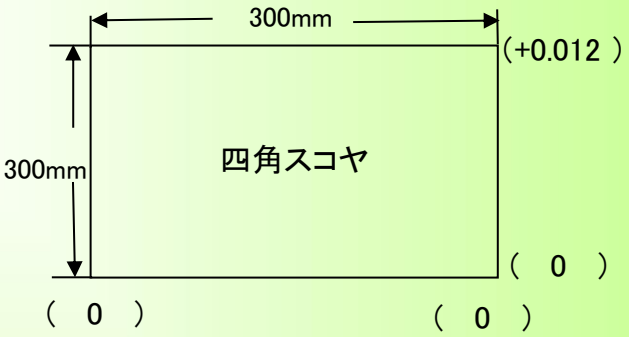

上面精度
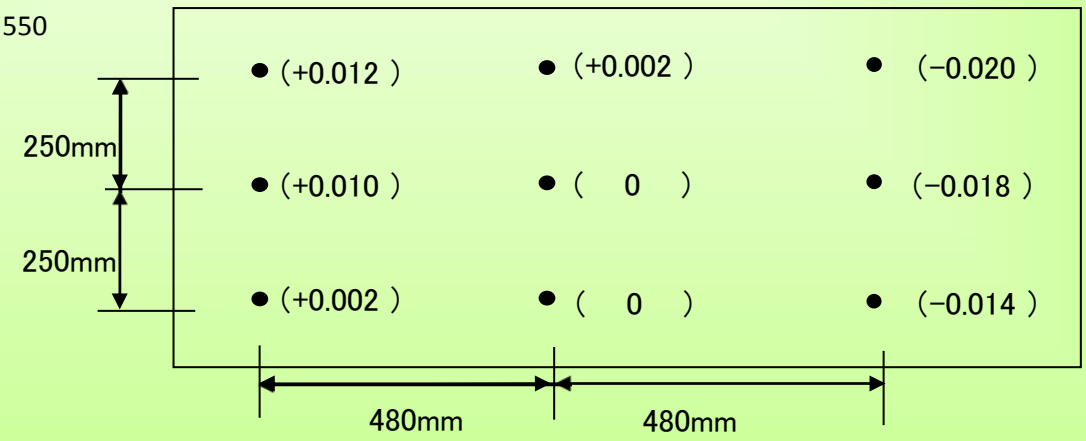
※テーブルサイズ　1050×550