


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	安田工業	年式	2009	管理番号	P008431
型式	YBM-640V	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

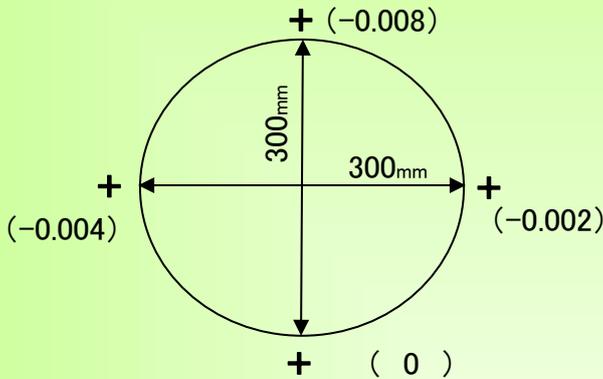

主軸振れ



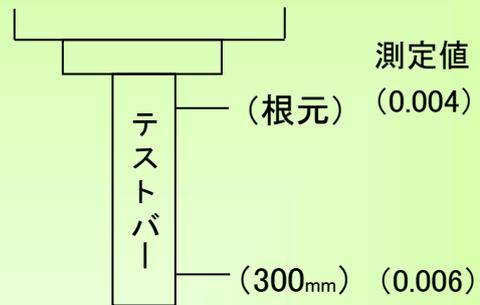


直角度

【YZ】 測定値 (+0.010)


【XZ】 測定値 (+0.002)

【XY】 測定値 (-0.004)

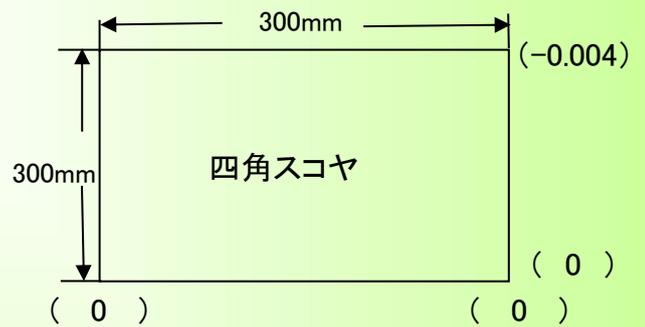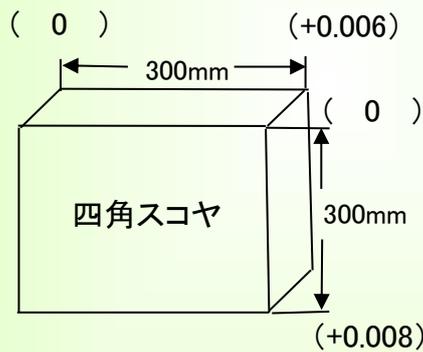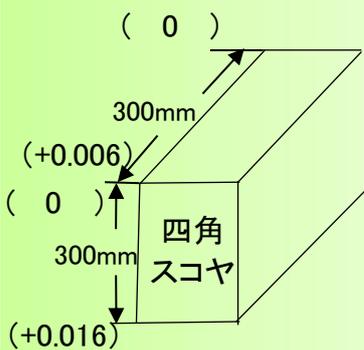

上面精度

※テーブルサイズ 700×450

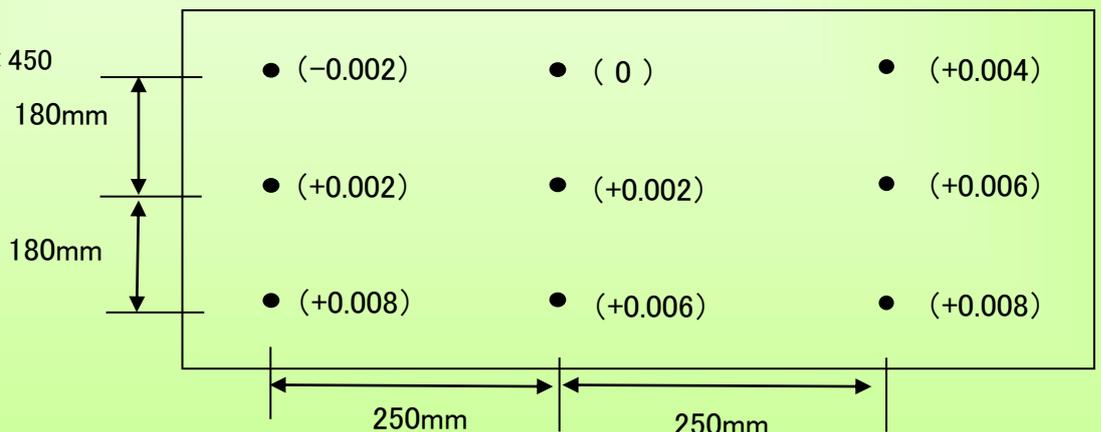

2024/1/19