


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	ファナック	年式	2001	管理番号	P008061
型式	$\alpha$ -T14iBL	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

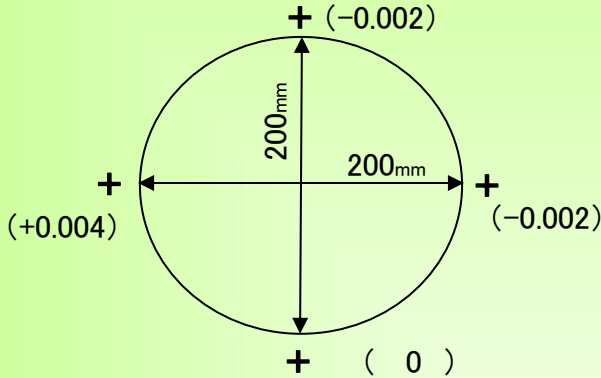

## 主軸振れ



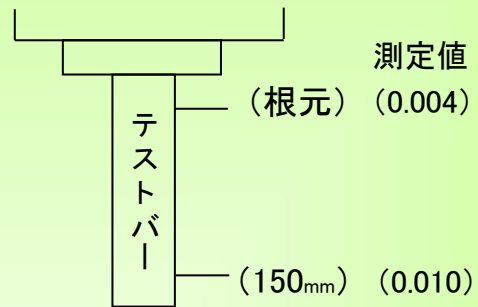


## 直角度

【YZ】 測定値 (-0.006)


【XZ】 測定値 (-0.004)

【XY】 測定値 (0.006)

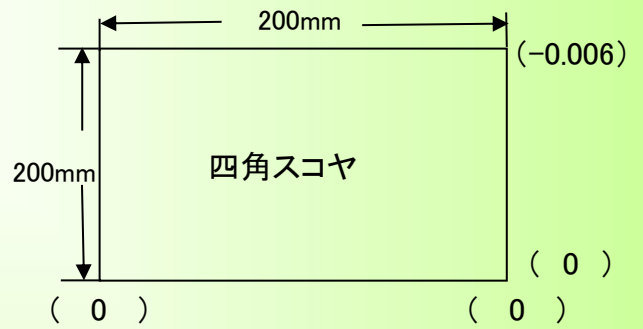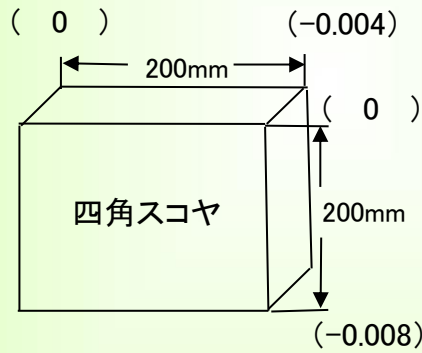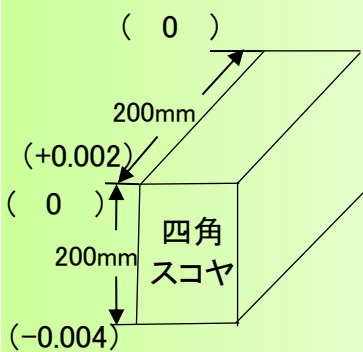

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×410

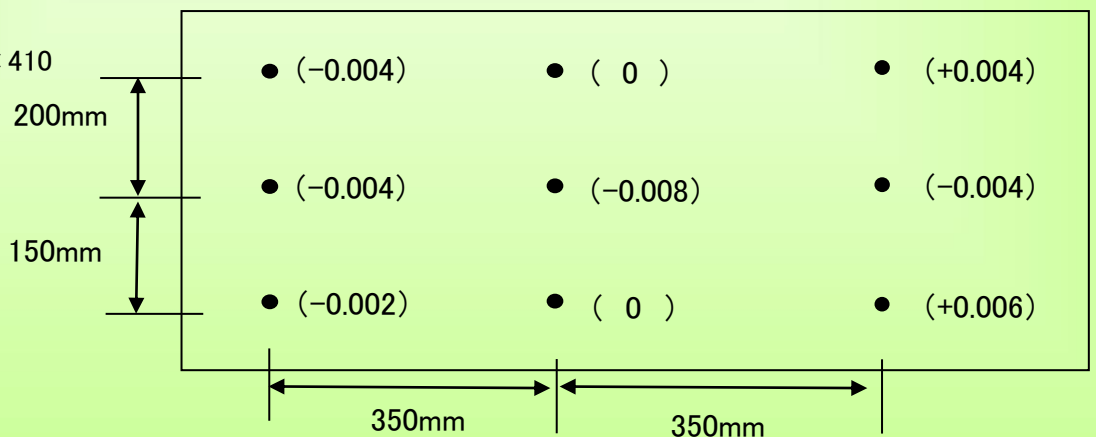

2024/3/26