


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2006	管理番号	P008500
型式	MA-400HA	測定者	金子	アシスタント	

## Z軸方向の平行度

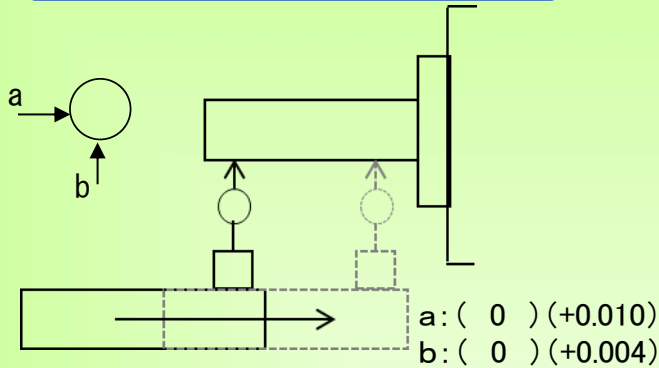

## 主軸振れ



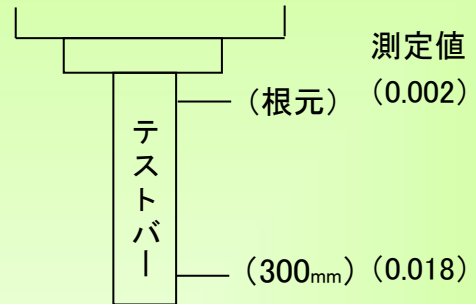


## 直角度

【XY】測定値 (0.004)

【ZY】測定値 (0.002)


【ZX】測定値 (0.004)

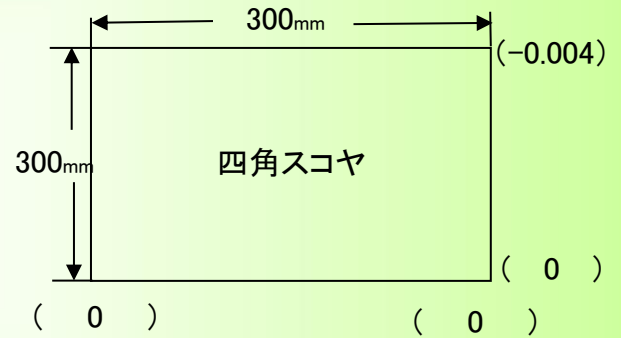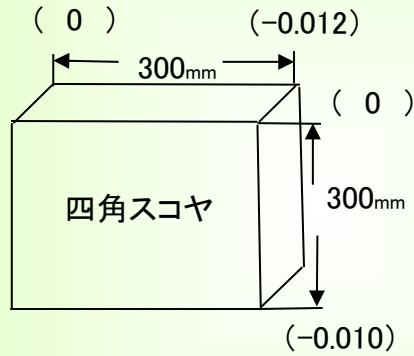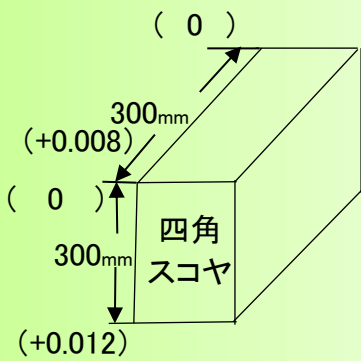

## 上面精度

テーブルサイズ: 400角

( )パレット1  
[ ]パレット2

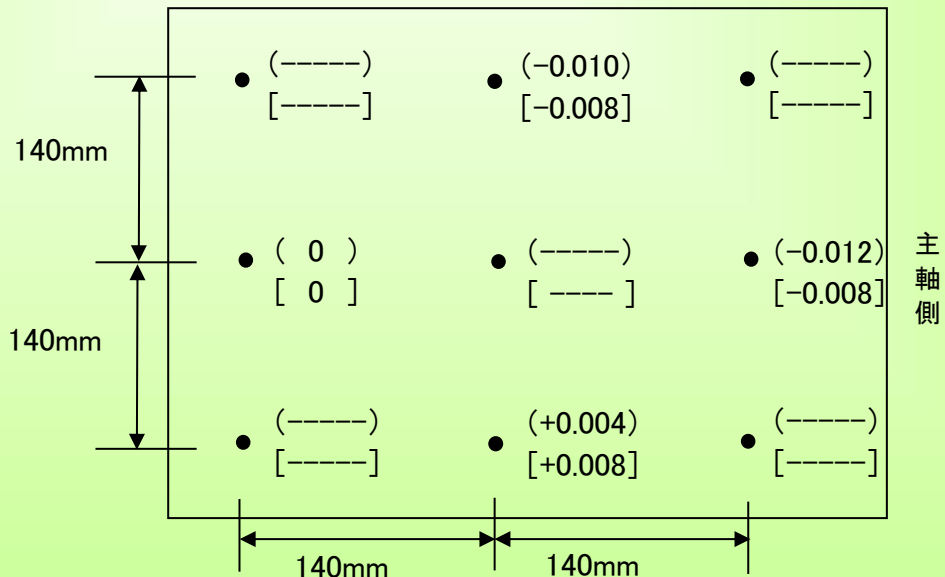

2024/4/2