


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	1999	管理番号	H018240
型式	YZ-8WR	測定者	蔵内	アシスタント	仙田

## 振り回し(300ピッチ)

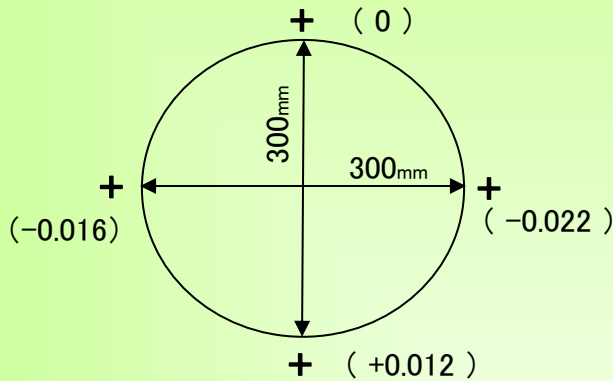

## 主軸振れ



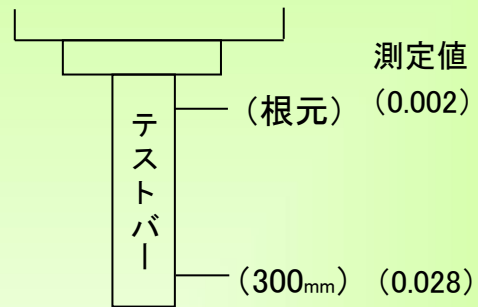


## 直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.024)

【XY】測定値 (0.010)

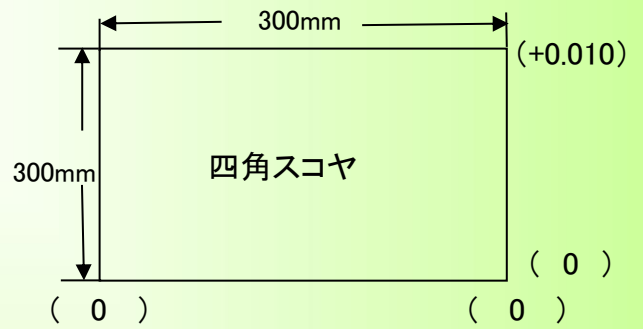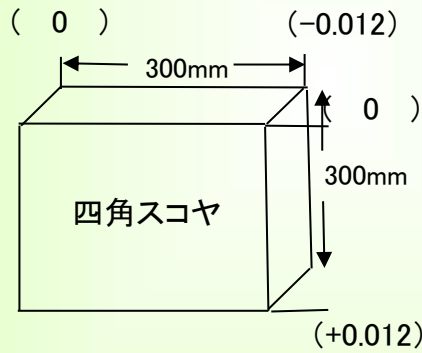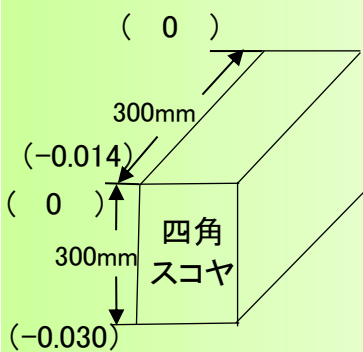

## 上面精度

※テーブルサイズ 1400×400

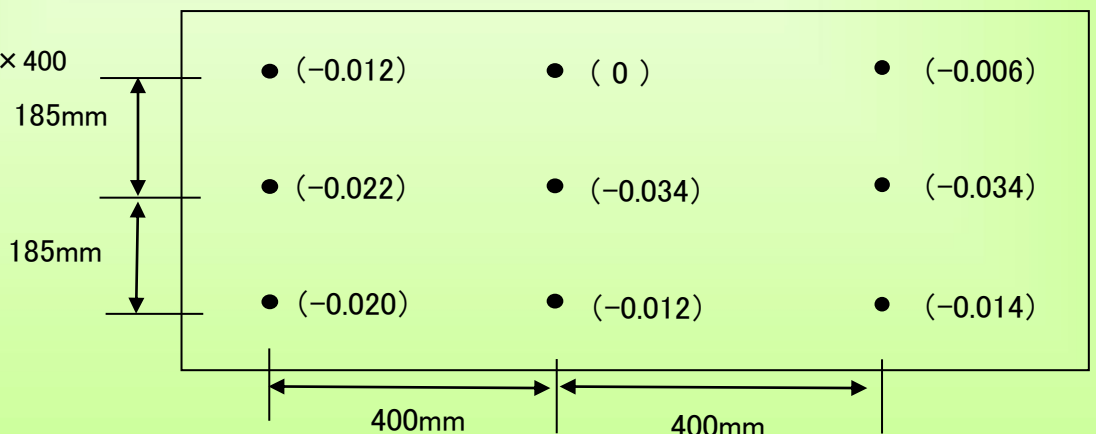

2024/1/30