


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	1998	管理番号	H018201
型式	YZ-8WR	測定者	蔵内	アシスタント	仙田

振り回し(300ピッチ)

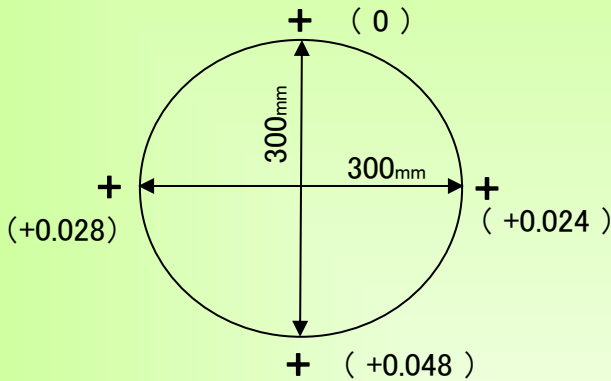

主軸振れ



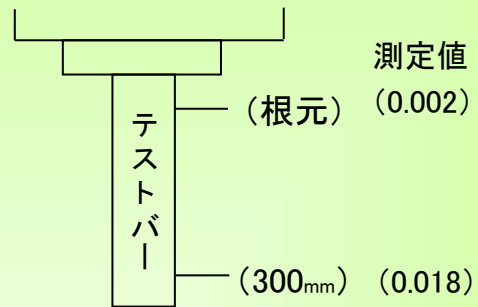


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.016)

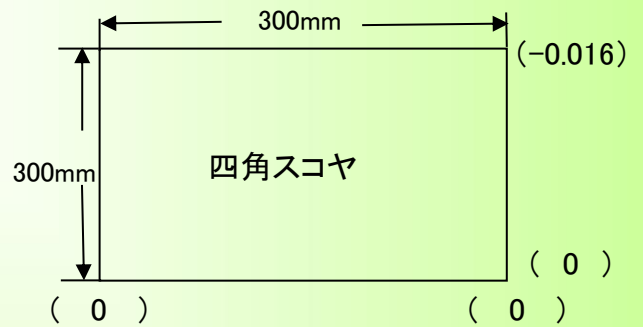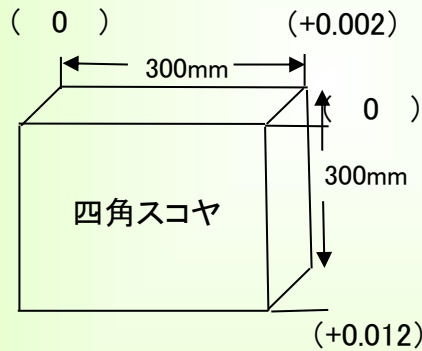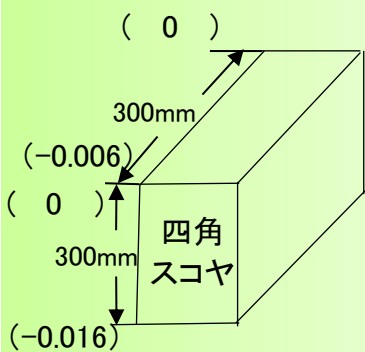

上面精度

※テーブルサイズ 1400×400

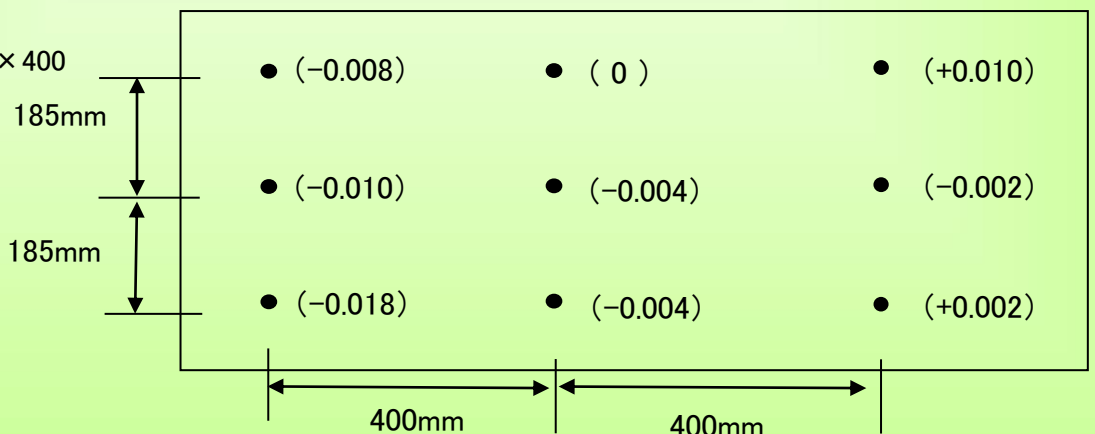

2024/1/30