


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|-------------------|-----|---------|--------|---------|
| メーカー | ファナック | 年式 | 2009.12 | 管理番号 | P008529 |
| 型式 | α -T21iFLa | 測定者 | 野辺沼 | アシスタント | 平澤 |

振り回し(300ピッチ)

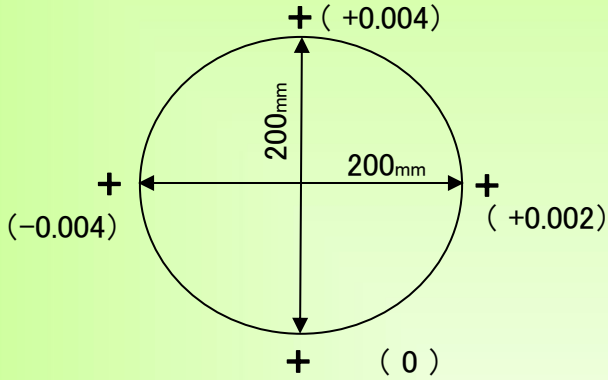

主軸振れ



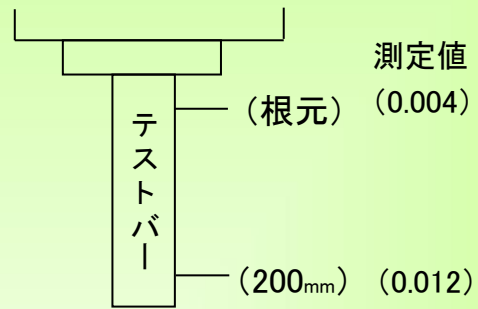


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.004)

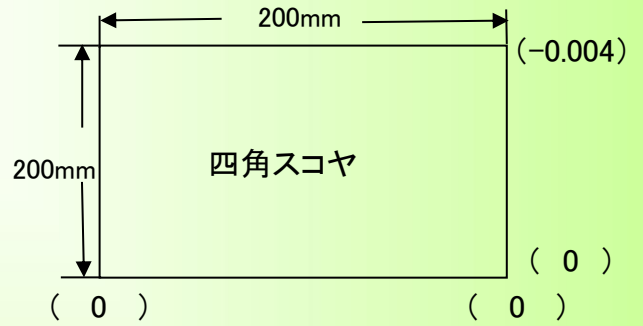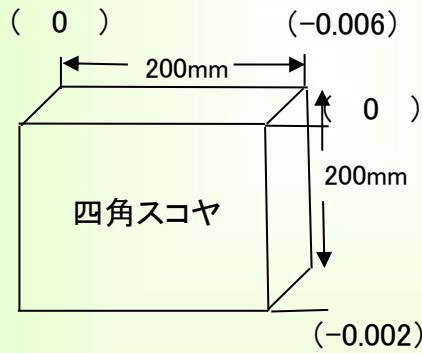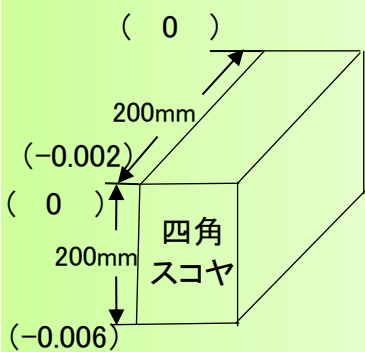

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

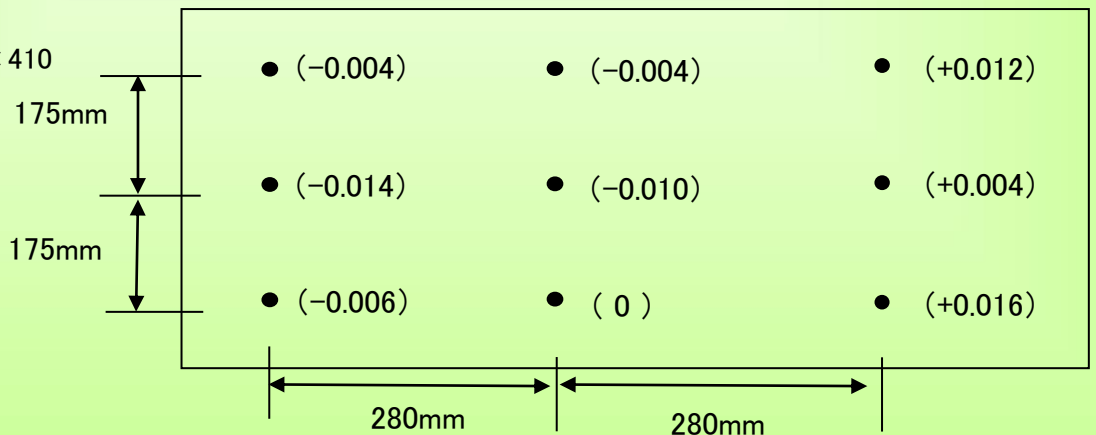

2024/4/26