


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2006.12	管理番号	P008520
型式	VCN-410B II	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

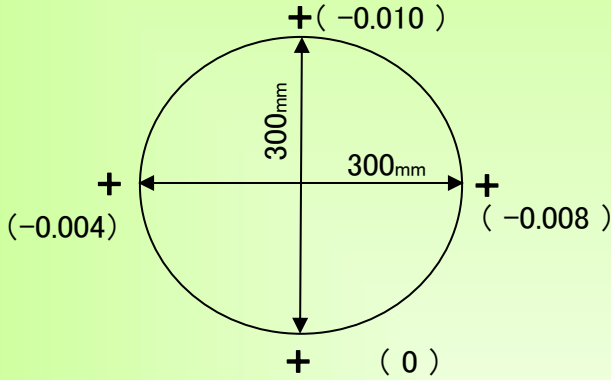

## 主軸振れ



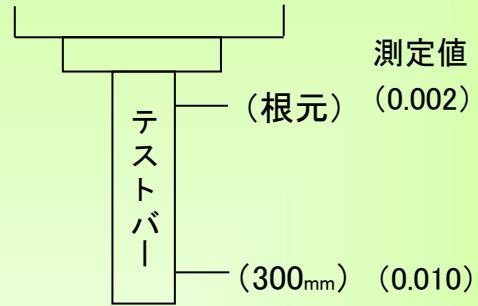


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.006)

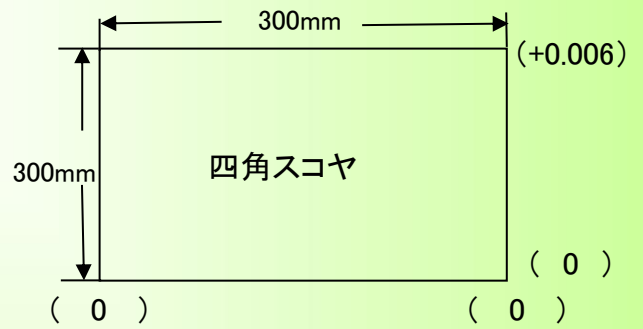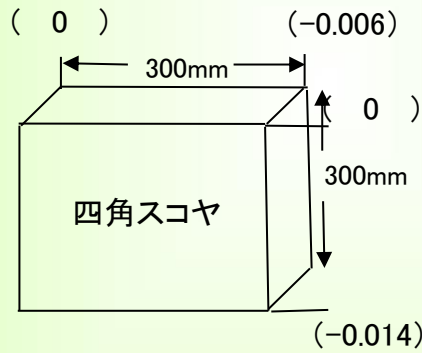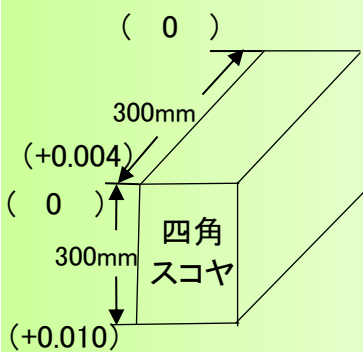

## 上面精度

※テーブルサイズ 1100×410

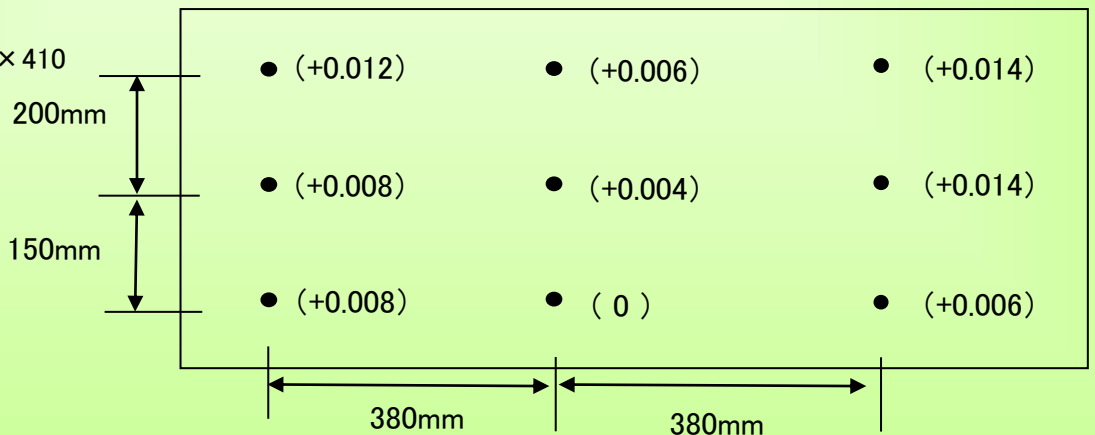

2024/4/25