


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2005.12	管理番号	P008377
型式	MB-46VAE(2パレ)	測定者	野辺沼	アシスタント	※Bパレットで測定

振り回し(300ピッチ)

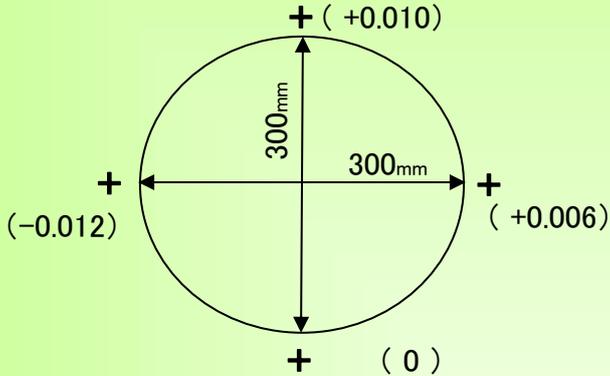

主軸振れ



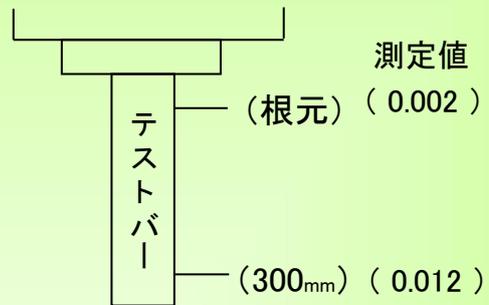


直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.004)

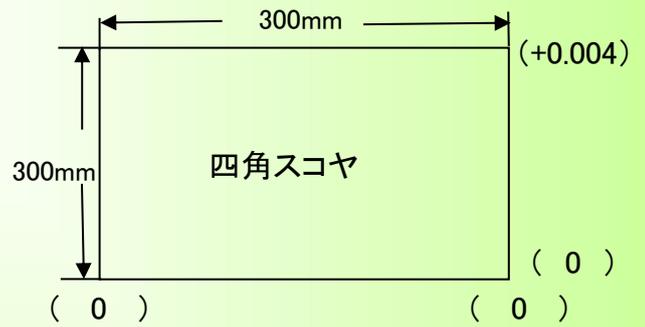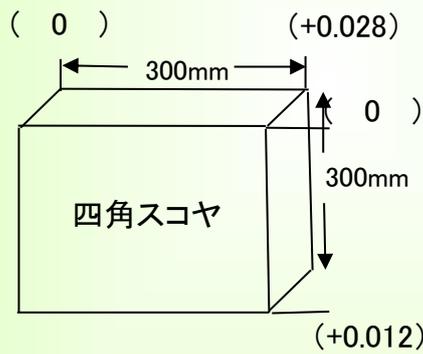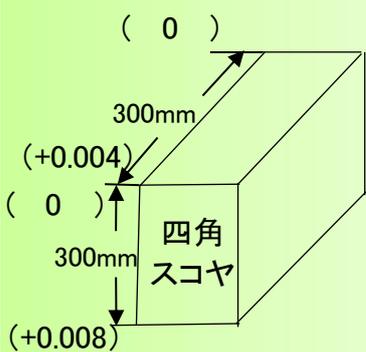

上面精度

※テーブルサイズ 1000×430

- △ Bパレット
- Aパレット

190mm	△ (+0.014)	△ (-0.004)	△ (+0.016)
	● (+0.022)	● (+0.004)	● (+0.022)
190mm	△ (+0.004)	△ (-0.016)	△ (+0.008)
	● (+0.012)	● (-0.012)	● (+0.006)
	△ (+0.016)	△ (0)	△ (+0.018)
	● (+0.024)	● (0)	● (+0.018)
	330mm		330mm

2024/4/22