


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	三井精機	年式	1997	管理番号	P008152
型式	VT3A	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

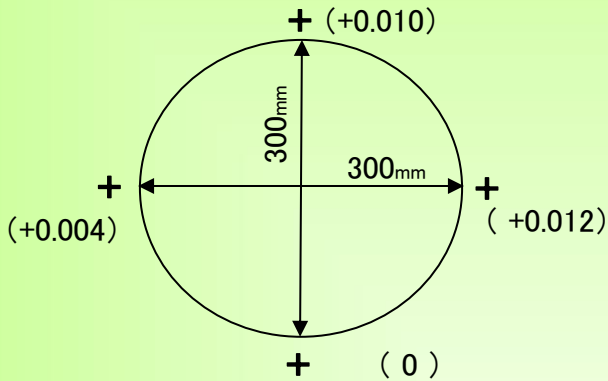

主軸振れ



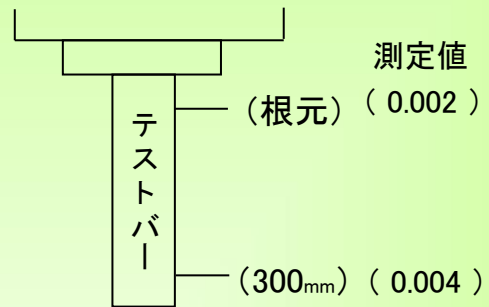


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.002)

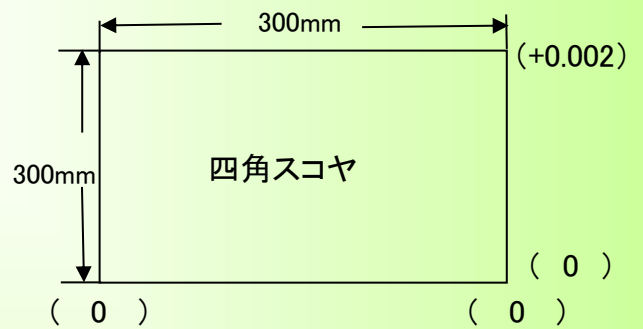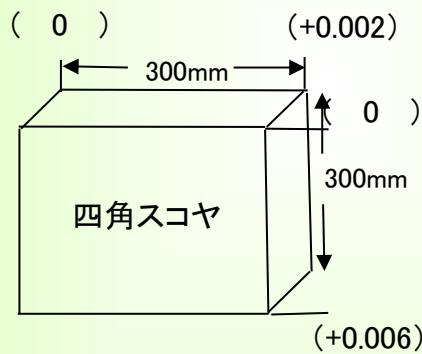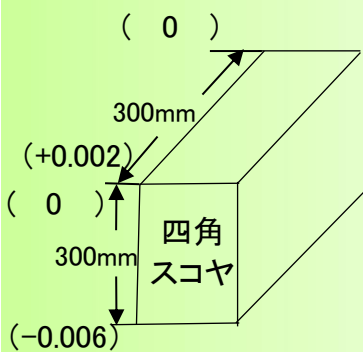

上面精度

※テーブルサイズ 1100×580

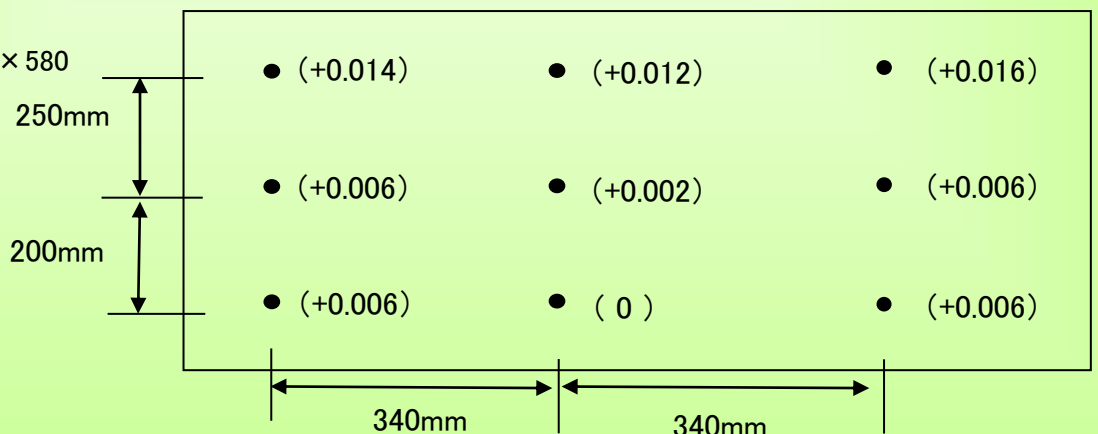

2024/5/16