

精度測定検査表


Examination for precision list

測定日 2012 . 12 . 12


メーカー	大隈豊和	バーコード	P1748
型式	MILLAC-611V		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	精度良好です
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	


振り回し(300ピッチ)

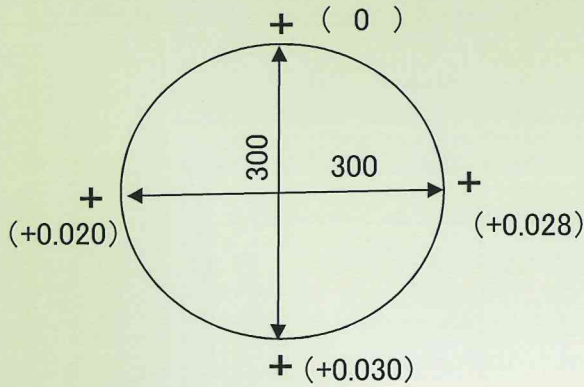

主軸振れ

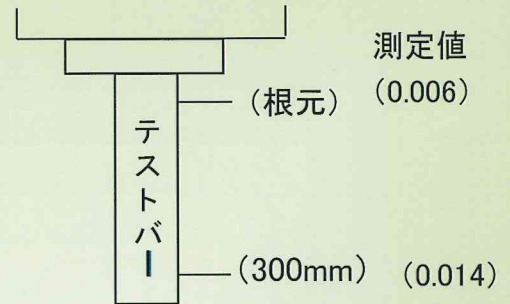

直角度

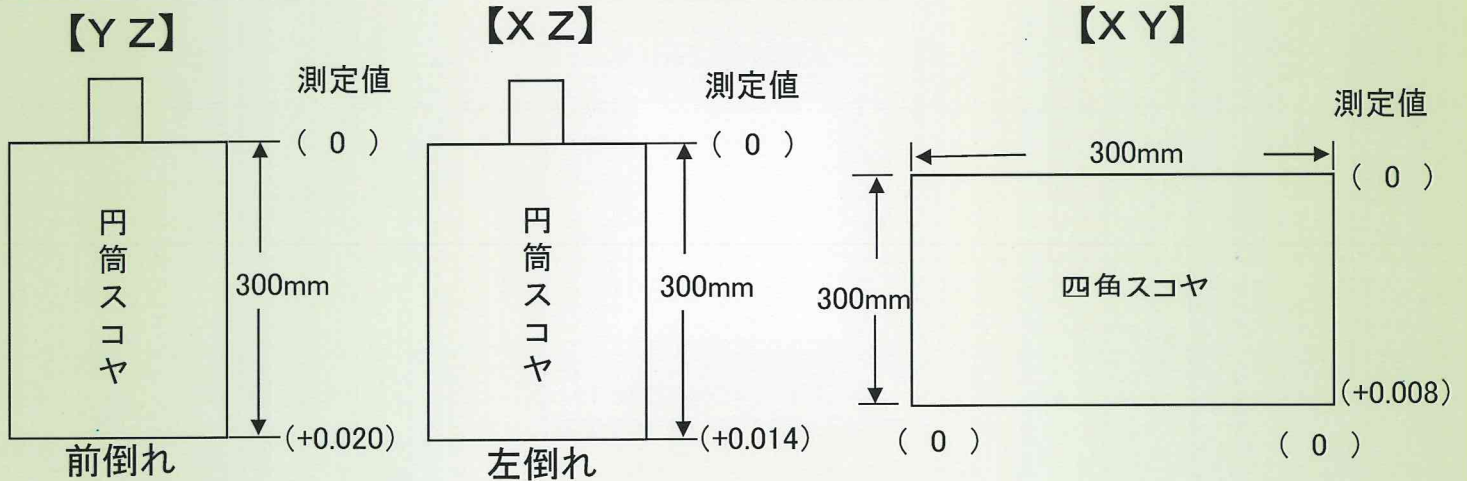

上面精度

