


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1997年製	バーコード	P006626
型式	FMR-30	当社評価		測定者	仙田

振り回し(300ピッチ)

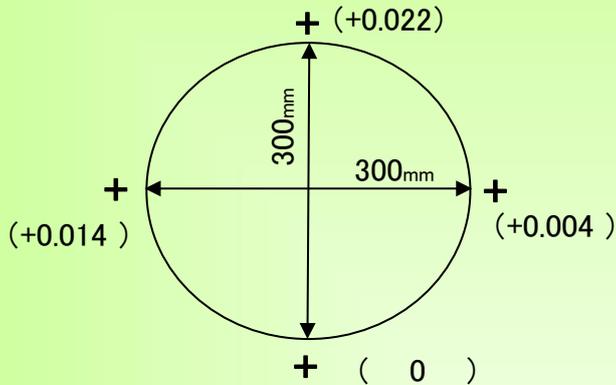



主軸振れ

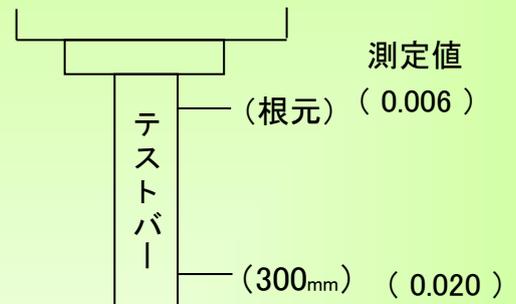

直角度

【X Z】測定値 (0.004) 【Y Z】測定値 (0.012)

【X Y】測定値 (0.004)

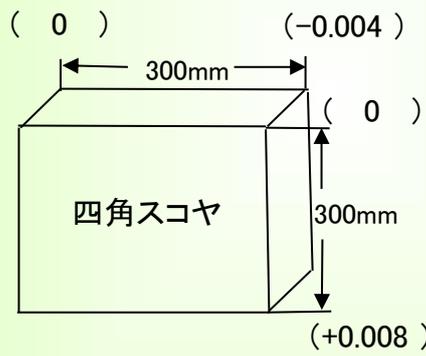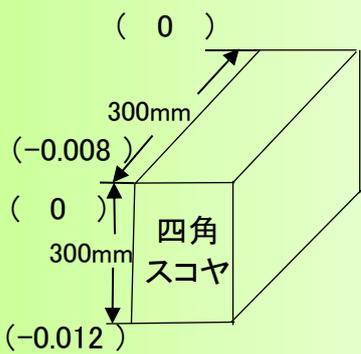

上面精度

※テーブルサイズ 1350×310

