


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2006.10	管理番号	P008759
型式	TC-S2C	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

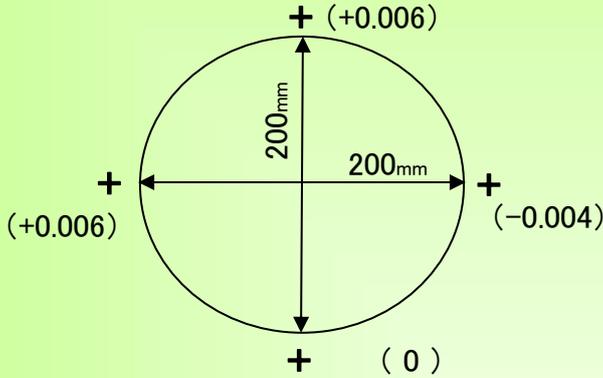

主軸振れ



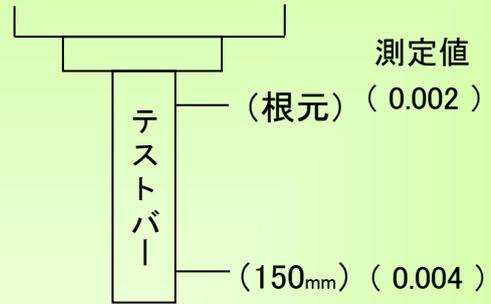


直角度

【YZ】 測定値 (0.014)


【XZ】 測定値 (0.020)

【XY】 測定値 (0.002)

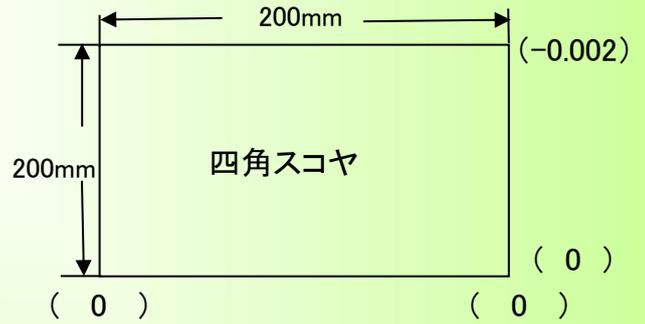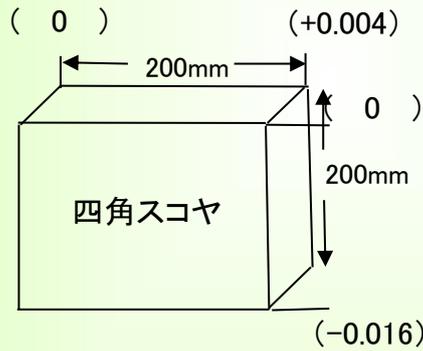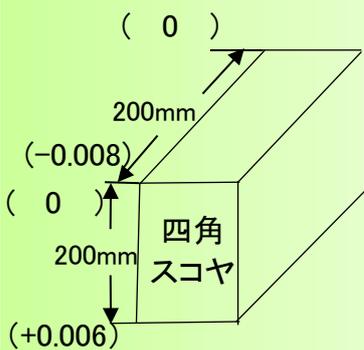

上面精度

※テーブルサイズ 600×320

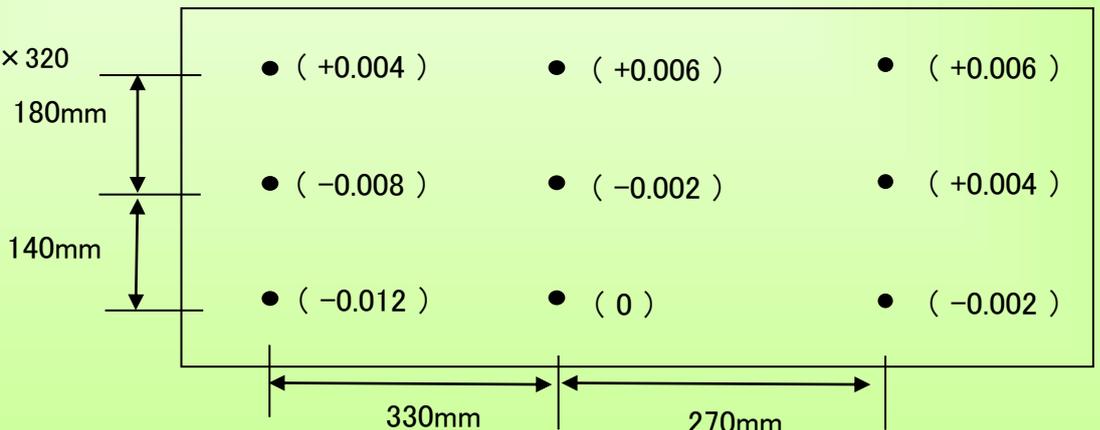

2024/2/19