


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2007	管理番号	P008878
型式	VM4III	測定者	金子	アシスタント	長谷川

振り回し(300ピッチ)

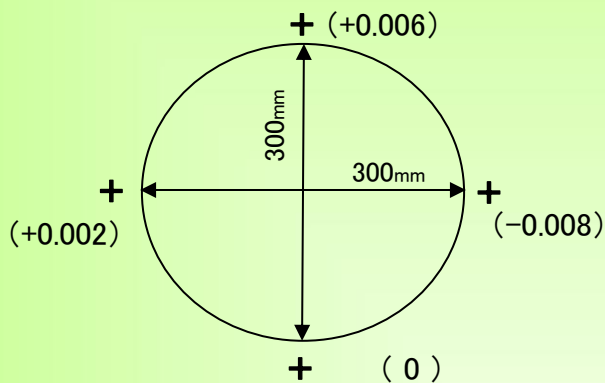

主軸振れ



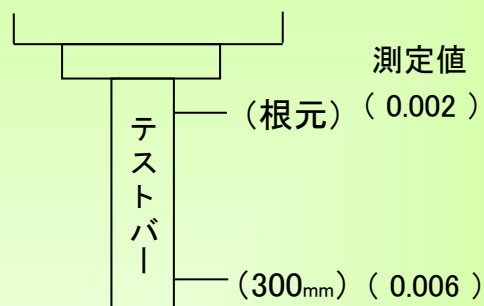


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.018)

【X Y】測定値 (0.004)

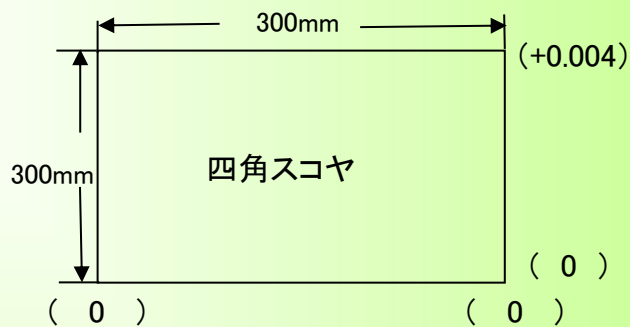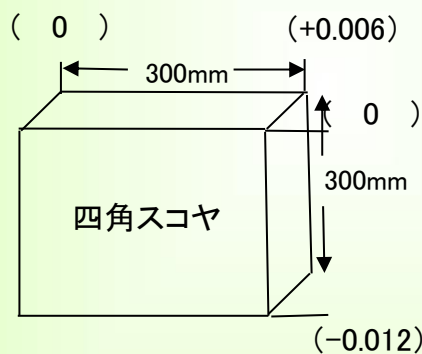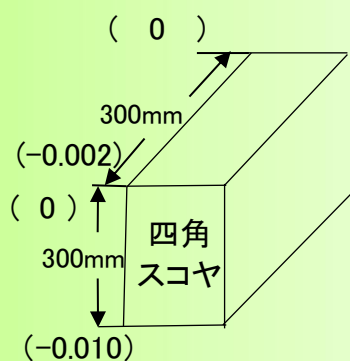

上面精度

※テーブルサイズ 800×410

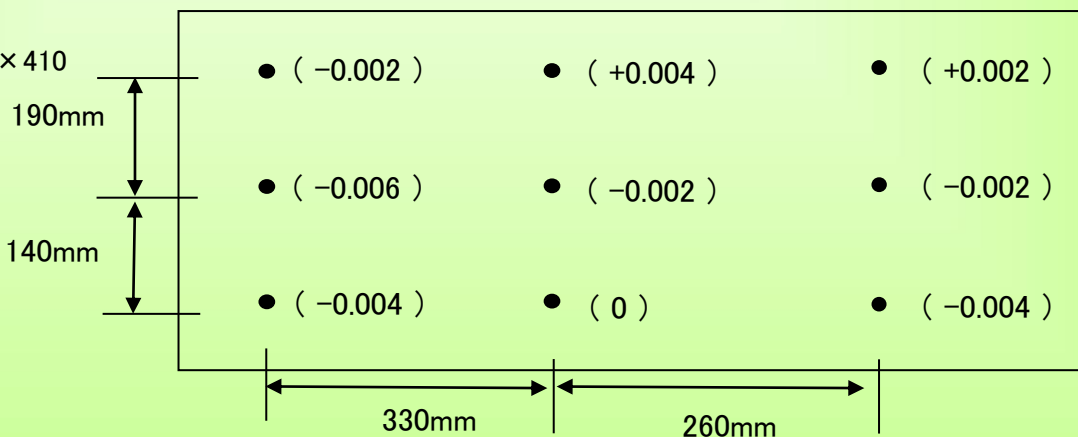

2025/4/3