


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2008	管理番号	P008751
型式	α -T21iF	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

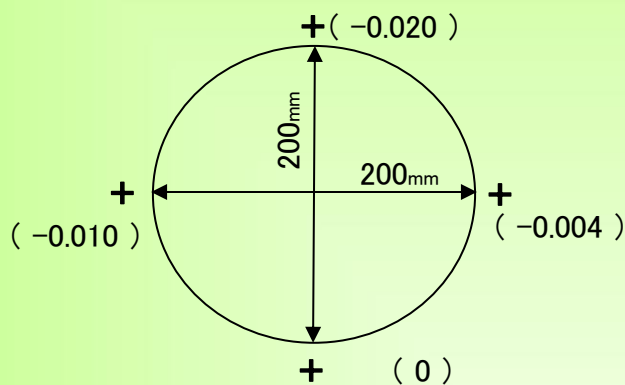

主軸振れ



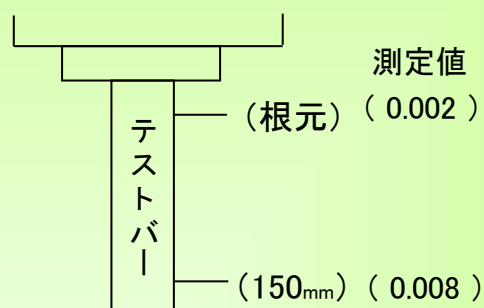


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.002)

【X Y】測定値 (0.006)

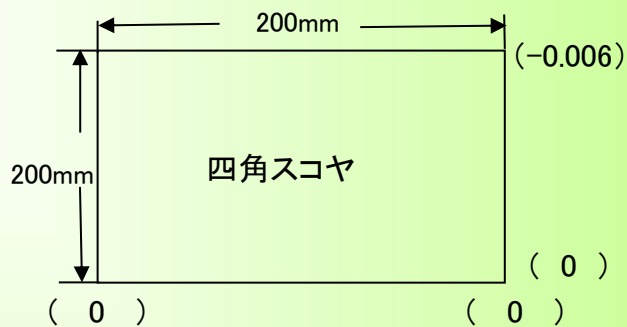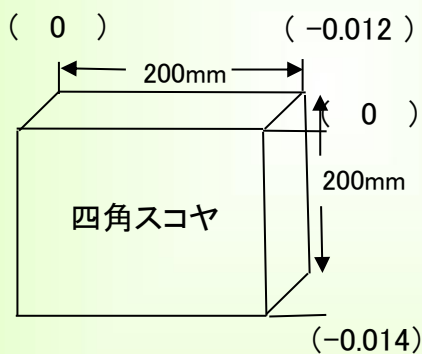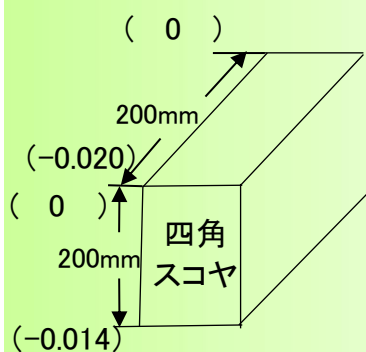

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

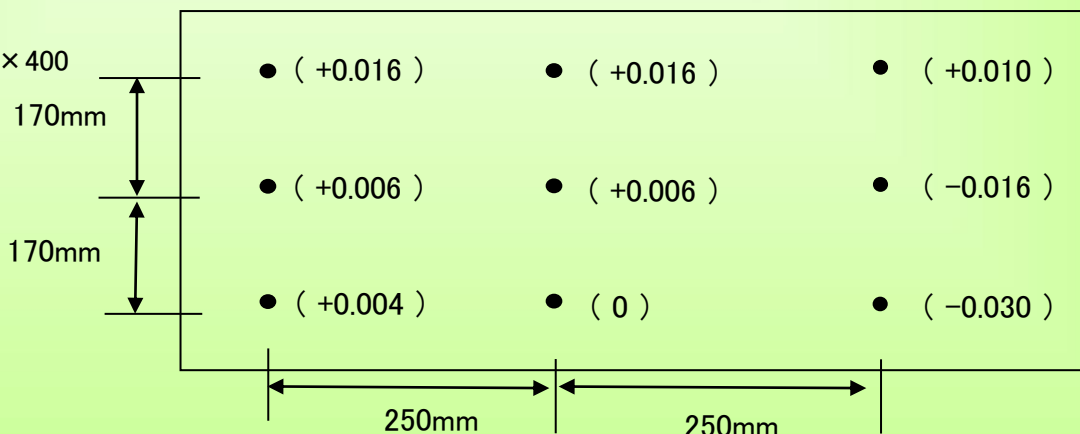

2025/4/4