


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2005	管理番号	P008867
型式	MILLAC-44V	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

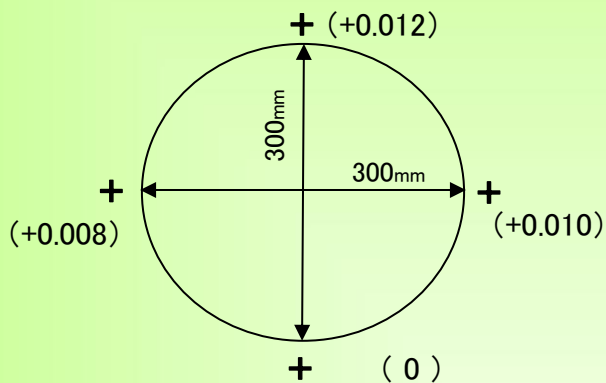

主軸振れ



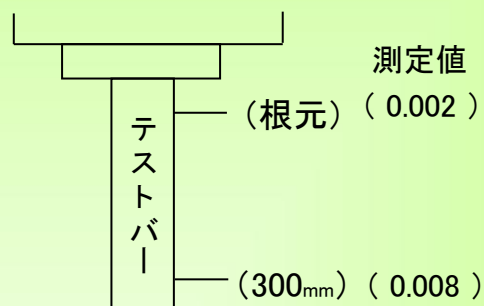


直角度

【YZ】 測定値 (0.020)


【XZ】 測定値 (0.012)

【X Y】 測定値 (0.002)

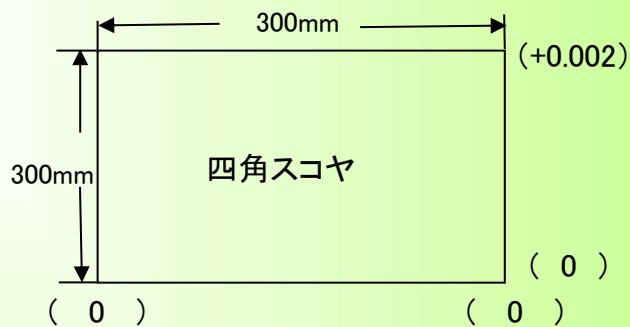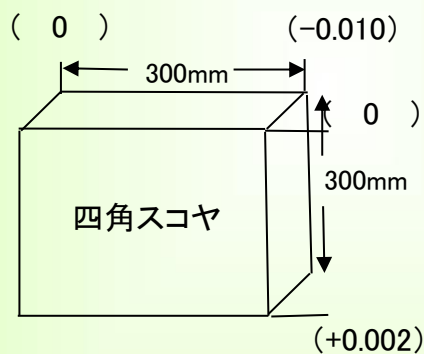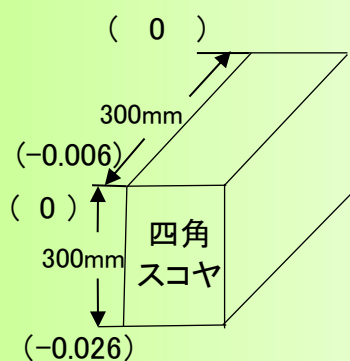

上面精度

※テーブルサイズ 650 × 400

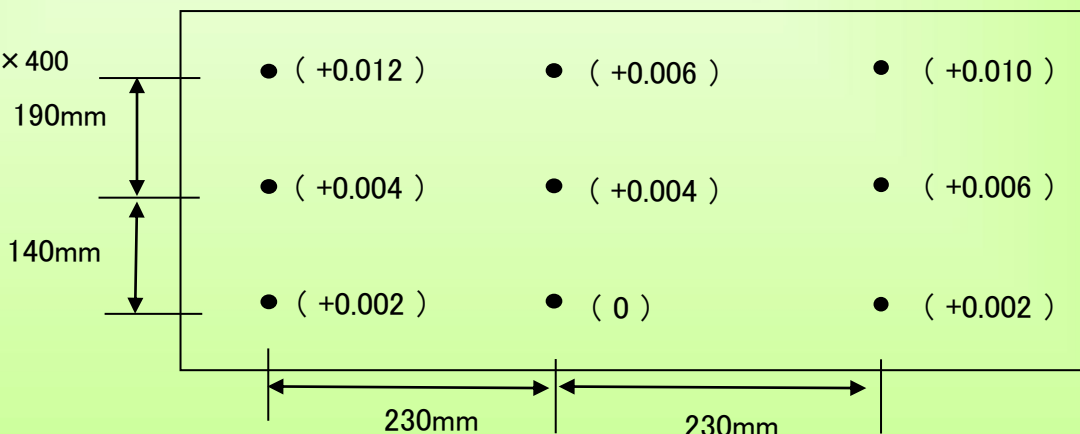

2025/4/8