


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2007.2	管理番号	H016444
型式	MCV-1260	測定者	平野	アシスタント	

## 振り回し(ピッチ)

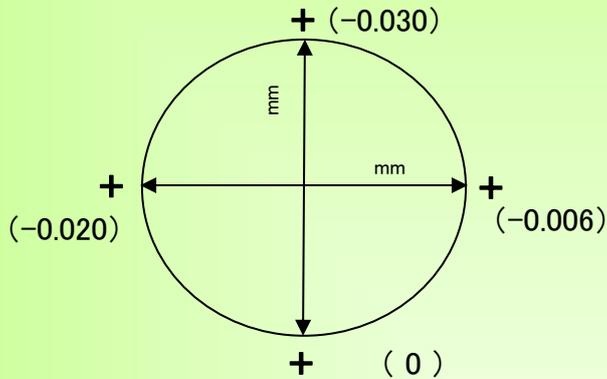

## 主軸振れ


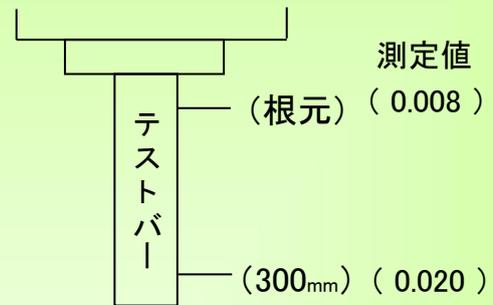


## 直角度

【YZ】測定値 (0.030)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.020)

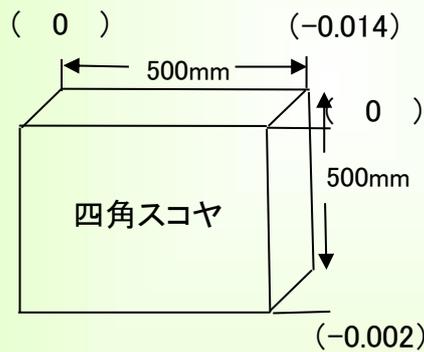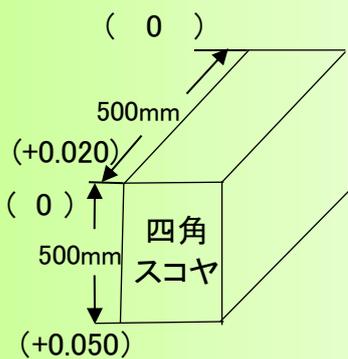

## 上面精度

※テーブルサイズ 2500×1260

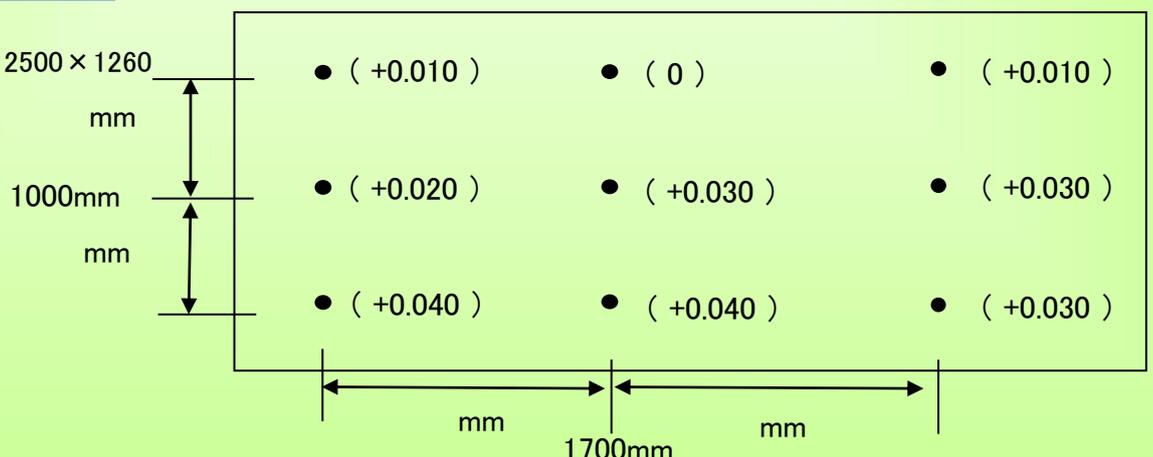

2025/5/16